



Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-QU-Química urinaria
Código de muestra: CJ1803
Ronda: 34
Muestra: 4
Noviembre 2024
Ciudad : Cali Valle del Cauca, Medellín Antioquia, Bogotá Distrito Capital,


100232 - Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali
100233 - Christus Sinergia sede Gran vía Medellín
100234 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones
100235 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real
100237 - Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102

Analito : Creatinina QU


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas 6000 (c501)	146.97	mg/dL	148.100	-0,19
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas 6000 (c501)	143.95	mg/dL	148.100	-0,7
3	100234	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas 6000 (c501)	147.15	mg/dL	148.100	-0,16
4	100235	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas c311	141.34	mg/dL	148.100	-1,13
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas c111	141.05	mg/dL	164.000	-2

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 1 Z-score

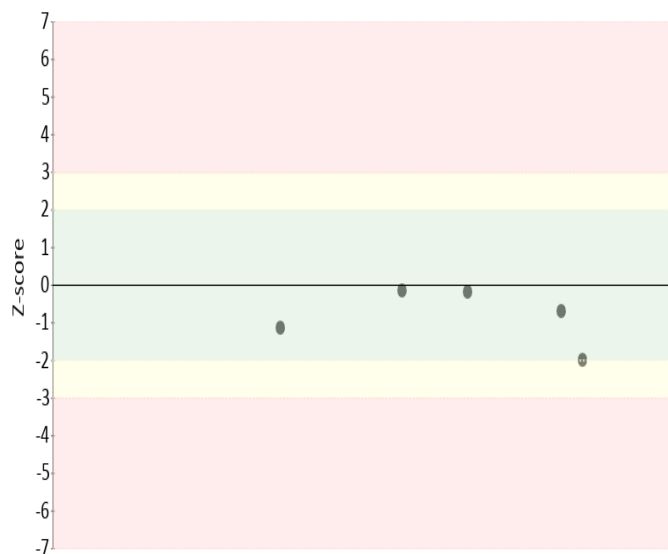

Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación

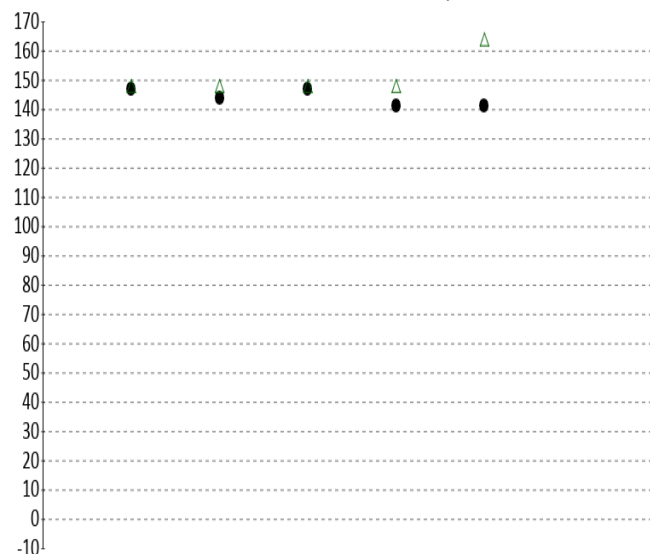

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	4	1	0	5
Porcentaje	80%	20%	0%	100%

Analito : Microalbuminuria QU


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas 6000 (c501)	72.46	mg/L	76.930	-0,67
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas 6000 (c501)	75.5	mg/L	76.930	-0,21
3	100234	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas 6000 (c501)	106.1	mg/L	76.930	4,38

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Gráfica 3 Z-score

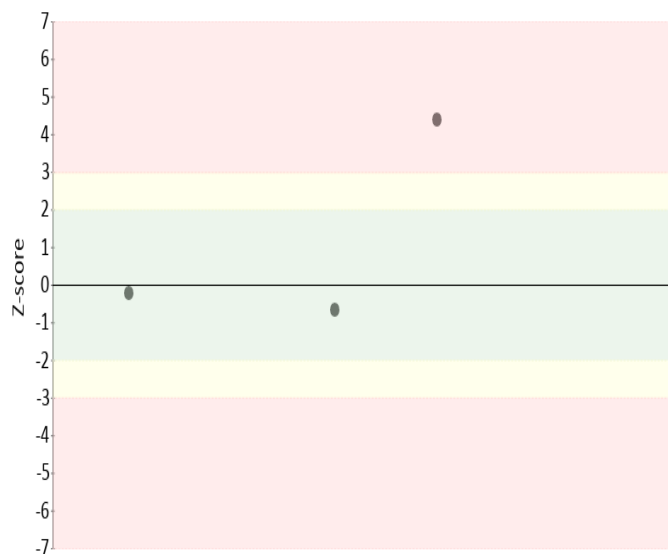

Gráfica 4 Resultado VS Media de comparación

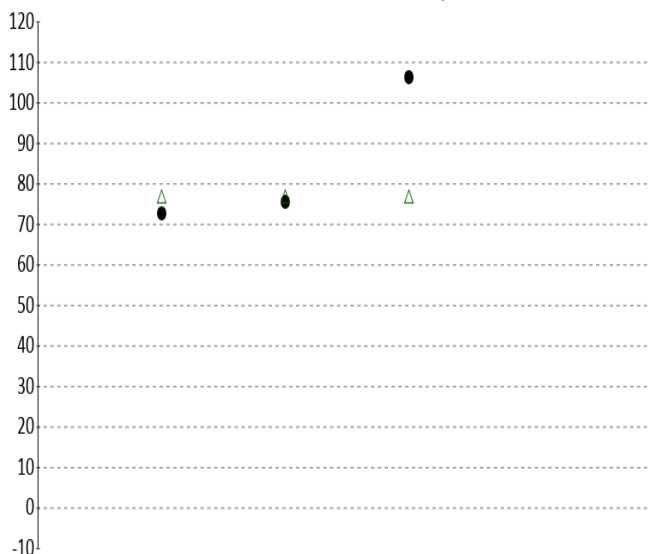

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	1	3
Porcentaje	66,67%	0%	33,33%	100%

Analito : Proteínas totales QU


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas 6000 (c501)	48.84	mg/dL	51.950	-0,88
2	100234	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas 6000 (c501)	51.86	mg/dL	51.950	-0,03
3	100235	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real	2024	NOVIEMBRE	Roche Cobas c311	51.4	mg/dL	51.950	-0,16

Satisfactorio Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
---	---	---

Gráfica 5 Z-score

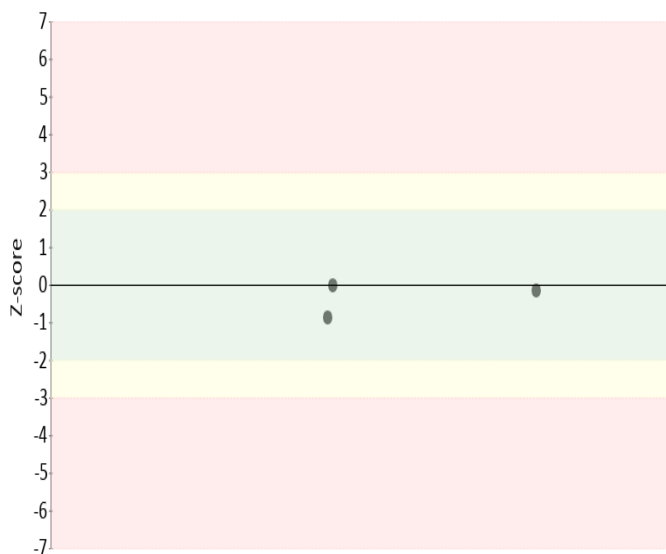

Gráfica 6 Resultado VS Media de comparación

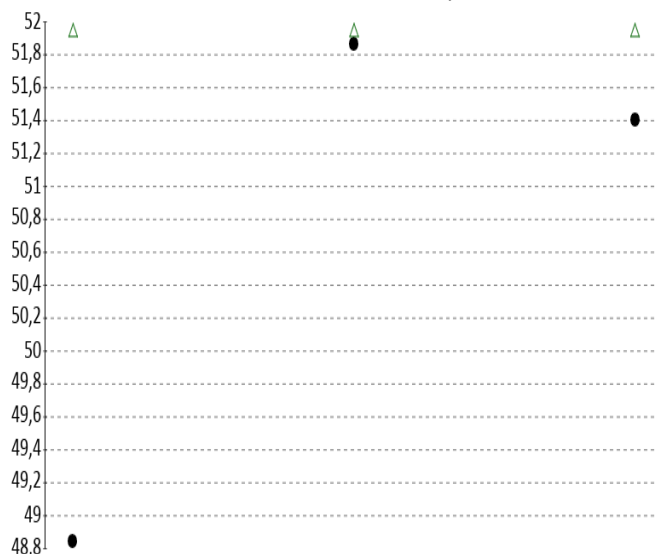

● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	3	0	0	3
Porcentaje	100%	0%	0%	100%