



QAP-Química Clínica


PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QAP-Q - Química sanguínea

LABORATORIO CLÍNICO COLMÉDICOS IPS SAS MEDELLÍN SEDE ITAGUÍ

Correo electrónico: natalia.sanchez@colmedicos.com
Dirección: CL 50 46 -36 P14 Edificio Furatena
Ciudad: Medellín Antioquia
País: Colombia
Contacto: Natalia Sanchez
Teléfono: Celular: 3138309077 Fijo: (4) 5100 500

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100175

Código de reporte: QAP-Q-100175-61-3
Ronda: 61
Muestra: 3
Código de la muestra: FR1304
Tipo de muestra: Liofilizado -Suero humano
Fecha generación: 23 / abril / 2025

 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea	Identificación Laboratorio:	100175
		Ronda:	61
		Muestra:	3
		Código Muestra:	FR1304
		Fecha reporte:	2025-04-07
		Estado:	Evaluación original

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 ¹, ISO 14001:2015 ², ISO 45001:2018 ³ y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ⁴, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos. Los detalles de preparación y manejo del control se encuentran en el inserto de cada programa.

Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. Los valores asignados de la sección 3 se obtienen de laboratorios clínicos con metodologías o materiales de referencia trazables al “Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine” (JCTLM).

Diseño de los programas QAP:

Los programas QAP LC están compuestos por rondas de acuerdo con la frecuencia establecida para cada programa. Las matrices utilizadas con conmutables con las muestras de las pacientes procesadas en la cotidianidad del laboratorio. El valor asignado se obtiene a partir de una comparación interlaboratorios a nivel internacional, el consenso QAP y/o un laboratorio con material o metodología de referencia trazable al JCTLM.

Para el análisis estadístico de los datos se realizan los siguientes cálculos:

Formula Desviación Estandar:

$$Desviación\ estándar = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

Formula Media:

$$Media = \frac{\sum \text{todos los datos}}{\text{Número de datos}}$$

Formula Zscore:

$$Z - score = \frac{\text{Resultado reportado por el laboratorio} - \bar{x} \text{ de consenso}}{D.E. \text{ del grupo consenso}}$$

Formula Incertidumbre:

$$U = \bar{x} \pm D.E * k$$

 "Quality Assurance Program" Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea					Identificación Laboratorio:	100175
						Ronda:	61
						Muestra:	3
						Código Muestra:	FR1304
						Fecha reporte:	2025-04-07
						Estado:	Evaluación original

2. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN

1 IT	2 NOT	3 Mensurando	4 Analizador	5 Método	6 VRL	7 U-LAB	8 M-C	9 U-MC	10 DE-C	11 T-C	12 Zs	13 VAL	14 COMP
1		ALT (ALAT/GPT)	Roche Cobas c111	UV without P5P	23.7	U/L	23,95	U/L	1,43	Acumulada	-0,17	Satisfactorio	Par
2		AST (ASAT/GOT)	Roche Cobas c111	UV without P5P	41.1	U/L	38,95	U/L	2,26	Acumulada	0,95	Satisfactorio	Par
3		Colesterol HDL	Roche Cobas c111	Direct Enzymatic Colorimetric	76.52	mg/dL	83,59	mg/dL	7,56	Acumulada	-0,94	Satisfactorio	Método
4		Colesterol HDL	Cobas C111	Direct Enzymatic Colorimetric	76.29	mg/dL	83,59	mg/dL	7,56	Acumulada	-0,97	Satisfactorio	Método
5		Colesterol Total	Roche Cobas c111	Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase	233.4	mg/dL	236	mg/dL	7,19	Acumulada	-0,36	Satisfactorio	Par
6		Colesterol Total	Cobas C111	Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase	217.7	mg/dL	236	mg/dL	7,19	Acumulada	-2,55	Alarma	Par
7		Creatinina	Roche Cobas c111	Enzymatic IFCC-IDMS Standardized	1.65	mg/dL	1,73	mg/dL	0,06	Acumulada	-1,33	Satisfactorio	Par
8		Creatinina	Cobas C111	Enzymatic IFCC-IDMS Standardized	1.66	mg/dL	1,73	mg/dL	0,06	Acumulada	-1,17	Satisfactorio	Par
9		Glucosa	Roche Cobas c111	Hexokinase	80.8	mg/dL	82,78	mg/dL	2,54	Acumulada	-0,78	Satisfactorio	Par
10		Glucosa	Cobas C111	Hexokinase	79	mg/dL	82,78	mg/dL	2,54	Acumulada	-1,49	Satisfactorio	Par
11		Triglicéridos	Roche Cobas c111	Enzymatic, end point	163.6	mg/dL	165,7	mg/dL	4,33	Acumulada	-0,48	Satisfactorio	Par
12		Triglicéridos	Cobas C111	Enzymatic, end point	157.6	mg/dL	165,7	mg/dL	4,33	Acumulada	-1,87	Satisfactorio	Par

IT: Item		NOT: Notificaciones		VRL: Valor reportado por el laboratorio		U-LAB: Unidades de laboratorio		U-MC: Unidades Originales de la media de comparación	
M-C: Media del grupo de comparación		DE-C: Desviación estándar del grupo de comparación		T-C: Tipo de consenso		Zs: Z-score		VAL: Valoración	COMP: Comparador

Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score.	 Tardío	☒ Ausente	 Revalorado
---	--	--	---	--	---

	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea	Identificación Laboratorio: Ronda: Muestra: Código Muestra: Fecha reporte: Estado:	100175 61 3 FR1304 2025-04-07 Evaluación original
--	--	---	--

3. EVALUACIÓN CON VALOR OBTENIDO CON EL MÉTODO TRAZABLE A MATERIAL Y/O MÉTODO AVALADO POR EL JCTLM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Mensurando	VRL	U-LAB	X _{pt}	U-X _{pt}	M-REF	D%	ETmp/APS	Límites aceptación Bajo Alto	Valoración

VRL: Valor reportado por el laboratorio				U-X_{pt}: Unidades del valor aceptado como verdadero			
U-LAB: Unidades de laboratorio		M-REF: Método de referencia			D% Diferencia porcentual %		

Satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio NO supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con X _{pt}	No satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio SI supera la diferencia porcentual del ETmp%/APS comparado con X _{pt}	ETmp%/APS Error Total máximo permisible * Fuente CLIA 2022	X _{pt} Valor aceptado como verdadero
---	--	--	--



Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100175
Ronda:	61
Muestra:	3
Código Muestra:	FR1304
Fecha reporte:	2025-04-07
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

ALT (ALAT/GPT)

23.7 U/L Roche Cobas c111


UV without P5P

CLIA
2022

15% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	23,95	1,43	2020	21,09 a 26,81	-1,04	-0,17	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	24,26	2,12	35	20,03 a 28,5	-2,31	-0,26	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	24,53	1,52	27	21,48 a 27,58	-3,37	-0,54	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

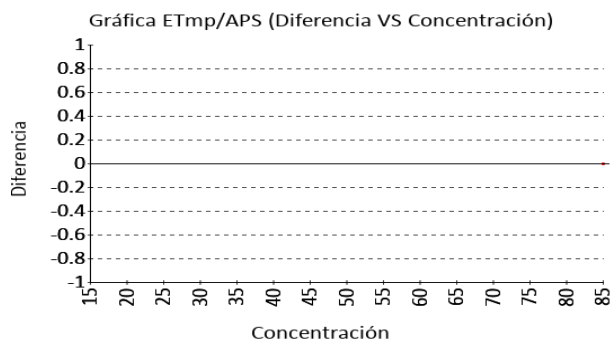

AST (ASAT/GOT)

41.1 U/L Roche Cobas c111



UV without P5P

CLIA
2022

15% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	38,95	2,26	1967	34,43 a 43,47	5,52	0,95	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	42,59	3,3	38	35,99 a 49,18	-3,49	-0,45	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	41,17	1,98	28	37,2 a 45,13	-0,17	-0,03	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

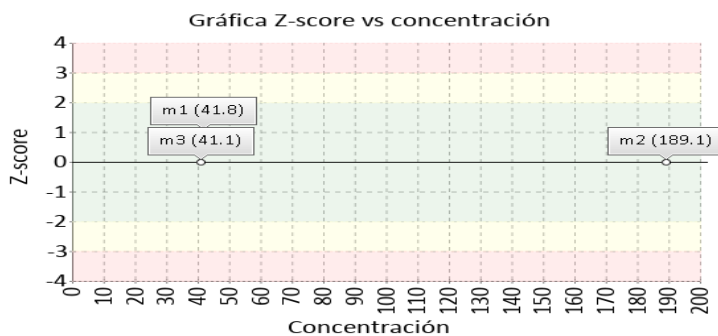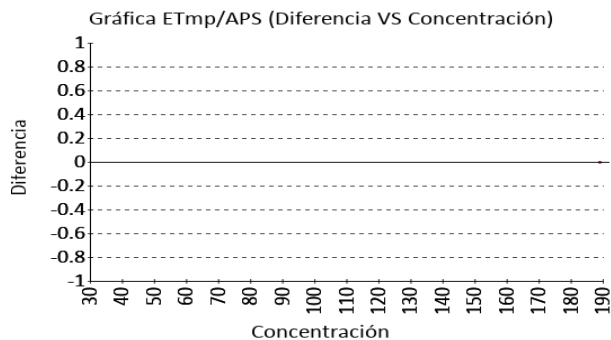

 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea	Identificación		100175
		Laboratorio:		
		Ronda:		61
		Muestra:		3
		Código Muestra:		FR1304
		Fecha reporte:		2025-04-07
		Estado:		Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Colesterol HDL

76.52 mg/dL Roche Cobas c111


Direct Enzymatic
Colorimetric

CLIA
2022

20% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	83,59	7,56	9347	68,47 a 98,71	-8,46	-0,94	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	79,63	3,47	37	72.7 a 86.57	-3,91	-0,9	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	79,03	2,77	33	73.49 a 84.56	-3,17	-0,91	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

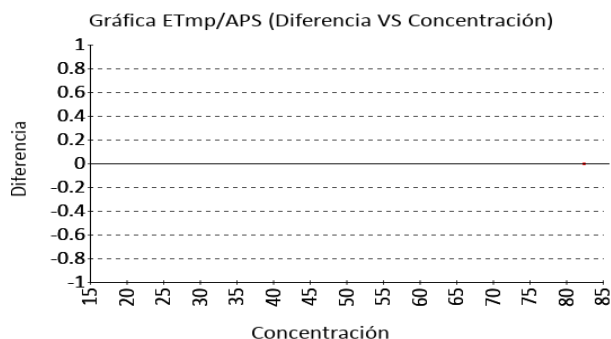

Colesterol HDL

76.29 mg/dL

Cobas C111



Direct Enzymatic
Colorimetric

CLIA
2022

20% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	83,59	7,56	9347	68,47 a 98,71	-8,73	-0,97	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	79,63	3,47	37	72.7 a 86.57	-4,2	-0,96	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	79,03	2,77	33	73.49 a 84.56	-3,46	-0,99	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

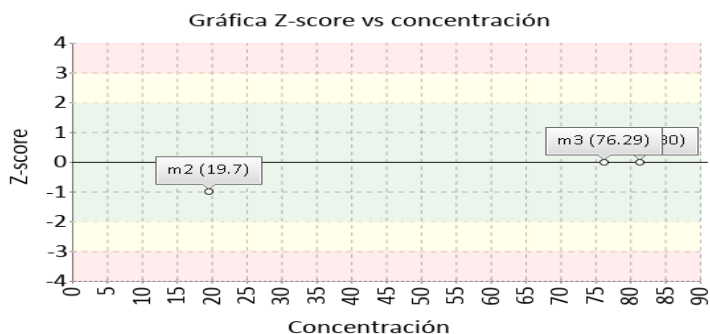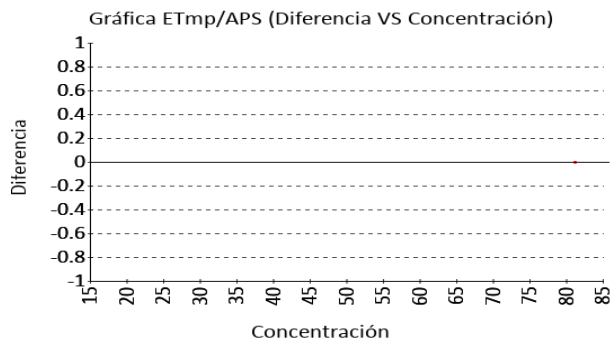

Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100175
Ronda:	61
Muestra:	3
Código Muestra:	FR1304
Fecha reporte:	2025-04-07
Estado:	Evaluación original



4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Colesterol Total

233.4 mg/dL Roche Cobas c111 Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase CLIA 2022 10% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	236	7,19	3171	221,62 a 250,38	-1,1	-0,36	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	237,29	6,82	44	223,64 a 250,94	-1,64	-0,57	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	237,41	6,85	43	223,7 a 251,12	-1,69	-0,59	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

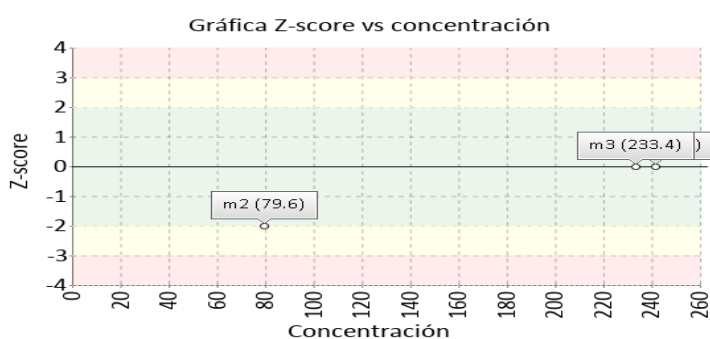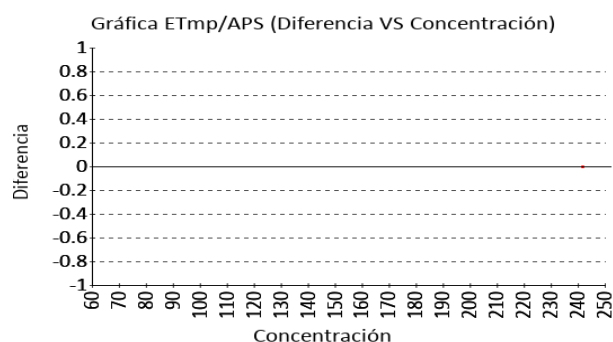


Colesterol Total

217.7 mg/dL Cobas C111 Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase CLIA 2022 10% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	236	7,19	3171	221,62 a 250,38	-7,75	-2,55	Alarma
Todos los participantes de QAP3	237,29	6,82	44	223,64 a 250,94	-8,26	-2,87	Alarma
Participantes QAP misma metodología1	237,41	6,85	43	223,7 a 251,12	-8,3	-2,88	Alarma

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

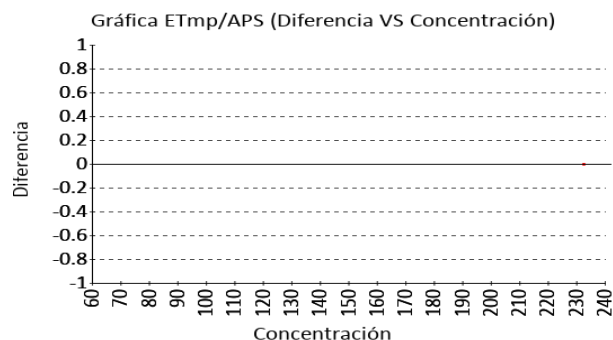



Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100175
Ronda:	61
Muestra:	3
Código Muestra:	FR1304
Fecha reporte:	2025-04-07
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)



Creatinina

1.65 mg/dL Roche Cobas c111 Enzymatic IFCC-IDMS Standardized CLIA 2022 10% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	1,73	0,06	2038	1,61 a 1,85	-4,62	-1,33	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*El comportamiento de este grupo de datos, no sigue una distribución estadística normal. La evaluación de este grupo se realiza en el anexo 1

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

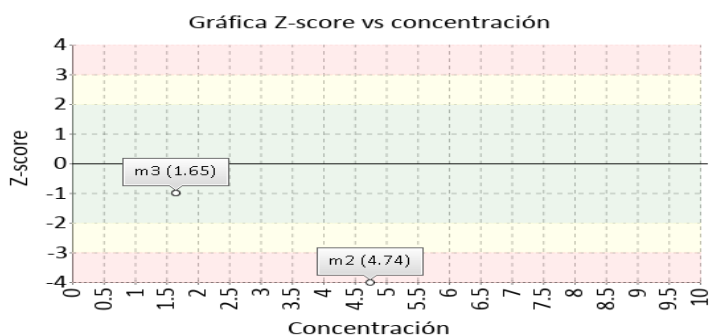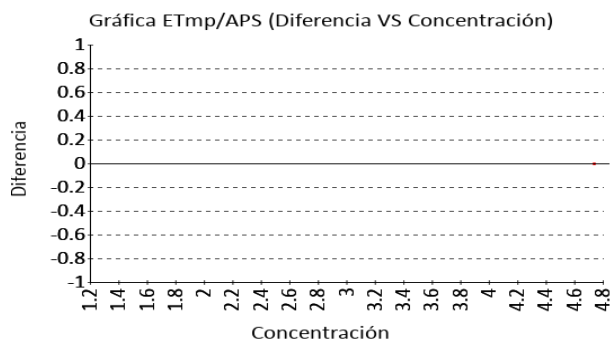



Creatinina

1.66 mg/dL Cobas C111 Enzymatic IFCC-IDMS Standardized CLIA 2022 10% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	1,73	0,06	2038	1,61 a 1,85	-4,05	-1,17	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*El comportamiento de este grupo de datos, no sigue una distribución estadística normal. La evaluación de este grupo se realiza en el anexo 1

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

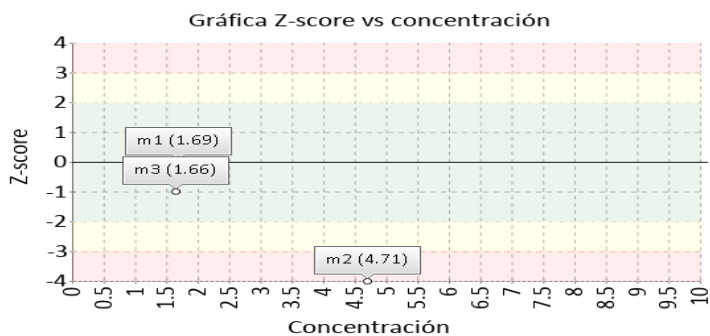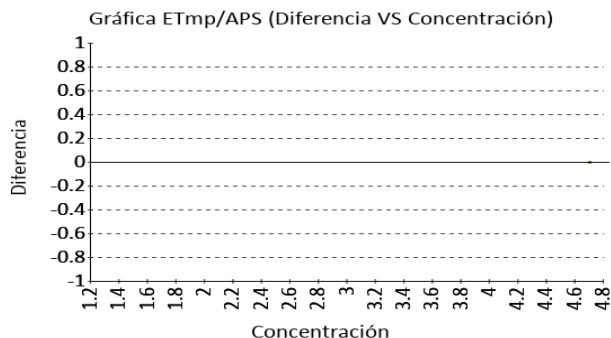



Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100175
Ronda:	61
Muestra:	3
Código Muestra:	FR1304
Fecha reporte:	2025-04-07
Estado:	Evaluación original

4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Glucosa

80.8 mg/dL Roche Cobas c111



Hexokinase

CLIA
2022

8% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	82,78	2,54	4394	77,7 a 87,86	-2,39	-0,78	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	83,6	3,03	45	77,55 a 89,66	-3,35	-0,93	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	83,1	2,63	38	77,84 a 88,37	-2,77	-0,87	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

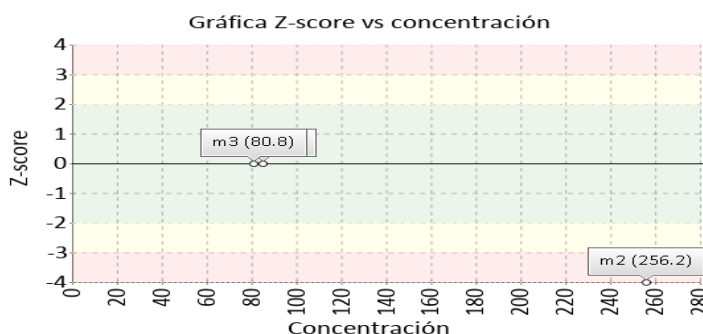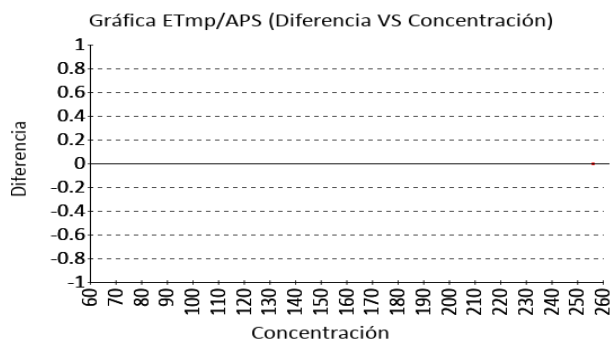

Glucosa

79 mg/dL Cobas C111



Hexokinase

CLIA
2022

8% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	82,78	2,54	4394	77,7 a 87,86	-4,57	-1,49	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	83,6	3,03	45	77,55 a 89,66	-5,51	-1,52	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología ¹	83,1	2,63	38	77,84 a 88,37	-4,94	-1,56	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

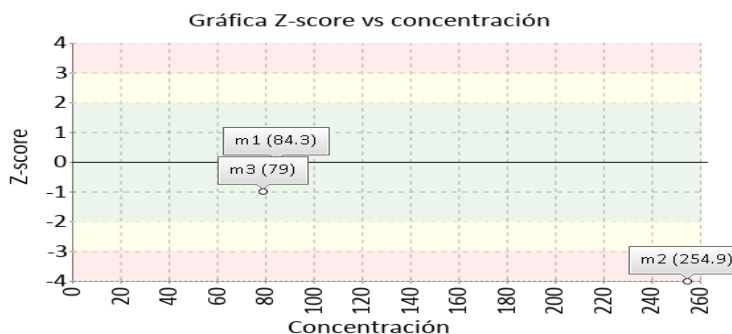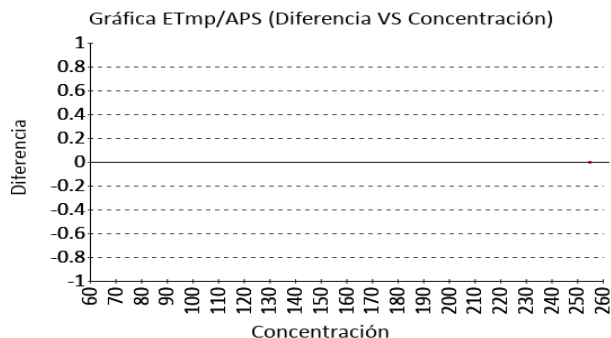



Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea

Identificación Laboratorio:	100175
Ronda:	61
Muestra:	3
Código Muestra:	FR1304
Fecha reporte:	2025-04-07
Estado:	Evaluación original



4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON X_{PT} (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)

Triglicéridos

163.6 mg/dL Roche Cobas c111 Enzymatic, end point CLIA 2022 15% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	165,7	4,33	2789	157,04 a 174,36	-1,27	-0,48	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	168,57	7,46	43	153.65 a 183.49	-2,95	-0,67	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	168,96	6,49	38	155.99 a 181.94	-3,17	-0,83	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

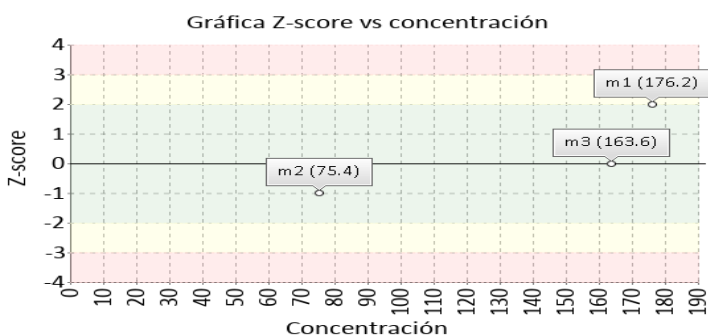
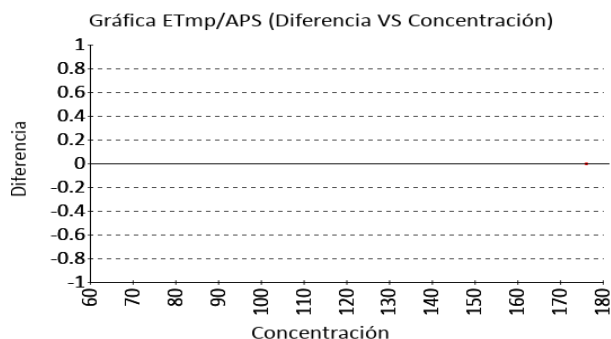


Triglicéridos

157.6 mg/dL Cobas C111 Enzymatic, end point CLIA 2022 15% APS

1 Fuente de comparación	2 X_{pt}	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	165,7	4,33	2789	157,04 a 174,36	-4,89	-1,87	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP3	168,57	7,46	43	153.65 a 183.49	-6,51	-1,47	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología1	168,96	6,49	38	155.99 a 181.94	-6,73	-1,75	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

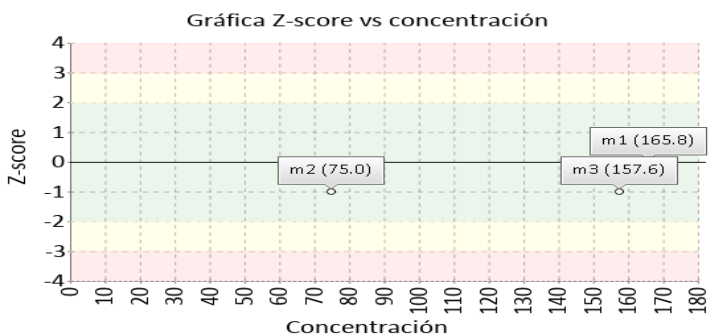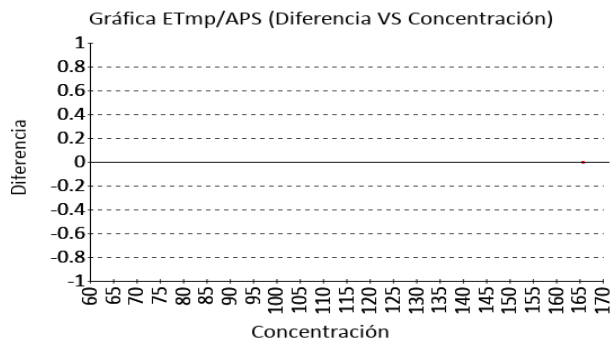

 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea	Identificación Laboratorio:	100175
		Ronda:	61
		Muestra:	3
		Código Muestra:	FR1304
		Fecha reporte:	2025-04-07
		Estado:	Evaluación original

5. INFORME DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	Mensurando	Analizador	Metodología declarada por el fabricante	Metodología de referencia avalada por el JCTLM	Material trazable declarado por el fabricante	Material de referencia avalado por el JCTLM	Estado de trazabilidad
1	ALT (ALAT/GPT)	Roche Cobas c111	UV without P5P	141	No declarado	134	Trazable por metodología
2	AST (ASAT/GOT)	Roche Cobas c111	UV without P5P	142	No declarado	135	Trazable por metodología
3	Colesterol HDL	Roche Cobas c111	Direct Enzymatic Colorimetric		No declarado	137	No trazable
4	Colesterol HDL	Cobas C111	Direct Enzymatic Colorimetric		No declarado	137	No trazable
5	Colesterol Total	Roche Cobas c111	Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase		No declarado	139	No trazable
6	Colesterol Total	Cobas C111	Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase		No declarado	139	No trazable
7	Creatinina	Roche Cobas c111	Enzymatic IFCC-IDMS Standardized	143	No declarado		Trazable por metodología
8	Creatinina	Cobas C111	Enzymatic IFCC-IDMS Standardized	143	No declarado		Trazable por metodología
9	Glucosa	Roche Cobas c111	Hexokinase		No declarado	142	No trazable
10	Glucosa	Cobas C111	Hexokinase		No declarado	142	No trazable
11	Triglicéridos	Roche Cobas c111	Enzymatic, end point		No declarado		No trazable
12	Triglicéridos	Cobas C111	Enzymatic, end point		No declarado		No trazable

Nomenclatura método
141: IFCC **142:** IFCC **143:** ID/GC/MS **143:** ID/GC/MS

Nomenclatura materiales
134: ERM-AD454k/IFCC **135:** ERM-AD457/IFCC **137:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3008A **137:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3008A **139:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3008A **139:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3008A **142:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3007A **142:** LNE CRM Bio 101a - HRM-3007A

 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea	Identificación		100175
		Laboratorio:		
		Ronda:		61
		Muestra:		3
		Código Muestra:		FR1304
		Fecha reporte:		2025-04-07
		Estado:		Evaluación original

6. RESUMEN DE RONDA



Ítem	Mensurando	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Muestra 4			Muestra 5			Muestra 6		
		Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP
1	ALT (ALAT/GPT)	N/A	1,43	N/A	N/A	-1,89	-2,05	N/A	-0,17	-0,26									
2	AST (ASAT/GOT)	N/A	1,26	0	N/A	-0,81	-1,36	N/A	0,95	-0,45									
3	Colesterol HDL	N/A	-0,15	0,42	N/A	-1,92	-1,2	N/A	-0,94	-0,9									
4	Colesterol HDL	N/A	-0,3	0,13	N/A	-1,95	-1,25	N/A	-0,97	-0,96									
5	Colesterol Total	N/A	0,82	0,62	N/A	-2,7	-2,35	N/A	-0,36	-0,57									
6	Colesterol Total	N/A	-0,45	-0,75	N/A	-2,54	-2,2	N/A	-2,55	-2,87									
7	Creatinina	N/A	-1,33	-0,69	N/A	-4,64	-2,41	N/A	-1,33	N/A									
8	Creatinina	N/A	-0,67	1,09	N/A	-4,86	-2,55	N/A	-1,17	N/A									
9	Glucosa	N/A	0,87	1,1	N/A	-5,31	-2,9	N/A	-0,78	-0,93									
10	Glucosa	N/A	0,6	0,72	N/A	-5,51	-3,02	N/A	-1,49	-1,52									
11	Triglicéridos	N/A	2,42	1,16	N/A	-1,4	-0,9	N/A	-0,48	-0,67									
12	Triglicéridos	N/A	0,02	-0,43	N/A	-1,46	-0,97	N/A	-1,87	-1,47									
Notificaciones		0 0 0 0			0 0 0 0			0 0 0 0			0 0 0 0			0 0 0 0			0 0 0 0		

X_{pt} - La diferencia porcentual es inferior o igual al error total máximo permisible.	X_{pt} - La diferencia porcentual es superior al error total máximo permisible.	Satisfactorio si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	Alarma si su resultado está entre +/- 2 y +/- 3 Z-score.	No satisfactorio si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score.	N/A No aplica	Tardío Ausente Revalorado
---	---	---	--	--	----------------------	---

 “Quality Assurance Program” Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica	Quality Assurance Program PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO QAP-Q - Química sanguínea		Identificación	100175
			Laboratorio:	
			Ronda:	61
			Muestra:	3
			Código Muestra:	FR1304
			Fecha reporte:	2025-04-07
			Estado:	Evaluación original

7. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA

7.1. DESEMPEÑO PARA LAS 3 MUESTRAS

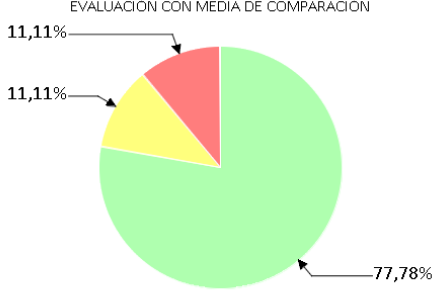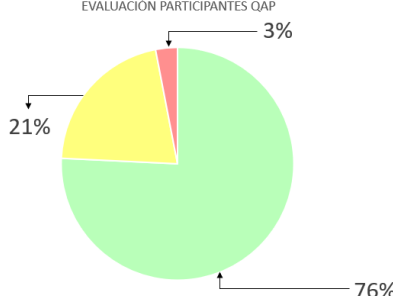EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN 			EVALUACIÓN CON RL-MMT-JCTLM.		EVALUACIÓN PARTICIPANTES QAP 		
Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio	Satisfactorio	No satisfactorio	Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
28	4	4	0	0	25	7	1
77,78%	11,11%	11,11%	0%	0%	75.76%	21.21%	3.03%

Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte --

María Paula Mora G.

Aprobado por:
Coordinador QAP
Programas QAP

Coordinador QAP:
María Paula Mora Gamboa
Contacto: 3174399931
Correo: maria.mora@quik.com.co

Anexo 1: Evaluación de analitos que no siguen una distribución normal

Con el fin de fortalecer la validez y solidez metodológica del reporte estadístico del Programa QAP, y en cumplimiento con los requisitos establecidos en la norma ISO 13528:2022 (numerales 5.3 y 6.5), se llevó a cabo un análisis estadístico para evaluar la distribución de los resultados reportados por los laboratorios participantes en los mensurandos listados en la siguiente tabla.

Los resultados de dicho análisis revelaron que los datos obtenidos no cumplen con los supuestos de normalidad requeridos. Por lo tanto, y siguiendo las recomendaciones establecidas en la norma mencionada, se optó por implementar el estadístico Z Robusto (Z^*) como alternativa metodológica, reemplazando así al tradicional Z Score en la evaluación del desempeño de los laboratorios participantes.

$$Z^* = \frac{u - Mediana}{IQR / 1.349}$$

IT	Mensurando	Resultado reportado	Mediana	IQR	Z^*	Valoración
1	Creatinina	1,65	1,69	0,09	-0,6	✓ Satisfactorio
2	Creatinina	1,66	1,69	0,09	-0,45	✓ Satisfactorio