



QAP-Uroanalisis

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE **CALIDAD**

QAP-U - Uroanálisis

CHRISTUS SINERGIA SEDE LAB SATELITE CLINICA PALMA

Correo electrónico: angelica.pardo@christus.co Dirección: Carrera 28 #44-35 Laboratorio clínico Piso 1

Ciudad: Palmira Valle del Cauca

País: Colombia

Contacto: Angelica Paola Pardo

Teléfono: 3105241863

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100235

Código de reporte: QAP-U-100235-46-1

Ronda: 46 Muestra: 1

Código de la muestra: QR0920

Tipo de muestra: Líquido -Orina humana Fecha generación: 02 / mayo / 2024



QAP-U - Uroanálisis

Identificación	100235
Laboratorio:	
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	QR0920
Fecha reporte:	2024-04-30
Estado:	Evaluación original

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 ¹, ISO 14001:2015 ², ISO 45001:2018 ³ y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ⁴, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos.

Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc.



QAP-U - Uroanálisis

Identificación	100235
Laboratorio:	
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	QR0920
Fecha reporte:	2024-04-30
Estado:	Evaluación original

2. INFORME DE EVALUACIÓN DE LA MUESTRA 2.1. INFORME FÍSICO QUÍMICO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Notificaciones	Mensurando	Analizador	Método	Su resultado	Referencia	Desempeño	Evaluación
1		Bilirrubina	Roche Cobas U411	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	Ø
2		Cetonas	Roche Cobas U411	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	②
3		Glucosa	Roche Cobas U411	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	②
4		Gravedad específica	Roche Cobas U411	Tira Reactiva	1005 hasta 1015	1005 hasta 1025	Satisfactorio	②
5		HCG urinaria cualitativa	Roche Cobas U411	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	②
6		Leucocito Esterasa	Roche Cobas U411	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	•
10		Nitrito	Roche Cobas U411	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	②
11		рН	Roche Cobas U411	Tira Reactiva	5.0 hasta 6.0	5.0 hasta 7.0	Satisfactorio	•
12		Proteínas	Roche Cobas U411	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	
13		Urobilinógeno	Roche Cobas U411	Tira Reactiva	Negativo	Normal*	Satisfactorio	②

Puntaje	10 / 10	
% Concordancia	100%	

<u>Satisfactorio:</u> El resultado de su laboratorio es igual a la referencia. No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia. Resultado tardío

X Resultado ausente

Resultado revalorado



QAP-U - Uroanálisis

Identificación	100235
Laboratorio:	
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	QR0920
Fecha reporte:	2024-04-30
Estado:	Evaluación original

2. INFORME DE EVALUACIÓN DE LA MUESTRA

2.2. INFORME ANÁLISIS MICROSCÓPICO/SEDIMENTO URINARIO

1	2	3	4	5	6	,	8	9
Ítem	Notificaciones	Mensurando	Analizador	Método	Su resultado	Referencia	Desempeño	Evaluación
7		Microscopia: Cristales	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio	Ø
8		Microscopia: Recuento de Leucocitos	Microscópico	Microscópico	0 hasta 3	0 hasta 5	Satisfactorio	②
9		Microscopia: Recuento de rojos	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio	②
		necuemo de rojos						

Puntaje	3 / 3
% Concordancia	100%

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la	No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la	\$	\boxtimes	AF.
referencia.	referencia.	Resultado tardío	Resultado ausente	Resultado revalorado



QAP-U - Uroanálisis

Identificación Laboratorio:	100235
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	QR0920
Fecha reporte:	2024-04-30
Estado:	Evaluación original

3. RESUMEN DE RONDA

Ítem	Mensurando	% de concordancia	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Muestra 4	Muestra 5	Muestra 6
1	Bilirrubina	100%	Negativo				-	-
2	Cetonas	100%	Negativo					
3	Glucosa	100%	Negativo					
4	Gravedad específica	100%	1005 hasta 1015					
5	HCG urinaria cualitativa	100%	Negativo					
6	Leucocito Esterasa	100%	Negativo					
7	Microscopia: Cristales	100%	Ausente					
8	Microscopia: Recuento de Leucoci	tos 100%	0 hasta 3					
9	Microscopia: Recuento de rojos	100%	0 hasta 5					
10	Nitrito	100%	Negativo					
11	рН	100%	5.0 hasta 6.0					
12	Proteínas	100%	Negativo					
13	Urobilinógeno	100%	Negativo					


Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la	No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la	\$	\boxtimes	
referencia.	referencia.	Resultado tardío	Resultado ausente	Resultado revalorado





QAP-U - Uroanálisis

Identificación	100235
Laboratorio:	
Ronda:	46
Muestra:	1
Código Muestra:	QR0920
Fecha reporte:	2024-04-30
Estado:	Evaluación original

4. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA



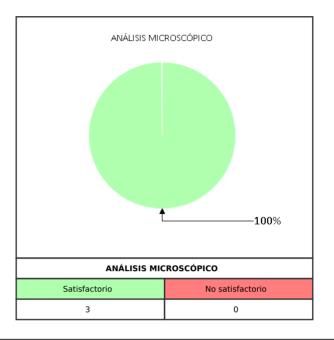



-- Final de reporte --

Aprobado por: Especialista de aplicaciones Programas QAP