



"Quality Assurance Program"

Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica



PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
QAP-U - Uroanálisis

BIOMED VIDA SAS

Correo electrónico: carmelobacte@hotmail.com

Dirección: Calle 10 # 12-17

Ciudad: Cauca Antioquia

País: Colombia

Contacto: Carmelo Causil

Teléfono: 3205768861

IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100120

Código de reporte: QAP-U-100120-38-6

Ronda: 38

Muestra: 6

Código de la muestra: SS7612

Tipo de muestra: Líquido -Orina humana

Fecha generación: 31 / marzo / 2023

Identificación Laboratorio:	100120
Ronda:	38
Muestra:	6
Código Muestra:	SS7612
Fecha reporte:	2023-03-27
Estado:	Evaluación original

1. TÉRMINOS GENERALES

Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 ¹, ISO 14001:2015 ², ISO 45001:2018 ³ y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 ⁴, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos.











Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. y para los programas de patología anatómica con la fundación Santa Fé de Bogotá

Identificación Laboratorio:	100120
Ronda:	38
Muestra:	6
Código Muestra:	SS7612
Fecha reporte:	2023-03-27
Estado:	Evaluación original

2. INFORME DE EVALUACIÓN DE LA MUESTRA

2.1. INFORME FÍSICO QUÍMICO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Notificaciones	Mensurando	Analizador	Método	Su resultado	Referencia	Desempeño	Evaluación
1		Bilirrubina	Manual	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	
2		Cetonas	Manual	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	
3		Glucosa	Manual	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	
4		Gravedad específica	Manual	Tira Reactiva	1015	1005 hasta 1025	Satisfactorio	
5		Leucocito Esterasa	Manual	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	
9		Nitrito	Manual	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	
10		pH	Manual	Tira Reactiva	5.0	5.0 hasta 7.0	Satisfactorio	
11		Proteínas	Manual	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	
12		Sangre	Manual	Tira Reactiva	Negativo	Negativo	Satisfactorio	
13		Urobilinógeno	Manual	Tira Reactiva	Normal	0.2 mg/dL*	Satisfactorio	

Puntaje	10 / 10
% Concordancia	100%



"Quality Assurance Program"
Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica

Quality Assurance Program
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO
QAP-U - Uroanálisis

Identificación Laboratorio:	100120
Ronda:	38
Muestra:	6
Código Muestra:	SS7612
Fecha reporte:	2023-03-27
Estado:	Evaluación original

2. INFORME DE EVALUACIÓN DE LA MUESTRA

2.2. INFORME ANÁLISIS MICROSCÓPICO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Notificaciones	Mensurando	Analizador	Método	Su resultado	Referencia	Desempeño	Evaluación
6		Microscopia: Cristales	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio	
7		Microscopia: Recuento de Leucocitos	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio	
8		Microscopia: Recuento de rojos	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio	



Puntaje	3 / 3
% Concordancia	100%

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia.	No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia.	Resultado tardío	Resultado ausente	Resultado revalorado
--	---	------------------	-------------------	----------------------

Identificación Laboratorio:	100120
Ronda:	38
Muestra:	6
Código Muestra:	SS7612
Fecha reporte:	2023-03-27
Estado:	Evaluación original



3. RESUMEN DE RONDA

Item	Mensurando	% de concordancia	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Muestra 4	Muestra 5	Muestra 6
1	Bilirrubina	83,33%	2+	Negativo	3+	Negativo	Negativo	Negativo
2	Cetonas	100%	1+	Negativo	2+	Negativo	Negativo	Negativo
3	Glucosa	100%	1+	Negativo	2+	Negativo	Negativo	Negativo
4	Gravedad específica	100%	1020	1015	1015	1020	1015	1015
5	Leucocito Esterasa	83,33%	2+	Negativo	2+	Negativo	Negativo	Negativo
6	Microscopia: Cristales	83,33%	Presentes	Ausentes	Presentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes
7	Microscopia: Recuento de Leucocitos	83,33%	36 o más	0 hasta 5	36 o más	0 hasta 5	0 hasta 5	0 hasta 5
8	Microscopia: Recuento de rojos	83,33%	36 o más	0 hasta 5	36 o más	0 hasta 5	0 hasta 5	0 hasta 5
9	Nitrito	83,33%	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo
10	pH	83,33%	7.0	6.0	6.5	6.0	5.0	5.0
11	Proteínas	83,33%	2+	Negativo	3+	Negativo	Negativo	Negativo
12	Sangre	83,33%	3+	Negativo	3+	Negativo	Negativo	Negativo
13	Urobilinógeno	83,33%	2+	Normal	2+	Normal	Normal	Normal

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia.	No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia.	 Resultado tardío	<input checked="" type="checkbox"/> Resultado ausente	 Resultado revalorado
--	---	--	---	--

Identificación Laboratorio:	100120
Ronda:	38
Muestra:	6
Código Muestra:	SS7612
Fecha reporte:	2023-03-27
Estado:	Evaluación original

4. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA

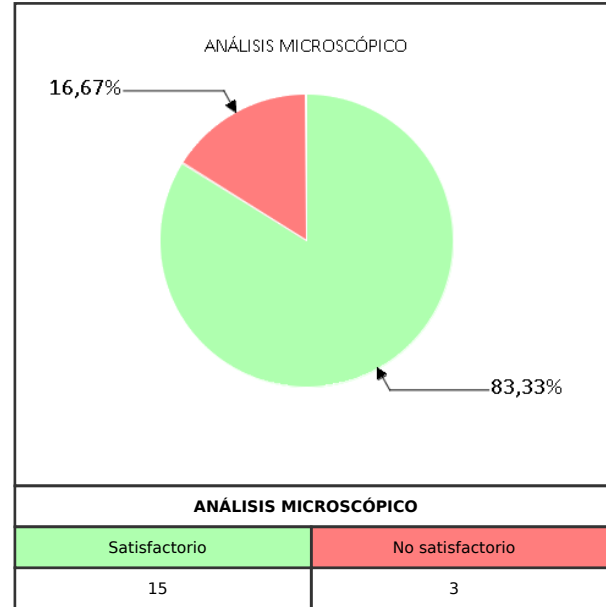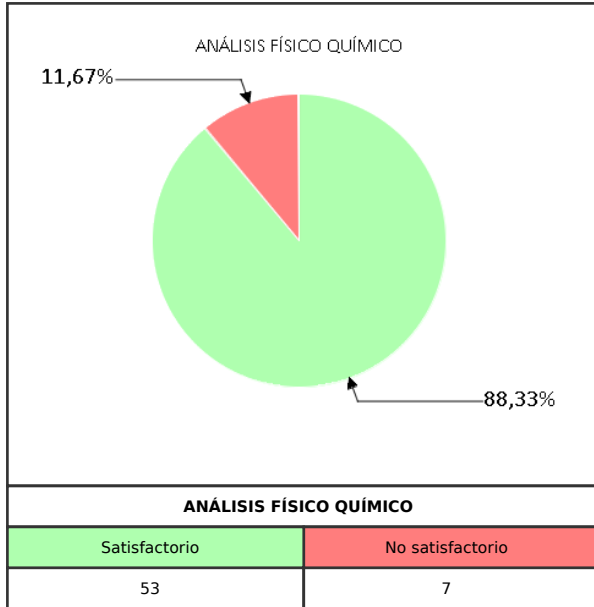

Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte --

Aprobado por:
Aída Porras. Magister en Biología. Doctor in management.
Coordinadora programas QAP