



Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-Hb-Hemoglobina
Código de muestra: DI3609
Ronda: 4
Muestra: 3
Septiembre 2024
Ciudad : Bogotá Distrito Capital, Cali Valle del Cauca, Medellín Antioquia


100232 - Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali
100233 - Christus Sinergia sede Gran vía Medellín
100237 - Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102

Analito : Hemoglobina A1C


| IT | # laboratorio | Sede | año | mes | instrumento | resultado | unidad | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|---|------|----------------|-------------------------|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1 | 100232 | Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali | 2024 | SEPTIEMBR E | Roche Cobas 6000 (c501) | 5.2 | % | 5.090 | 0,57 |
| 2 | 100233 | Christus Sinergia sede Gran vía Medellín | 2024 | SEPTIEMBR E | Roche Cobas 6000 (c501) | 5.1 | % | 5.090 | 0,05 |
| 3 | 100237 | Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102 | 2024 | SEPTIEMBR E | Roche Cobas c111 | 5.16 | % | 5.150 | 0,05 |

| | | |
|--|---|---|
| Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score | Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|--|---|---|

Gráfica 1 Z-score

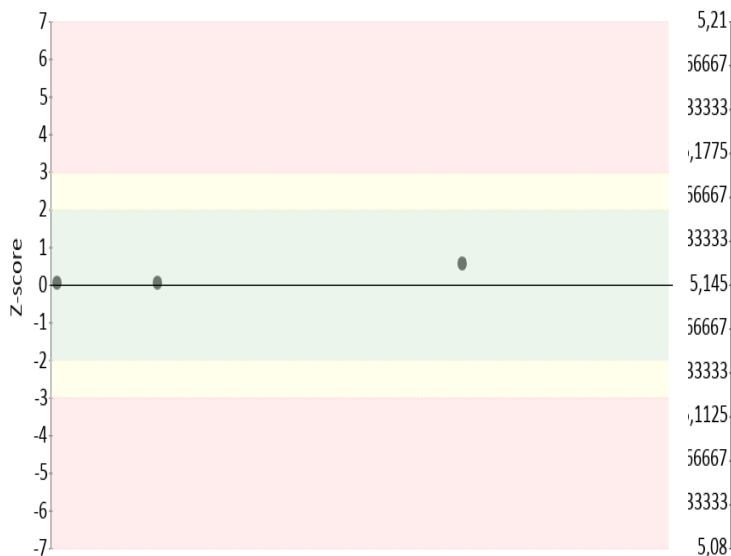

Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación

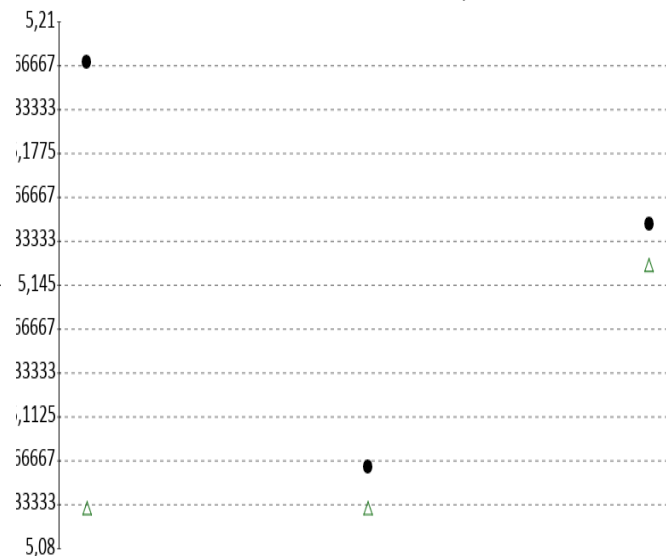

● Resultado △ Media de comparación

| valor | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 100% |