



INFORME DE FIN DE RONDA
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-I Inmunoensayo
Ronda 38
2022-08-26 - 2023-06-30

100195 Clinica Santa Ana

E-mail: laboratorio@clnicasantaanasa.com
Dirección: Av 11E # 8-41 Barrio Colsag
Ciudad: Cúcuta Norte de Santander
País: Colombia
Contacto: Sergio Rubio
Teléfono: 3007579609

AFP (ng/mL)

Analizador: Finecare | Generación vitros: N/A

Metodología: FIA | Reactivo: Finecare | Material: No declarado


V.A.V

Material	1	2	3	4	5	6
Muestra	AK7528 [M2]	AK7529 [M3]	AK7527 [M1]	AK0114 [M5]	AK9674 [M6]	AK7530 [M4]
Valor reportado por el laboratorio	22.7	144.4	241.9	20.4	154.8	273.7
Evaluación con media de comparación	16.46	94.02	208.8	17.35	91.98	196.6
JCTLM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP	17.13	103.11	217.28	19.61	111.39	152
Participantes QAP misma metodología	22.7	144.4	241.9	20.4	154.8	141.75


Interpretación color evaluación con media de comparación: ■ WRR mensual ■ WWR acumulada ■ Inserto ■ Consenso

Gráficas de correlación


Evaluación con media de comparación

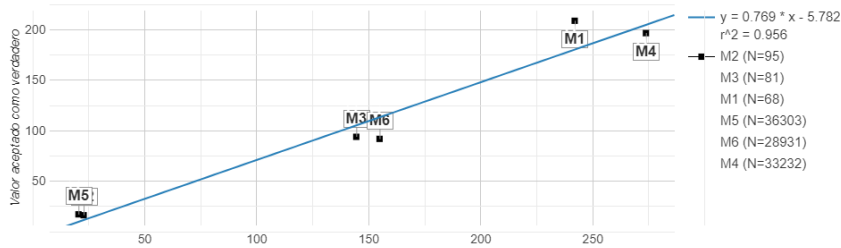


Evaluación JCTLM

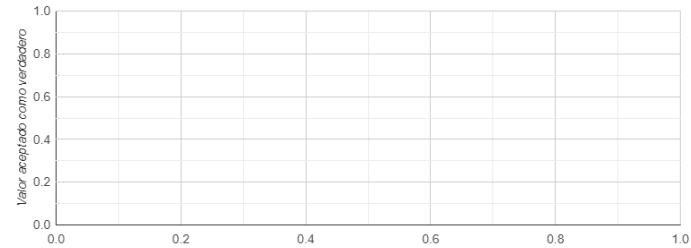

Evaluación consenso QAP

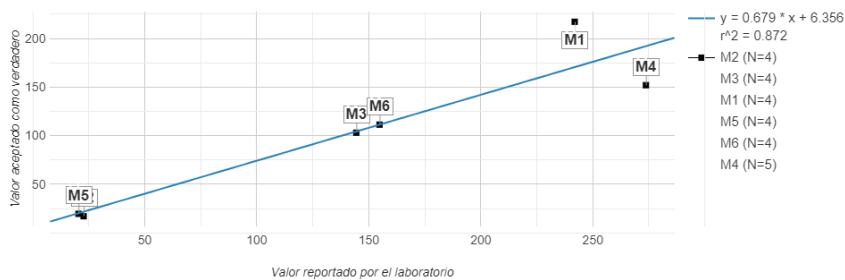

Evaluación consenso QAP misma metodología

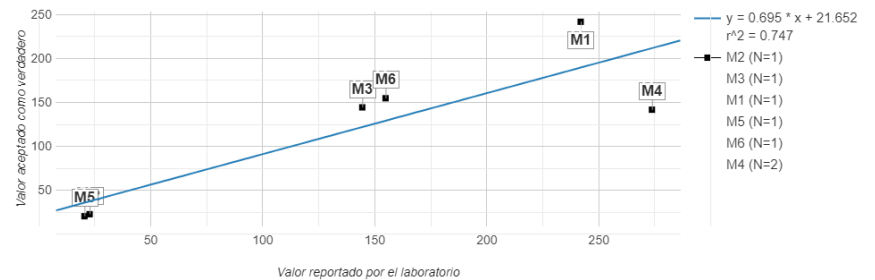

Laboratorio:	100195
Ronda:	38
Fecha generación:	2023/08/11
Página:	3 de 8

CEA (ng/mL)

Analizador: Finecare | Generación vitros: N/A

Metodología: FIA | Reactivo: Finecare | Material: No declarado

V.A.V

Material	1	2	3	4	5	6
Muestra	AK7528 [M2]	AK7529 [M3]	AK7527 [M1]	AK0114 [M5]	AK9674 [M6]	AK7530 [M4]
Valor reportado por el laboratorio	1.0	13.6	41.4	1.0	17.1	31.7
Evaluación con media de comparación	1.44	8.78	43.4	1.91	17.82	34.66
JCTLM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP	2.12	16.33	38.29	1.77	19.48	26.35
Participantes QAP misma metodología	1.6	13.6	24.53	1.17	17.1	17.75

Interpretación color evaluación con media de comparación:

■ WRR mensual


■ WWR acumulada

■ Inserto


■ Consenso

Gráficas de correlación


Evaluación con media de comparación

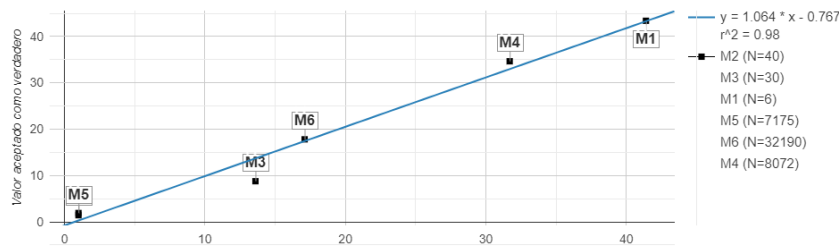


Evaluación JCTLM

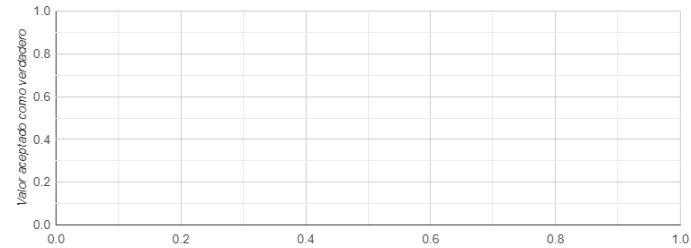

Evaluación consenso QAP

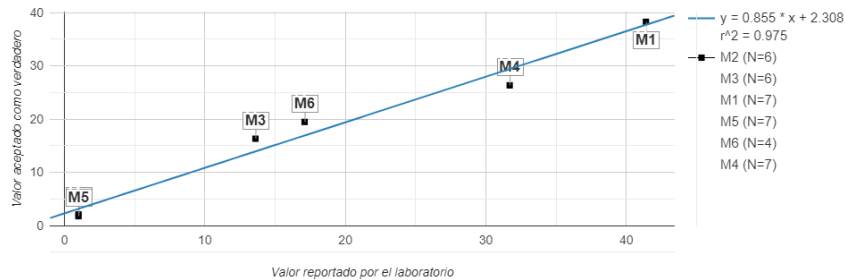

Evaluación consenso QAP misma metodología

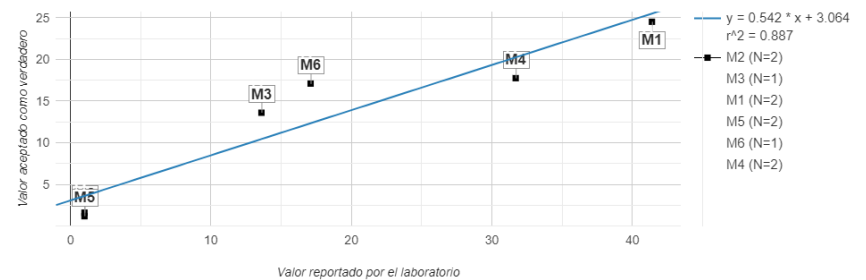

Laboratorio:	100195
Ronda:	38
Fecha generación:	2023/08/11
Página:	4 de 8

Ferritina (ng/mL)

Analizador: CM-250 | Generación vitros: N/A

Metodología: Immunoturbidimetric | Reactivo: Wiener | Material: No declarado


V.A.V

Material	1	2	3	4	5	6
Muestra	AK7528 [M2]	AK7529 [M3]	AK7527 [M1]	AK0114 [M5]	AK9674 [M6]	AK7530 [M4]
Valor reportado por el laboratorio	65	124	315	N/A	N/A	N/A
Evaluación con media de comparación	74.8	162.4	322.5	N/A	N/A	N/A
JCTLM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP	56.22	121.37	333.52	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología	65	124	315	N/A	N/A	N/A


Interpretación color evaluación con media de comparación: ■ WRR mensual ■ WWR acumulada ■ Inserto ■ Consenso

Gráficas de correlación


Evaluación con media de comparación

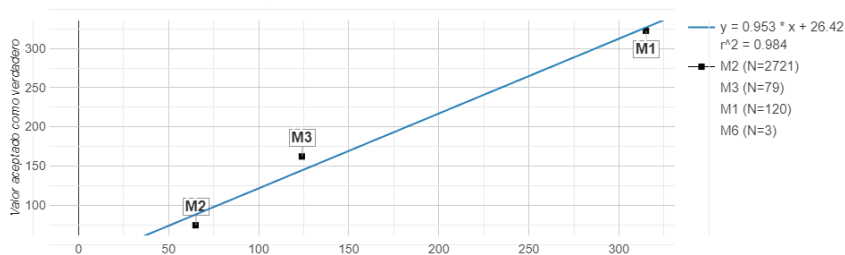


Evaluación JCTLM

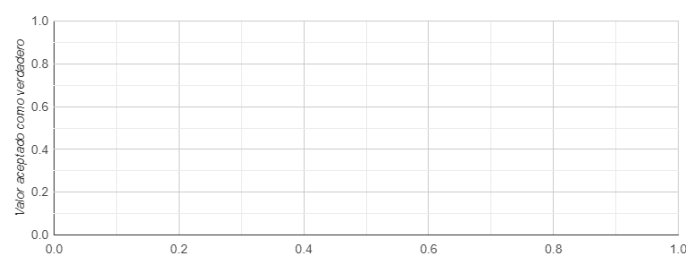

Evaluación consenso QAP

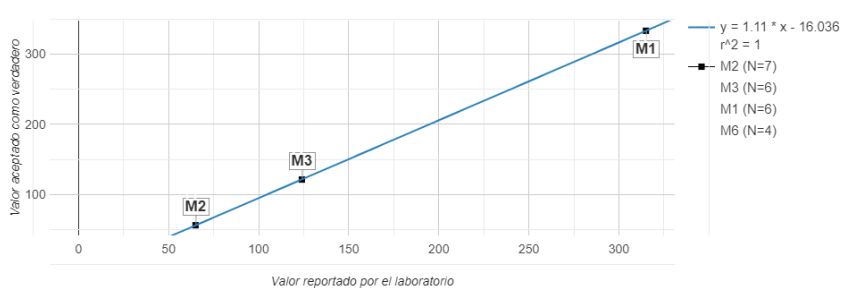

Evaluación consenso QAP misma metodología

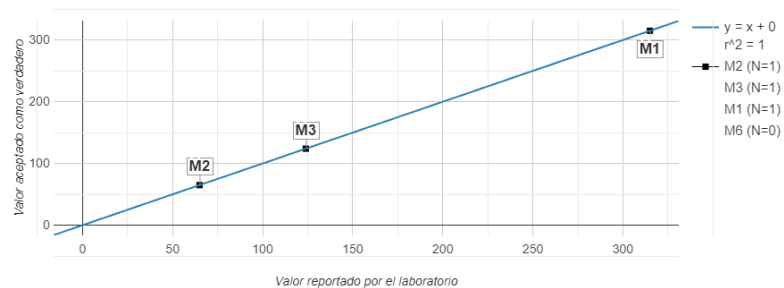

Laboratorio:	100195
Ronda:	38
Fecha generación:	2023/08/11
Página:	5 de 8

HCG cuantitativa (mUI/mL)

Analizador: Finecare | Generación vitros: N/A

Metodología: FIA | Reactivo: Finecare | Material: No declarado


V.A.V

Material	1	2	3	4	5	6
Muestra	AK7528 [M2]	AK7529 [M3]	AK7527 [M1]	AK0114 [M5]	AK9674 [M6]	AK7530 [M4]
Valor reportado por el laboratorio	2.0	7.39	251.7	2.0	41.11	141.9
Evaluación con media de comparación	6.97	27.71	223.6	7.12	22.21	169.6
JCTLM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP	7.16	21.45	205.58	6.59	22.21	155.47
Participantes QAP misma metodología	2	7.39	251.7	2	41.11	141.9


Interpretación color evaluación con media de comparación: ■ WRR mensual ■ WWR acumulada ■ Inserto ■ Consenso

Gráficas de correlación


Evaluación con media de comparación

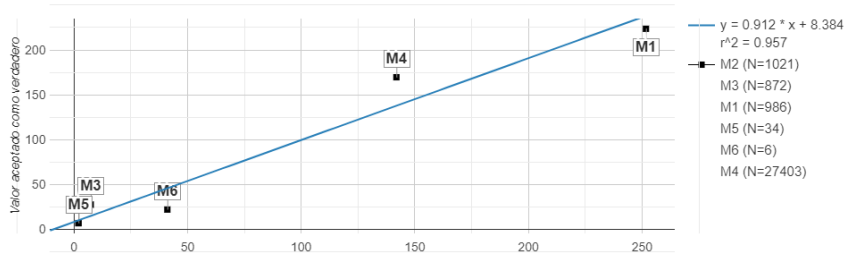


Evaluación JCTLM

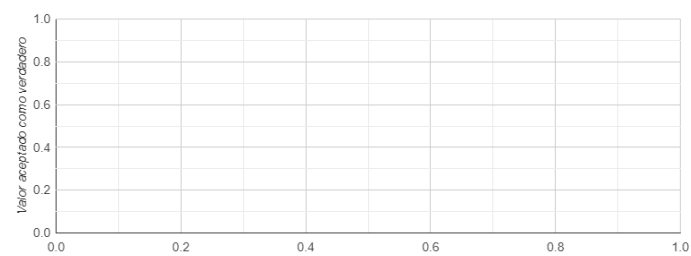

Evaluación consenso QAP

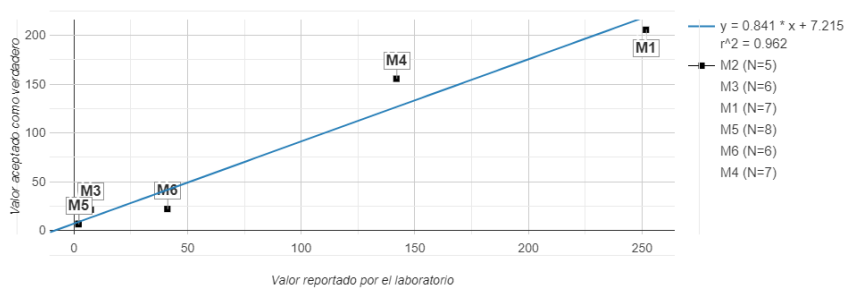

Evaluación consenso QAP misma metodología

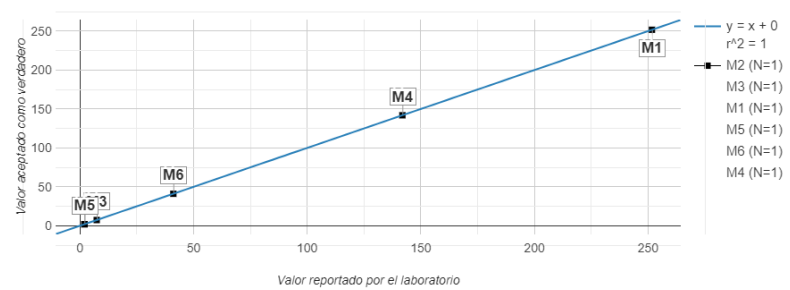

PSA total (ng/mL)

Analizador: Finecare | Generación vitros: N/A

Metodología: FIA | Reactivo: Finecare | Material: No declarado


V.A.V

Material	1	2	3	4	5	6
Muestra	AK7528 [M2]	AK7529 [M3]	AK7527 [M1]	AK0114 [M5]	AK9674 [M6]	AK7530 [M4]
Valor reportado por el laboratorio	1.6	6.8	38.8	2.3	8.3	53.6
Evaluación con media de comparación	1.1	3.33	19.76	0.89	3.21	20.7
JCTLM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP	1.04	3.28	20.6	0.88	3.36	20.09
Participantes QAP misma metodología	1.6	6.8	38.8	2.3	8.3	53.6


Interpretación color evaluación con media de comparación: ■ WRR mensual ■ WWR acumulada ■ Inserto ■ Consenso

Gráficas de correlación


Evaluación con media de comparación

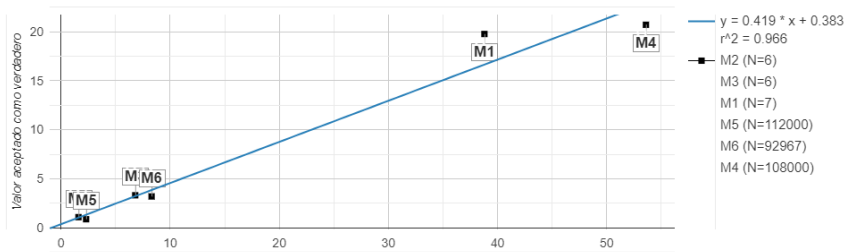


Evaluación JCTLM

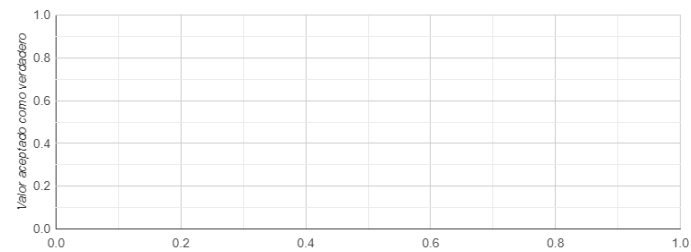

Evaluación consenso QAP

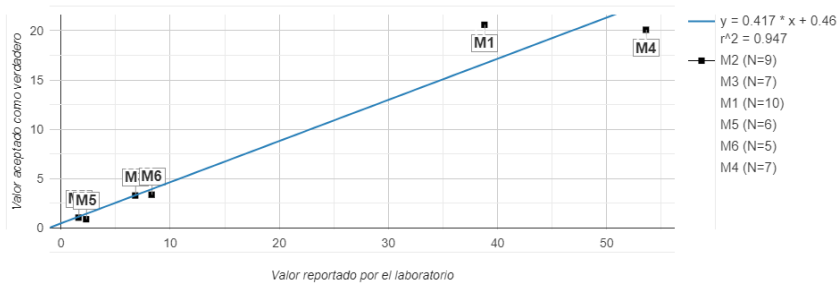

Evaluación consenso QAP misma metodología

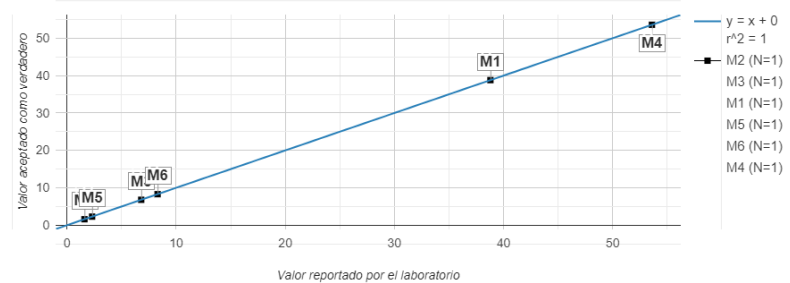

Laboratorio:	100195
Ronda:	38
Fecha generación:	2023/08/11
Página:	7 de 8

T4 libre (ng/dL)

Analizador: Finecare | Generación vitros: N/A

Metodología: FIA | Reactivo: Finecare | Material: No declarado


V.A.V

Material	1	2	3	4	5	6
Muestra	AK7528 [M2]	AK7529 [M3]	AK7527 [M1]	AK0114 [M5]	AK9674 [M6]	AK7530 [M4]
Valor reportado por el laboratorio	2.42	1.82	4.24	0.88	1.4	2.51
Evaluación con media de comparación	0.99	2.91	4.32	0.94	3.14	4.31
JCTLM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP	1.12	2.93	4.59	0.9	2.38	3.97
Participantes QAP misma metodología	2.42	1.82	4.24	0.88	1.4	2.51


Interpretación color evaluación con media de comparación: ■ WRR mensual ■ WWR acumulada ■ Inserto ■ Consenso

Gráficas de correlación


Evaluación con media de comparación

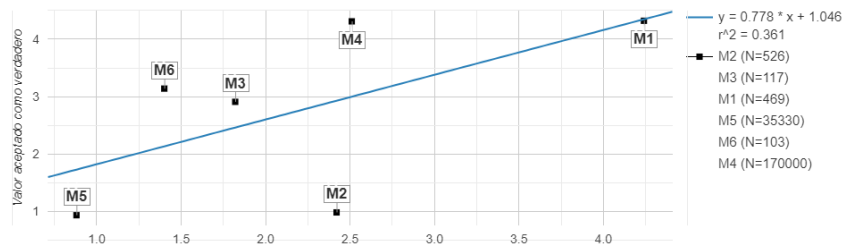


Evaluación JCTLM

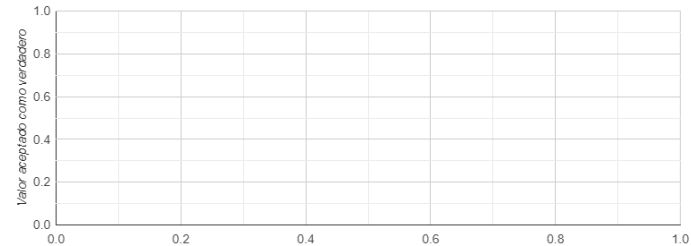

Evaluación consenso QAP

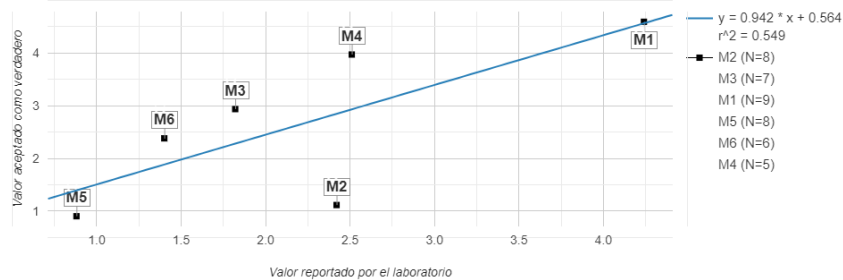

Evaluación consenso QAP misma metodología

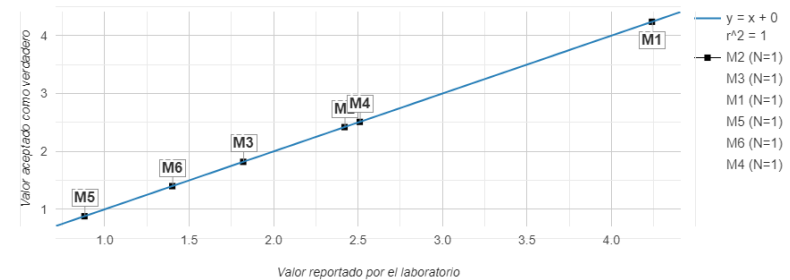

Laboratorio:	100195
Ronda:	38
Fecha generación:	2023/08/11
Página:	8 de 8

TSH (mUI/L)

Analizador: Finecare | Generación vitros: N/A

Metodología: FIA | Reactivo: Finecare | Material: No declarado

V.A.V

Material	1	2	3	4	5	6
Muestra	AK7528 [M2]	AK7529 [M3]	AK7527 [M1]	AK0114 [M5]	AK9674 [M6]	AK7530 [M4]
Valor reportado por el laboratorio	0.59	5.62	36.57	0.1	5.65	36.05
Evaluación con media de comparación	0.42	5.7	38.18	0.44	5.99	38.91
JCTLM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP	0.59	5.62	36.57	0.1	5.65	36.05
Participantes QAP misma metodología	0.59	5.62	36.57	0.1	5.65	36.05

Interpretación color evaluación con media de comparación: ■ WRR mensual ■ WWR acumulada ■ Inserto ■ Consenso

Gráficas de correlación

