




Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-H-Hematología
Código de muestra: PL2115
Ronda: 36, 38
Muestra: 4, 2
Enero, Abril, Mayo, Junio, Febrero 2023
Ciudad: Bogotá Distrito Capital

100108 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.
100170 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo
100177 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín
100178 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana
100179 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede VIP
100180 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes
100181 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo
100182 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza
100183 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda
100192 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82
100193 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio

Analito : Ancho de distribución del eritrocito

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2023	MAYO	Sysmex XP-300	17.0	%	16.32	0,43
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	14.8	%	16.32	-0,96
3	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2023	MAYO	Sysmex XP-300	14.7	%	16.32	-1,03
4	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2023	MAYO	Sysmex XP-300	14.7	%	16.32	-1,03
5	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	16.9	%	16.32	0,37
6	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2023	MAYO	Sysmex XP-300	14.7	%	16.32	-1,03
7	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2023	MAYO	Sysmex XP-300	14.9	%	16.32	-0,9
8	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2023	MAYO	Mindray BC-20S	17.7	%	16.27	0,89
9	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio	2023	MAYO	Sysmex XP-300	15.1	%	16.26	-0,76
10	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2023	JUNIO	Sysmex XP-300	14.9	%	16.26	-0,89

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score | **Alarma** Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score | **No satisfactorio** Si su resultado es mayor a 3 Z-score

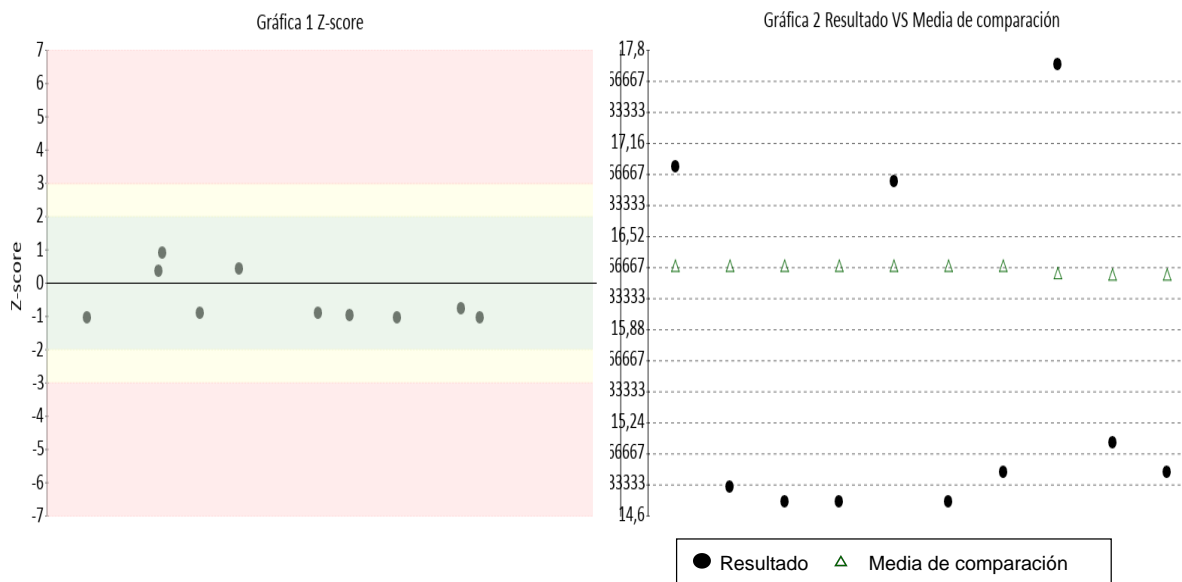


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	10	0	0	10
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Concentración de hemoglobina corpuscular media


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2023	MAYO	Sysmex XP-300	32.4	g/dL	33.62	-0,58
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	35	g/dL	33.62	0,66
3	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2023	MAYO	Sysmex XP-300	35.7	g/dL	33.62	0,99
4	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2023	MAYO	Sysmex XP-300	36.1	g/dL	33.62	1,18
5	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	31.9	g/dL	33.62	-0,82
6	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2023	MAYO	Sysmex XP-300	34.3	g/dL	33.62	0,32
7	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2023	MAYO	Sysmex XP-300	36.0	g/dL	33.62	1,13
8	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2023	MAYO	Mindray BC-20S	33.0	g/dL	33.76	-0,38
9	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Río	2023	MAYO	Sysmex XP-300	33.5	g/dL	33.49	0
10	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2023	JUNIO	Sysmex XP-300	34.8	g/dL	33.49	0,62

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 3 Z-score



Gráfica 4 Resultado VS Media de comparación





● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	10	0	0	10
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Hematocrito

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2023	MAYO	Sysmex XP-300	19.7	%	19.070	0,31
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	18	%	19.070	-0,52
3	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2023	MAYO	Sysmex XP-300	18.2	%	19.070	-0,42
4	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2023	MAYO	Sysmex XP-300	18.0	%	19.070	-0,52
5	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	20.0	%	19.070	0,45
6	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2023	MAYO	Sysmex XP-300	17.8	%	19.070	-0,62
7	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2023	MAYO	Sysmex XP-300	17.80	%	19.070	-0,62
8	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2023	MAYO	Mindray BC-20S	18.4	%	19.070	-0,33
9	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio	2023	MAYO	Sysmex XP-300	18.2	%	19.070	-0,42
10	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2023	JUNIO	Sysmex XP-300	18.4	%	19.070	-0,33

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---

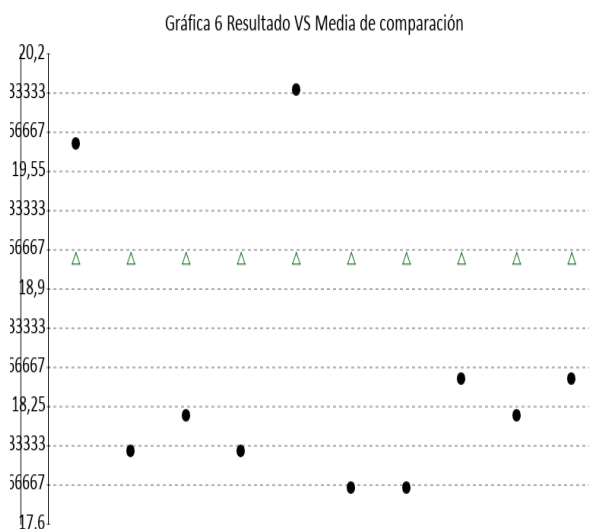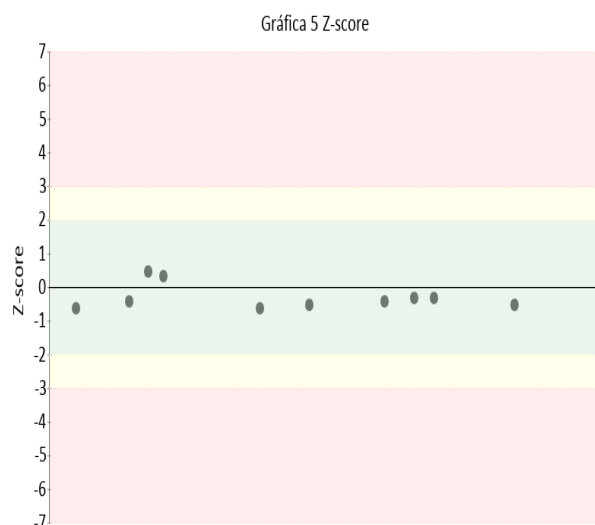

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	10	0	0	10
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Hemoglobina


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2023	MAYO	Sysmex XP-300	6.4	g/dL	6.16	1,2
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	6.3	g/dL	6.16	0,7
3	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2023	MAYO	Sysmex XP-300	6.5	g/dL	6.16	1,7
4	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2023	MAYO	Sysmex XP-300	6.5	g/dL	6.16	1,7
5	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	6.4	g/dL	6.16	1,2
6	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2023	MAYO	Sysmex XP-300	6.1	g/dL	6.16	-0,3
7	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2023	MAYO	Sysmex XP-300	6.4	g/dL	6.16	1,2
8	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2023	MAYO	Mindray BC-20S	6.1	g/dL	6.16	-0,32
9	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio	2023	MAYO	Sysmex XP-300	6.1	g/dL	6.16	-0,3
10	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2023	JUNIO	Sysmex XP-300	6.4	g/dL	6.16	1,2

Satisfactorio Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
---	---	---

Gráfica 7 Z-score



Gráfica 8 Resultado VS Media de comparación

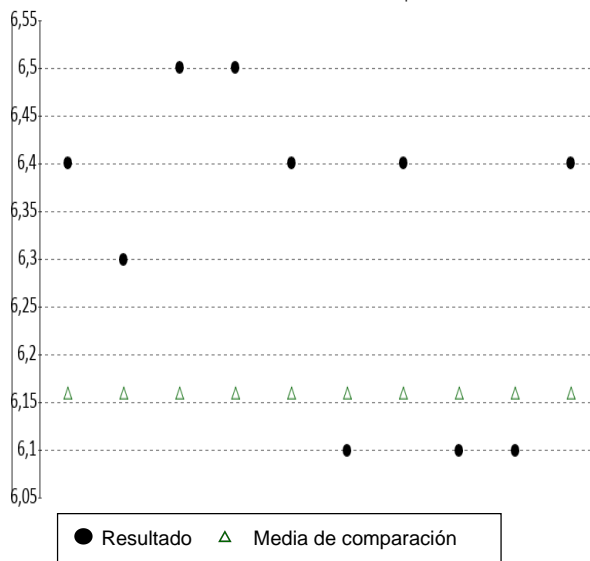


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	10	0	0	10
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Hemoglobina corpuscular media


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2023	MAYO	Sysmex XP-300	25.5	pg/cell	25.590	-0,13
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	25.8	pg/cell	25.590	0,31
3	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2023	MAYO	Sysmex XP-300	26.4	pg/cell	25.590	1,18
4	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2023	MAYO	Sysmex XP-300	26.9	pg/cell	25.590	1,91
5	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	24.7	pg/cell	25.590	-1,3
6	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2023	MAYO	Sysmex XP-300	25.2	pg/cell	25.590	-0,57
7	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2023	MAYO	Sysmex XP-300	26.9	pg/cell	25.590	1,91
8	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2023	MAYO	Mindray BC-20S	25.8	pg/cell	25.590	0,31
9	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio	2023	MAYO	Sysmex XP-300	24.8	pg/cell	25.590	-1,15
10	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2023	JUNIO	Sysmex XP-300	26.3	pg/cell	25.590	1,03

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 9 Z-score



Gráfica 10 Resultado VS Media de comparación





● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	10	0	0	10
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Recuento de glóbulos blancos

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2023	MAYO	Sysmex XP-300	3.2	K/uL	3.280	-0,22
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	3.1	K/uL	3.280	-0,5
3	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2023	MAYO	Sysmex XP-300	3.2	K/uL	3.280	-0,22
4	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2023	MAYO	Sysmex XP-300	3.5	K/uL	3.280	0,62
5	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	3.4	K/uL	3.280	0,34
6	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2023	MAYO	Sysmex XP-300	3.3	K/uL	3.280	0,06
7	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2023	MAYO	Sysmex XP-300	3.3	K/uL	3.280	0,06
8	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2023	MAYO	Mindray BC-20S	3.2	K/uL	3.280	-0,22
9	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio	2023	MAYO	Sysmex XP-300	3.1	K/uL	3.280	-0,5
10	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2023	JUNIO	Sysmex XP-300	3.4	K/uL	3.280	0,34

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---

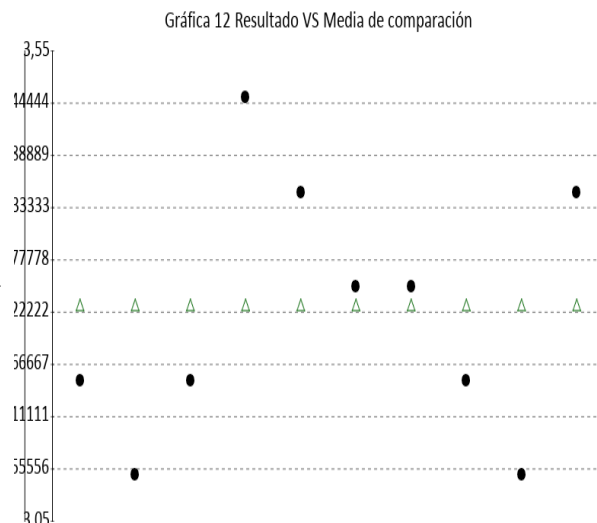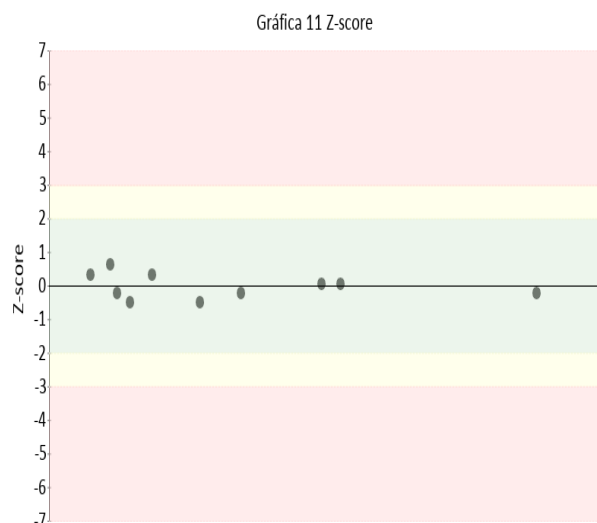

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	10	0	0	10
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Análito : Recuento de glóbulos rojos


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2023	MAYO	Sysmex XP-300	2.50	M/uL	2.390	1,51
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	2.44	M/uL	2.390	0,68
3	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2023	MAYO	Sysmex XP-300	2.46	M/uL	2.390	0,96
4	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2023	MAYO	Sysmex XP-300	2.42	M/uL	2.390	0,41
5	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	2.57	M/uL	2.390	2,47
6	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2023	MAYO	Sysmex XP-300	2.42	M/uL	2.390	0,41
7	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2023	MAYO	Sysmex XP-300	2.38	M/uL	2.390	-0,14
8	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2023	MAYO	Mindray BC-20S	2.36	M/uL	2.390	-0,41
9	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Río	2023	MAYO	Sysmex XP-300	2.46	M/uL	2.390	0,96
10	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2023	JUNIO	Sysmex XP-300	2.43	M/uL	2.390	0,55

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 13 Z-score



Gráfica 14 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	9	1	0	10
Porcentaje	90%	10%	0%	100%

Analito : Recuento de plaquetas


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2023	MAYO	Sysmex XP-300	56	K/uL	55.91	0,01
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	54	K/uL	55.91	-0,28
3	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2023	MAYO	Sysmex XP-300	52	K/uL	55.91	-0,58
4	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2023	MAYO	Sysmex XP-300	47	K/uL	55.91	-1,32
5	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	65	K/uL	55.91	1,35
6	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2023	MAYO	Sysmex XP-300	45	K/uL	55.91	-1,62
7	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2023	MAYO	Sysmex XP-300	51	K/uL	55.91	-0,73
8	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2023	MAYO	Mindray BC-20S	49	K/uL	55.79	-0,96
9	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio	2023	MAYO	Sysmex XP-300	49	K/uL	55.77	-1,05
10	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2023	JUNIO	Sysmex XP-300	55	K/uL	55.77	-0,12

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 15 Z-score



Gráfica 16 Resultado VS Media de comparación




valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	10	0	0	10
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Volumen corpuscular medio


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2023	MAYO	Sysmex XP-300	78.5	fL	79.710	-0,17
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	73.8	fL	79.710	-0,81
3	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2023	MAYO	Sysmex XP-300	74.0	fL	79.710	-0,78
4	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2023	MAYO	Sysmex XP-300	74.4	fL	79.710	-0,73
5	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	77.5	fL	79.710	-0,3
6	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2023	MAYO	Sysmex XP-300	73.6	fL	79.710	-0,84
7	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2023	MAYO	Sysmex XP-300	74.8	fL	79.710	-0,67
8	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2023	MAYO	Mindray BC-20S	78.1	fL	79.710	-0,22
9	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio	2023	MAYO	Sysmex XP-300	74.0	fL	79.710	-0,78
10	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2023	JUNIO	Sysmex XP-300	75.7	fL	79.710	-0,55

Satisfactorio Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
---	---	---

Gráfica 17 Z-score



Gráfica 18 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	10	0	0	10
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Volumen plaquetario medio


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2023	MAYO	Sysmex XP-300	11.0	fL	10.1	0,87
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	9.7	fL	10.1	-0,39
3	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2023	MAYO	Sysmex XP-300	10.1	fL	10.1	0
4	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2023	MAYO	Sysmex XP-300	9.8	fL	10.1	-0,29
5	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2023	MAYO	Sysmex XP-300	10.6	fL	10.1	0,49
6	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2023	MAYO	Sysmex XP-300	9.9	fL	10.1	-0,19
7	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2023	MAYO	Sysmex XP-300	10.5	fL	10.1	0,39
8	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2023	MAYO	Mindray BC-20S	11.0	fL	10.05	0,9
9	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio	2023	MAYO	Sysmex XP-300	9.6	fL	10.1	-0,51
10	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2023	JUNIO	Sysmex XP-300	9.7	fL	10.1	-0,4

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 19 Z-score



Gráfica 20 Resultado VS Media de comparación

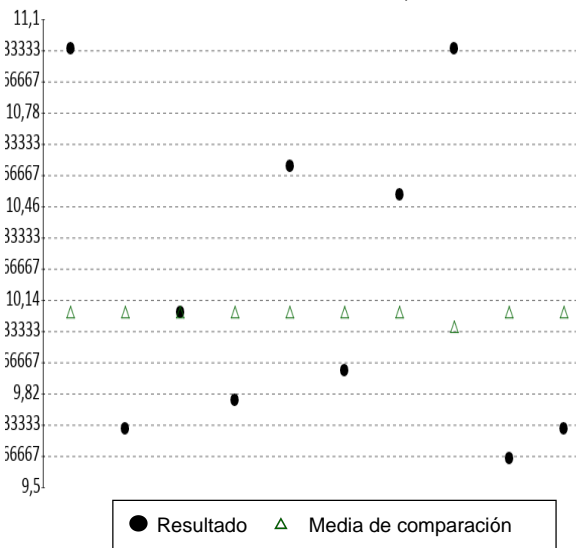

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	10	0	0	10
Porcentaje	100%	0%	0%	100%