



Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-Hb-Hemoglobina
Código de muestra: DI3608
Ronda: 4
Muestra: 2
Julio 2024

Ciudad : Bogotá Distrito Capital, Cali Valle del Cauca, Medellín Antioquia


100232 - Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali
100233 - Christus Sinergia sede Gran vía Medellín
100237 - Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102

Analito : Hemoglobina A1C


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2024	JULIO	Roche Cobas 6000 (c501)	10.89	%	9.920	3,26
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	2024	JULIO	Roche Cobas 6000 (c501)	10	%	9.920	0,27
3	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	2024	JULIO	Roche Cobas c111	9.7	%	9.900	-0,67

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Gráfica 1 Z-score

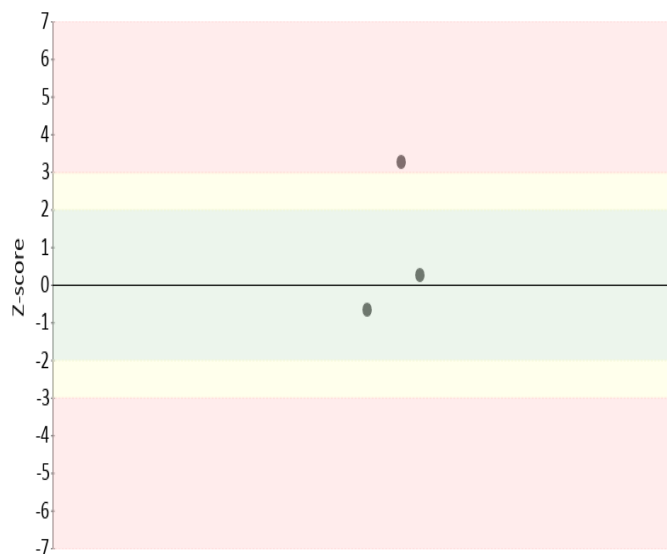

Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación

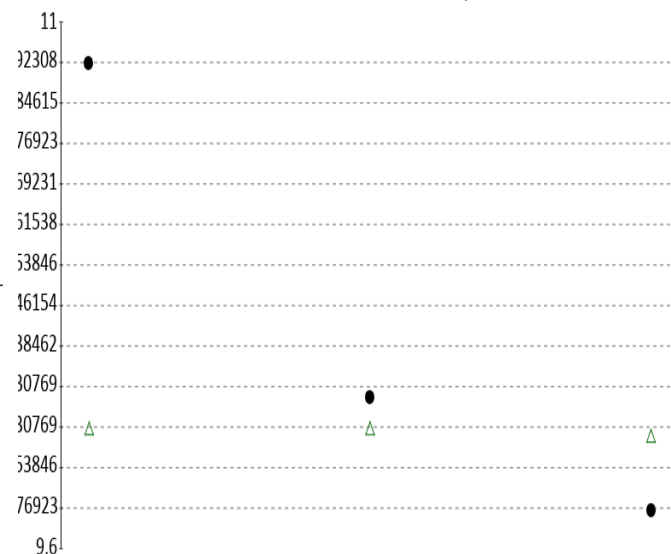

● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	1	3
Porcentaje	66,67%	0%	33,33%	100%