



Reporte subgrupo Programa de aseguramiento de la calidad QAP-U Uroanalisis

Código de muestra: QR0924

Ronda: 46

Muestra: 5

Diciembre 2024

Ciudad: Bogotá, Cali, Medellín

100232 - Christus Sinergia sede Central Procesamiento Cali

100233 - Christus Sinergia sede Gran vía Medellín

100234 - Christus Sinergia sede Satélite Clínica Farallones

100235 - Christus Sinergia sede Satélite Clínica Palma Real

100237 - Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102

100238 - Christus Sinergia sede Manila Medellín





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1
Vigente 23 de diciembre de 2024
Página 2 de 19
Estado: Evaluación original

#### 1. Resumen

It	# Laboratorio	Sede	Analitos evaluados	Satisfactorios	No satisfactorios
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	15	15	0
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	12	12	0
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	12	12	0
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	12	12	0
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	14	14	0
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	10	10	0





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1
Vigente 23 de diciembre de 2024
Página 3 de 19

Estado: Evaluación original

#### Analito: Bilirrubina

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
6	0





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1
Vigente 23 de diciembre de 2024
Página 4 de 19

**Estado: Evaluación original** 

#### Analito: Cetonas

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	Negativo	Negativo	Satisfactorio



Satisfactorio	No satisfactorio
6	0





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1
Vigente 23 de diciembre de 2024
Página 5 de 19

**Estado: Evaluación original** 

#### Analito: Glucosa

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	Negativo	Negativo	Satisfactorio



Satisfactorio	No satisfactorio
6	0





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1
Vigente 23 de diciembre de 2024
Página 6 de 19

**Estado: Evaluación original** 

#### Analito: Gravedad específica

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	1.015	1.005 hasta 1.025	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	1.015	1.008 hasta 1.019	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	1.015	1.005 hasta 1.020	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	1.015	1.005 hasta 1.020	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	1.015	1.005 hasta 1.020	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	1.015	1.005 hasta 1.020	Satisfactorio

Satisf	factorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia	No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la
		referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
6	0





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1 Vigente 23 de diciembre de 2024 Página 7 de 19

Estado: Evaluación original

#### Analito: Leucocito esterasa

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia 
No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio			
6	0			





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1
Vigente 23 de diciembre de 2024
Página 8 de 19

**Estado: Evaluación original** 

#### Analito: Nitrito

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia 
No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
6	0





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1
Vigente 23 de diciembre de 2024
Página 9 de 19

**Estado: Evaluación original** 

#### Analito: pH

lt	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	6.0	5.0 hasta 7.0	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	6.0	5.0 hasta 6.5	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	6.0	5.0 hasta 6.5	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	6.0	5.0 hasta 6.5	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	6.0	5.0 hasta 6.5	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	6.0	5.0 hasta 7.0	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia Mo satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
6	0





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1 Vigente 23 de diciembre de 2024

Página 10 de 19 Estado: Evaluación original

#### Analito: Proteínas

lt	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia Mo satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
6	0





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1 Vigente 23 de diciembre de 2024

Página 11 de 19 Estado: Evaluación original

#### Analito: Sangre

lt	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	N/A	N/A	N/A
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	N/A	N/A	N/A
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	Negativo	Negativo	Satisfactorio

<u>Satisfactorio:</u> El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
4	0





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1 Vigente 23 de diciembre de 2024

Página 12 de 19 Estado: Evaluación original

Analito: Urobilinógeno

lt	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Tira Reactiva	Roche Cobas 6000 (c501)	0.2 mg/dL	0.2 mg/dL	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Tira Reactiva	Roche cobas U6500	Negativo	0.2 mg/dL	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	N/A	N/A	N/A
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	N/A	N/A	N/A
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	0.2 mg/dL	0.2 mg/dL	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Tira Reactiva	Urisys 1100	N/A	N/A	N/A



Satisfactorio	No satisfactorio
3	0





**QAP-U-Uroanalisis** 


QAP FOR 62 V1 Vigente 23 de diciembre de 2024

Página 13 de 19 Estado: Evaluación original

#### Analito: hCG urinaria cualitativa

lt	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Manual	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100235	Christus Sinergia sede Lab Satelite clínica Palma Real	Tira Reactiva	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Manual	Roche Cobas U411	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia	No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la
	referencia

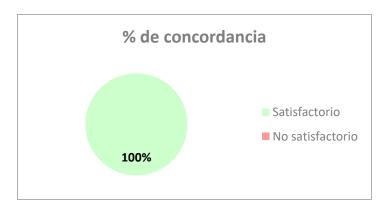

Satisfactorio	No satisfactorio
3	0





# Informe Subgrupo QAP Programa de asesoramiento de la calidad QAP-U-Uroanalisis

QAP FOR 62 V1
Vigente 23 de diciembre de 2024
Página 14 de 19

Estado: Evaluación original

#### 2. INFORME ANÁLISIS MICROSCÓPICO/SEDIMENTO URINARIO

Analito: Claridad

lt	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Microscópico	Microscópico	Limpio	Limpio	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
1	0





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1 Vigente 23 de diciembre de 2024

Página 15 de 19 Estado: Evaluación original

Analito: Color

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Microscópico	Microscópico	Amarilla clara - Amarilla	Amarilla clara - Amarilla	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia	No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la
	referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
1	0





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1 Vigente 23 de diciembre de 2024

Página 16 de 19 Estado: Evaluación original

Analito: Cristales

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia



Satisfactorio	No satisfactorio
6	0





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1
Vigente 23 de diciembre de 2024
Página 17 de 19

Estado: Evaluación original

#### Analito: Recuento de Leucocitos

lt	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Microscópico	Microscópico	N/A	N/A	N/A
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Microscópico	Microscópico	N/A	N/A	N/A



Satisfactorio	No satisfactorio
4	0





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1 Vigente 23 de diciembre de 2024

Página 18 de 19 Estado: Evaluación original

#### Analito: Recuento de Rojos

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	Microscópico	Microscópico	0 hasta 3	0 hasta 5	Satisfactorio
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	Microscópico	Microscópico	0 hasta 3	0 hasta 5	Satisfactorio
3	100234	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Farallones	Microscópico	Microscópico	0 hasta 3	0 hasta 5	Satisfactorio
4	100235	Christus Sinergia sede Lab satélite clínica Palma Real	Microscópico	Microscópico	0 hasta 3	0 hasta 5	Satisfactorio
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	Microscópico	Microscópico	0 hasta 3	0 hasta 5	Satisfactorio
6	100238	Christus Sinergia sede Manila Medellín	Microscópico	Microscópico	N/A	N/A	N/A



Satisfactorio	No satisfactorio
5	0





**QAP-U-Uroanalisis** 

QAP FOR 62 V1
Vigente 23 de diciembre de 2024
Página 19 de 19

**Estado: Evaluación original** 

Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

- Final de reporte -

-Aprobado por: Coordinador QAP Programas QAP

> Coordinador QAP: María Paula Mora Gamboa Contacto: 3174399931 Correo: maria.mora@quik.com.co