



Reporte subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-U Uroanálisis
Código de muestra: TR3223
Ronda: 48
Muestra: 3
Diciembre 2024
Ciudad: Bogotá, Medellín, Valledupar

100213 - Centro policlínico del Olaya Sede Central
100214 - Centro policlínico del Olaya Calle 98
100215 - Centro policlínico del Olaya Sede Medellín
100218 - Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar

1. Resumen


It	# Laboratorio	Sede	Analitos evaluados	Satisfactorios	No satisfactorios
1	100213	Centro policlínico del Olaya Sede Central	14	11	3
2	100214	Centro policlínico del Olaya Calle 98	14	14	0
3	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	15	15	0
4	100218	Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar	14	14	0

Analito: Bilirrubina

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100213	Centro policlínico del Olaya Sede Central	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100214	Centro policlínico del Olaya Calle 98	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100218	Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

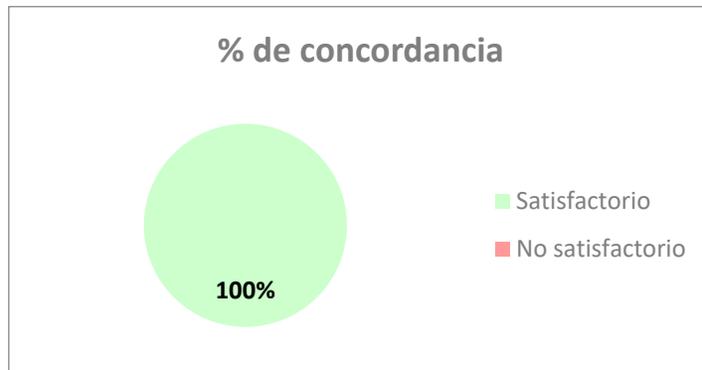


Satisfactorio	No satisfactorio
4	0

Analito: Cetonas

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100213	Centro policlínico del Olaya Sede Central	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	15mg/dL o +	Negativo	No Satisfactorio
2	100214	Centro policlínico del Olaya Calle 98	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100218	Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

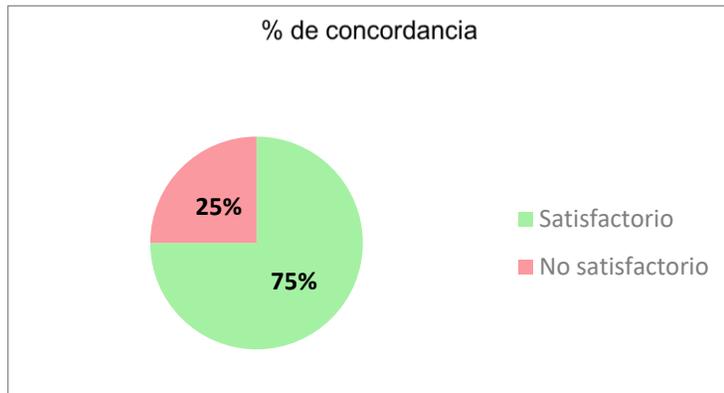


Satisfactorio	No satisfactorio
3	1

Analito: Creatinina

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100213	Centro policlínico del Olaya Sede Central	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	100 hasta 300*	10 hasta 100	No Satisfactorio
2	100214	Centro policlínico del Olaya Calle 98	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	10 hasta 100	10 hasta 100	Satisfactorio
3	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	10 hasta 100	10 hasta 100	Satisfactorio
4	100218	Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	10 hasta 100	10 hasta 100	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

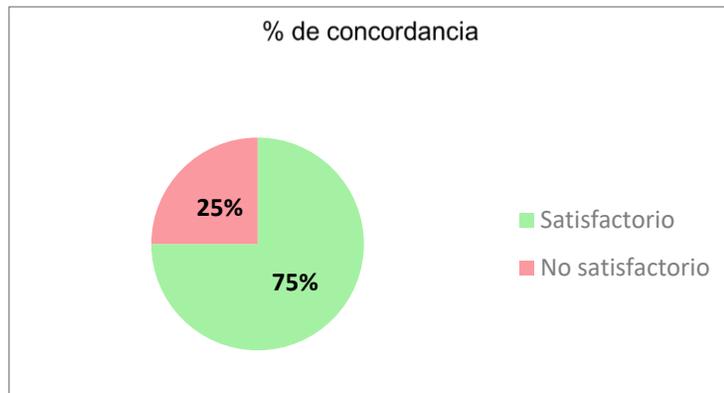


Satisfactorio	No satisfactorio
3	1

Analito: Glucosa

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100213	Centro policlínico del Olaya Sede Central	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100214	Centro policlínico del Olaya Calle 98	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100218	Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

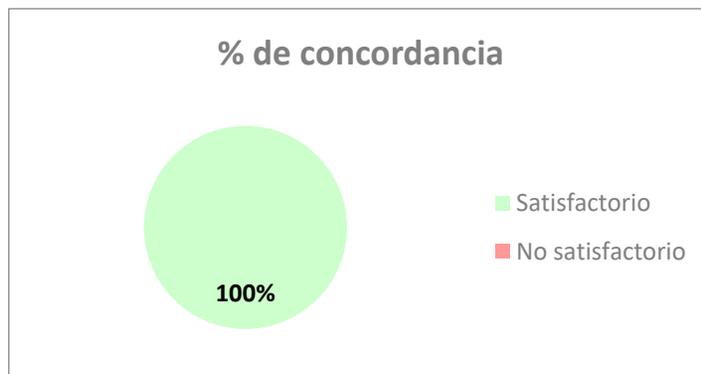


Satisfactorio	No satisfactorio
4	0

Analito: Gravedad específica

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100213	Centro policlínico del Olaya Sede Central	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	1.025	1.005 hasta 1.025	Satisfactorio
2	100214	Centro policlínico del Olaya Calle 98	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	1.020	1.005 hasta 1.025	Satisfactorio
3	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	1.010	1.005 hasta 1.025	Satisfactorio
4	100218	Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	1.015	1.005 hasta 1.025	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

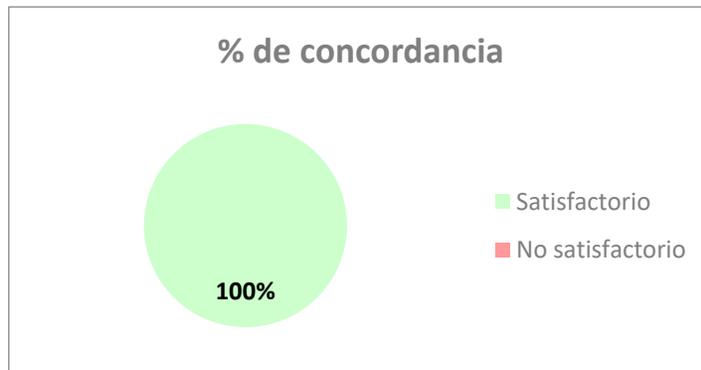


Satisfactorio	No satisfactorio
4	0

Analito: hCG urinaria cualitativa

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

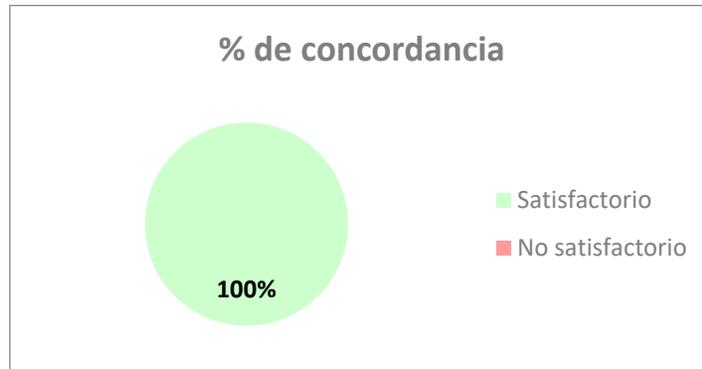


Satisfactorio	No satisfactorio
1	0

Analito: Leucocito esterasa

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100213	Centro policlínico del Olaya Sede Central	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100214	Centro policlínico del Olaya Calle 98	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100218	Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

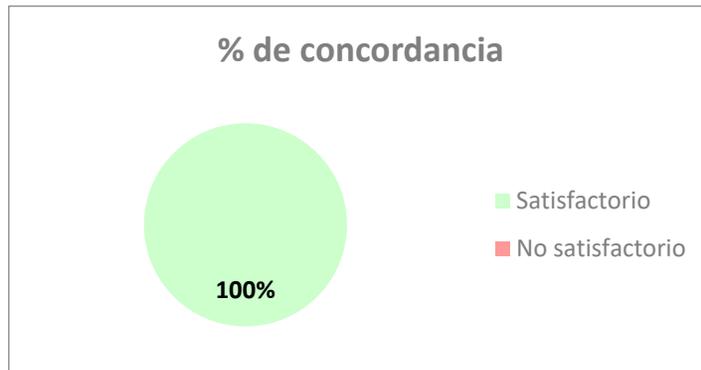


Satisfactorio	No satisfactorio
4	0

Analito: Nitrito

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100213	Centro policlínico del Olaya Sede Central	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100214	Centro policlínico del Olaya Calle 98	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100218	Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

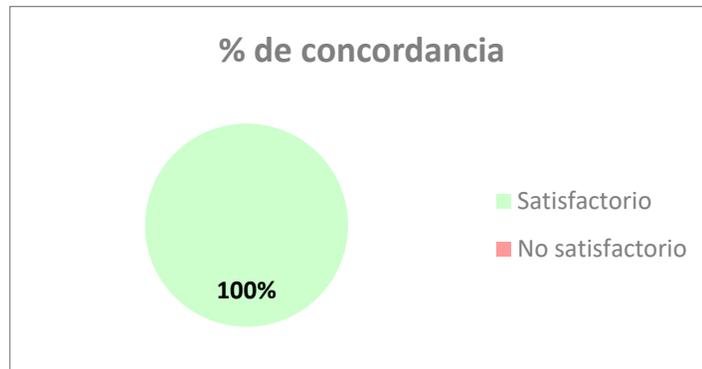


Satisfactorio	No satisfactorio
4	0

Analito: pH

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100213	Centro policlínico del Olaya Sede Central	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	6.5	5.0 hasta 7.0	Satisfactorio
2	100214	Centro policlínico del Olaya Calle 98	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	6.0	5.0 hasta 7.0	Satisfactorio
3	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	6.0	5.0 hasta 7.0	Satisfactorio
4	100218	Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	6.0	5.0 hasta 7.0	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

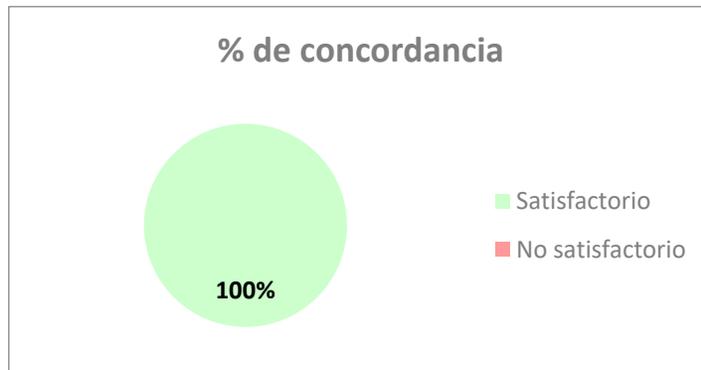


Satisfactorio	No satisfactorio
4	0

Analito: Proteínas

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100213	Centro policlínico del Olaya Sede Central	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100214	Centro policlínico del Olaya Calle 98	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
6	100218	Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

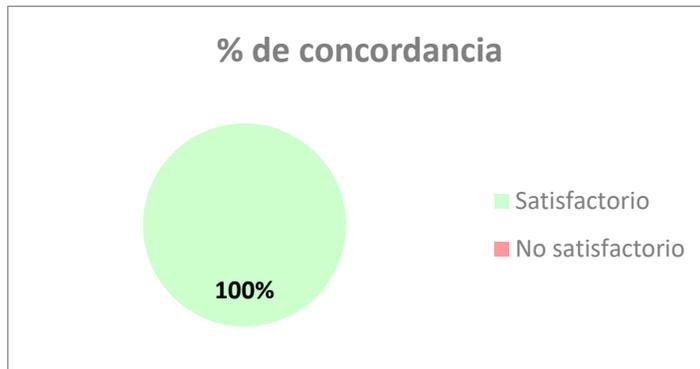


Satisfactorio	No satisfactorio
4	0

Analito: Sangre

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100213	Centro policlínico del Olaya Sede Central	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
2	100214	Centro policlínico del Olaya Calle 98	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
3	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio
4	100218	Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	Negativo	Negativo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

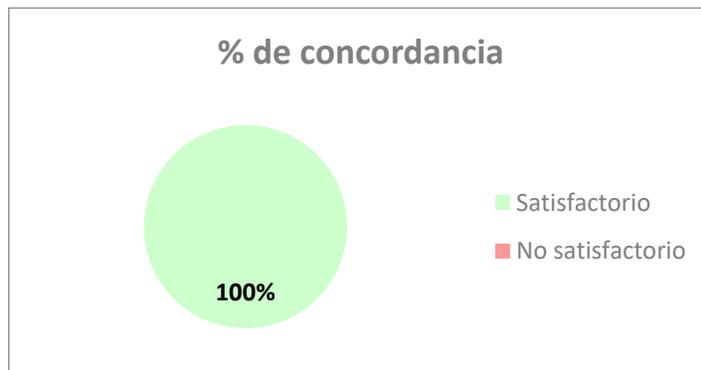


Satisfactorio	No satisfactorio
4	0

Analito: Urobilinógeno

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100213	Centro policlínico del Olaya Sede Central	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	1 mg/dL	0.2 mg/dL	No Satisfactorio
2	100214	Centro policlínico del Olaya Calle 98	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	0.2 mg/dL	0.2 mg/dL	Satisfactorio
3	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	0.2 mg/dL	0.2 mg/dL	Satisfactorio
4	100218	Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar	Tira Reactiva	DIRUI FUS 2000	0.2 mg/dL	0.2 mg/dL	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

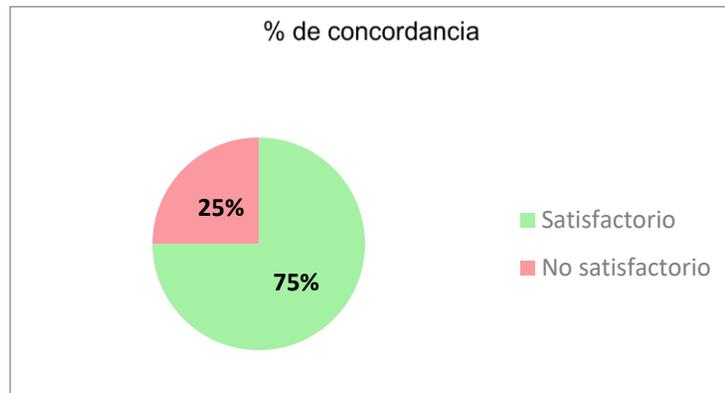

Satisfactorio	No satisfactorio
3	1


2. INFORME ANÁLISIS MICROSCÓPICO/SEDIMENTO URINARIO

Analito: Cristales

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100213	Centro policlínico del Olaya Sede Central	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio
2	100214	Centro policlínico del Olaya Calle 98	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio
3	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio
4	100218	Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar	Microscópico	Microscópico	Ausentes	Ausentes	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

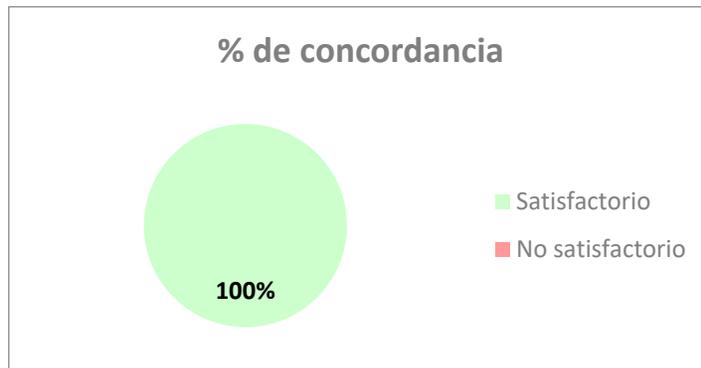


Satisfactorio	No satisfactorio
4	0

Analito: Recuento de Leucocitos

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100213	Centro policlínico del Olaya Sede Central	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio
2	100214	Centro policlínico del Olaya Calle 98	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio
3	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio
4	100218	Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

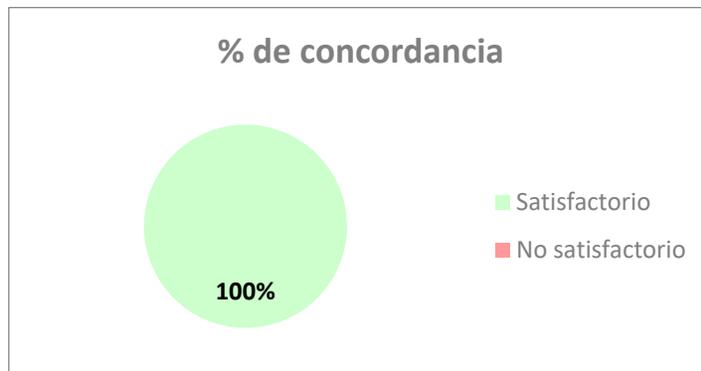


Satisfactorio	No satisfactorio
4	0

Analito: Recuento de Rojos

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100213	Centro policlínico del Olaya Sede Central	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio
2	100214	Centro policlínico del Olaya Calle 98	Microscópico	Microscópico	0 hasta 5	0 hasta 5	Satisfactorio
3	100215	Centro policlínico del Olaya Sede Medellín	Microscópico	Microscópico	0 hasta 3	0 hasta 5	Satisfactorio
4	100218	Centro policlínico del Olaya Sede Valledupar	Microscópico	Microscópico	0 hasta 3	0 hasta 5	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

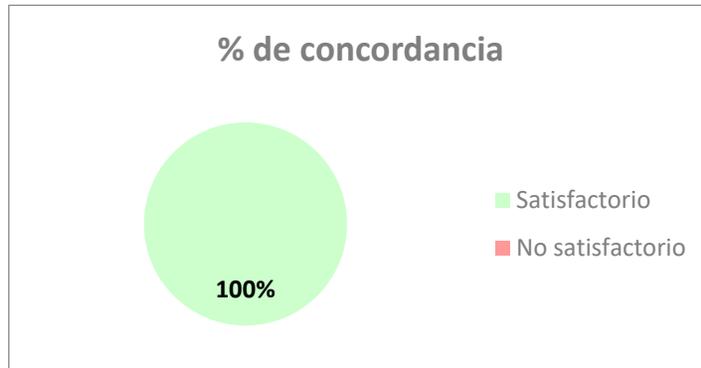

Satisfactorio	No satisfactorio
4	0

Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

- Final de reporte -

-Aprobado por:
Coordinador QAP
Programas QAP

Coordinador QAP:
María Paula Mora Gamboa
Contacto: 3174399931
Correo: maria.mora@quik.com.co