

"Quality Assurance Program"

Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica

INFORME DE FIN DE RONDA
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-Hb Hemoglobina
Ronda 2
2023-12-22 - 2024-11-01
Código Reporte: QAP-Hb 100224-2

100224 Laboratorio Clínico Alis Díaz

E-mail: laboratorioalisdiaz@gmail.com
Dirección: Cra 26 # 8 -76 Local 107
Ciudad: Villavicencio Meta
País: Colombia
Contacto: Andres Quintero
Teléfono: 314 4010186

Laboratorio:	100224
Ronda:	2
Fecha generación:	2024/11/27
Página:	2 de 4

Hemoglobina A1C (%)

Analizador: VARIANT II TURBO Hemoglobin Testing System | Generación vitros: N/A

Metodología: HPLC | Reactivo: Dedicado | Material: No declarado


V.A.V

Material	1			2			
	Muestra	DI3605 [M1]	DI3606 [M2]	DI3607 [M3]	DI3608 [M4]	DI3609 [M5]	DI3610 [M6]
Valor reportado por el laboratorio		5.1	N/A	5.2	10	N/A	N/A
Evaluación con media de comparación		5.17	N/A	5.17	10.13	N/A	N/A
JCTLM		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP		5.1	N/A	5.26	9.69	N/A	N/A
Participantes QAP misma metodología		5.1	N/A	5.15	N/A	N/A	N/A


Interpretación color evaluación con media de comparación: ■ WRR mensual ■ WWR acumulada ■ Inserto ■ Consenso

Gráficas de correlación


Evaluación con media de comparación




Evaluación JCTLM



Evaluación consenso QAP



Evaluación consenso QAP misma metodología



Laboratorio:	100224
Ronda:	2
Fecha generación:	2024/11/27
Página:	3 de 4

Hemoglobina A1C (%)





Analizador: Lifotronic H8 | Generación vitros: N/A

Metodología: HPLC | Reactivo: Linfotronic | Material: No declarado

Material	1			2			
	Muestra	DI3605 [M1]	DI3606 [M2]	DI3607 [M3]	DI3608 [M4]	DI3609 [M5]	DI3610 [M6]
Valor reportado por el laboratorio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.6
Evaluación con media de comparación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.06
JCTLM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participantes QAP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.77
Participantes QAP misma metodología	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Interpretación color evaluación con media de comparación: ■ WRR mensual ■ WWR acumulada ■ Inserto ■ Consenso

Gráficas de correlación

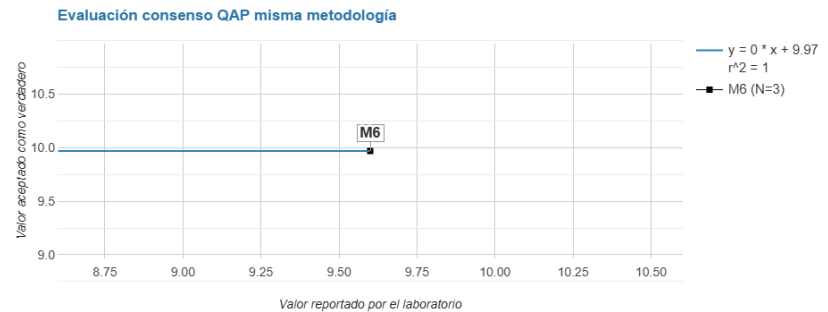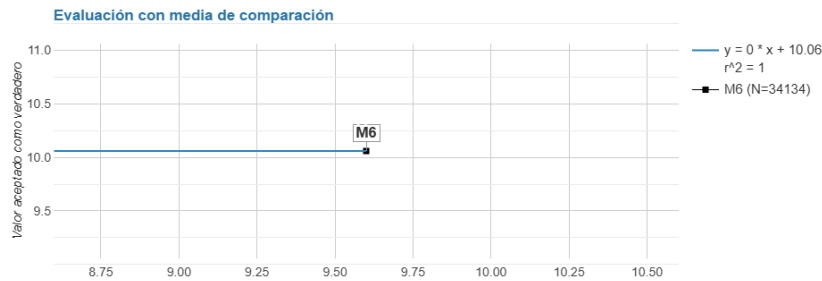

Observaciones:

Revisado por:

Fecha:

-- Final de reporte --

**Aprobado por:
Coordinador QAP
Programas QAP**

**Coordinador QAP:
María Paula Mora Gamboa
Correo: maria.mora@quik.com.co**