

Reporte subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-U Uroanálisis
Código de muestra: QR0923
Ronda: 46
Muestra: 4
Octubre 2024
Ciudad: Bogotá

100242 - Clínica Marly Calle 50
100243 - Clínica Marly Chía

1. Resumen


It	# Laboratorio	Sede	Analitos evaluados	Satisfactorios	No satisfactorios
1	100242	Clínica Marly Calle 50	14	14	0
2	100243	Clínica Marly Chía	14	13	1

Analito: Bilirrubina

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100242	Clínica Marly Calle 50	Tira Reactiva	Dirui Fus 1000	4 mg/dL o +++	1+ hasta 3+	Satisfactorio
2	100243	Clínica Marly Chía	Tira Reactiva	Dirui H-500	3+	1+ hasta 3+	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

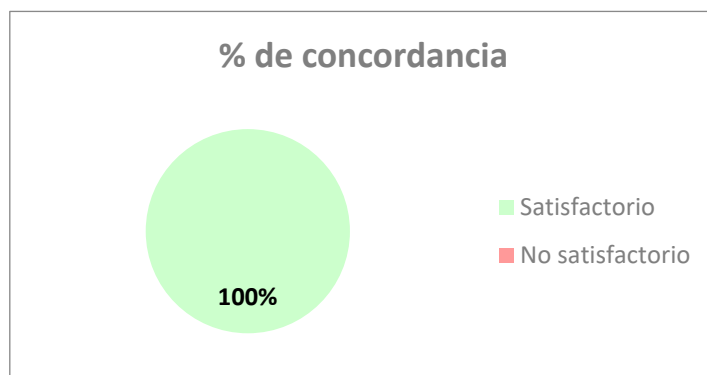


Satisfactorio	No satisfactorio
2	0

Analito: Cetonas

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100242	Clínica Marly Calle 50	Tira Reactiva	Dirui Fus 1000	40 mg/dL o ++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
2	100243	Clínica Marly Chía	Tira Reactiva	Dirui H-500	2+	2+ hasta 4+	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

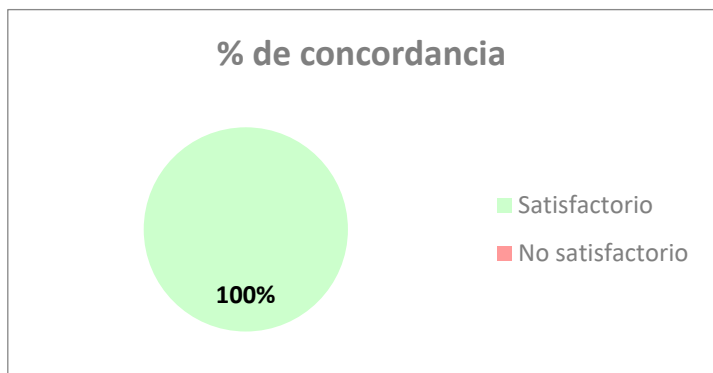


Satisfactorio	No satisfactorio
2	0

Analito: Creatinina

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100242	Clínica Marly Calle 50	Tira Reactiva	Dirui Fus 1000	100 hasta 300*	100 hasta 300*	Satisfactorio
2	100243	Clínica Marly Chía	Tira Reactiva	Dirui H-500	100 hasta 300*	100 hasta 300*	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

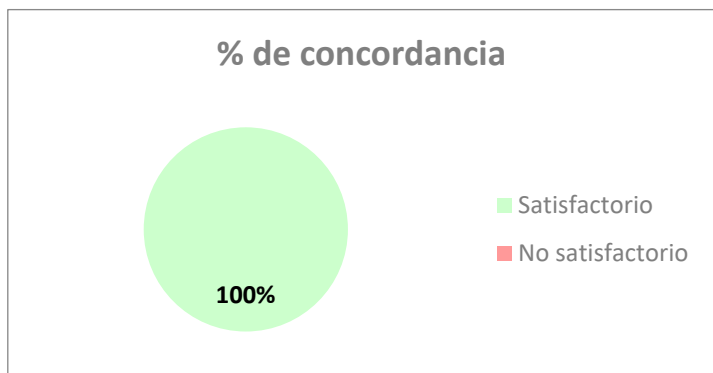


Satisfactorio	No satisfactorio
2	0

Analito: Glucosa

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100242	Clínica Marly Calle 50	Tira Reactiva	Dirui Fus 1000	500 mg/dL o ++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
2	100243	Clínica Marly Chía	Tira Reactiva	Dirui H-500	1000 mg/dL o +++	2+ hasta 4+	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

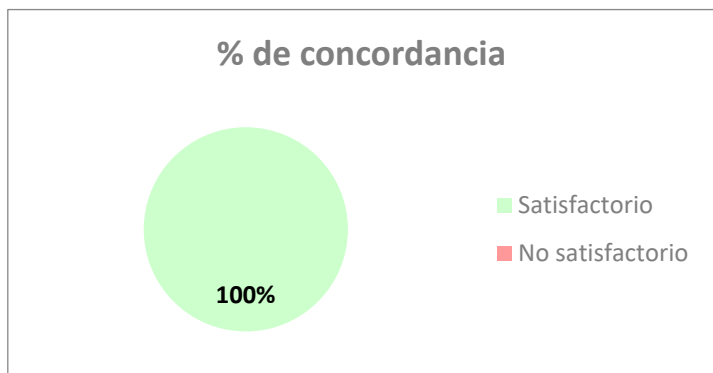


Satisfactorio	No satisfactorio
2	0

Analito: Gravedad específica

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100242	Clínica Marly Calle 50	Tira Reactiva	Dirui Fus 1000	1.025	1.005 hasta 1.025	Satisfactorio
2	100243	Clínica Marly Chía	Tira Reactiva	Dirui H-500	1.020	1.005 hasta 1.025	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

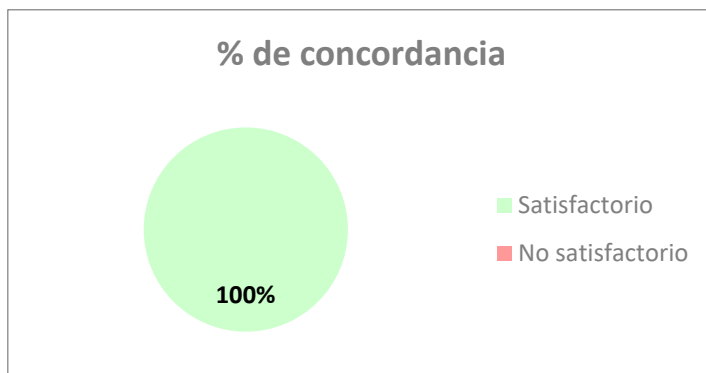


Satisfactorio	No satisfactorio
2	0

Analito: Leucocito esterasa

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100242	Clínica Marly Calle 50	Tira Reactiva	Dirui Fus 1000	125 mg/dL o ++	1+ hasta 3+	Satisfactorio
2	100243	Clínica Marly Chía	Tira Reactiva	Dirui H-500	125 mg/dL o ++	1+ hasta 3+	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

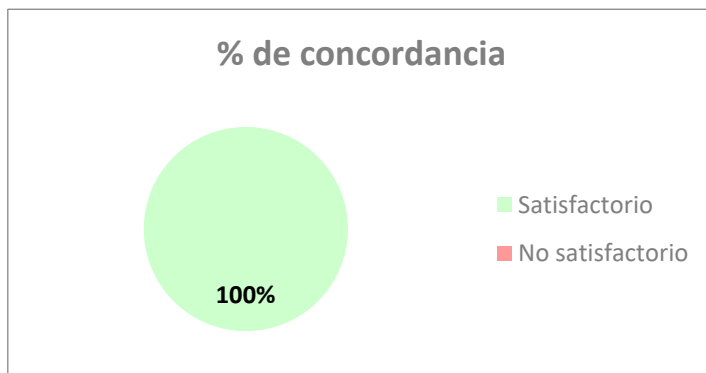


Satisfactorio	No satisfactorio
2	0

Analito: Nitrito

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100242	Clínica Marly Calle 50	Tira Reactiva	Dirui Fus 1000	Positivo	Positivo	Satisfactorio
2	100243	Clínica Marly Chía	Tira Reactiva	Dirui H-500	Positivo	Positivo	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

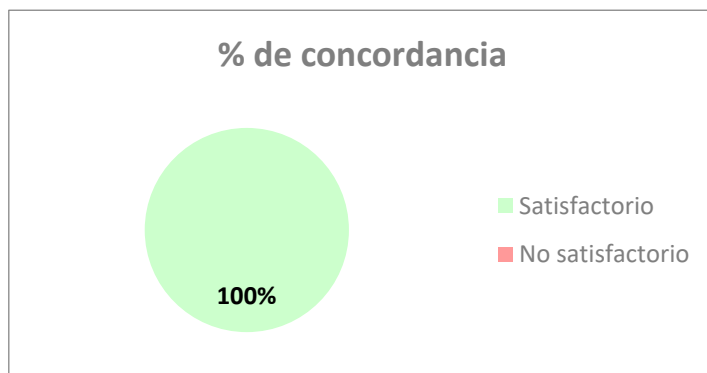


Satisfactorio	No satisfactorio
2	0

Analito: pH

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100242	Clínica Marly Calle 50	Tira Reactiva	Dirui Fus 1000	6.5	6.0 hasta 8.0	Satisfactorio
2	100243	Clínica Marly Chía	Tira Reactiva	Dirui H-500	6.0	6.0 hasta 8.0	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

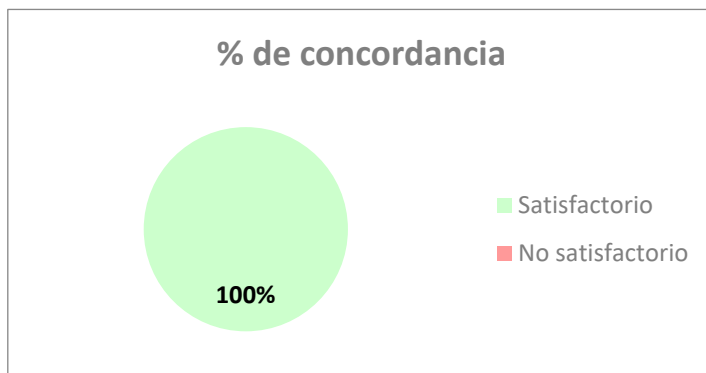


Satisfactorio	No satisfactorio
2	0

Analito: Proteínas

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100242	Clínica Marly Calle 50	Tira Reactiva	Dirui Fus 1000	300mg/dL o +++	2+ hasta 4+	Satisfactorio
2	100243	Clínica Marly Chía	Tira Reactiva	Dirui H-500	300mg/dL o +++	2+ hasta 4+	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

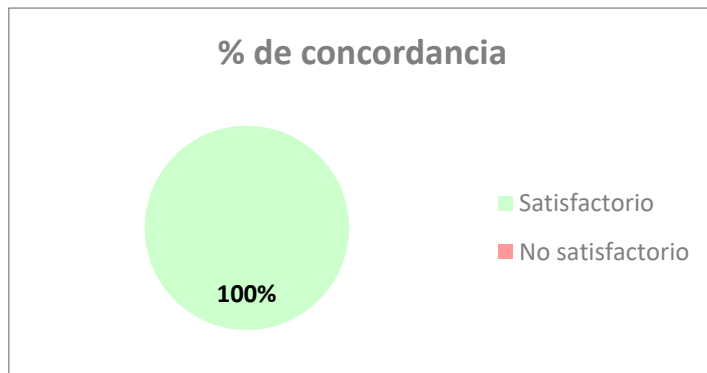


Satisfactorio	No satisfactorio
2	0

Analito: Sangre

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100242	Clínica Marly Calle 50	Tira Reactiva	Dirui Fus 1000	+++	3+ hasta 5+	Satisfactorio
2	100243	Clínica Marly Chía	Tira Reactiva	Dirui H-500	+++	3+ hasta 5+	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

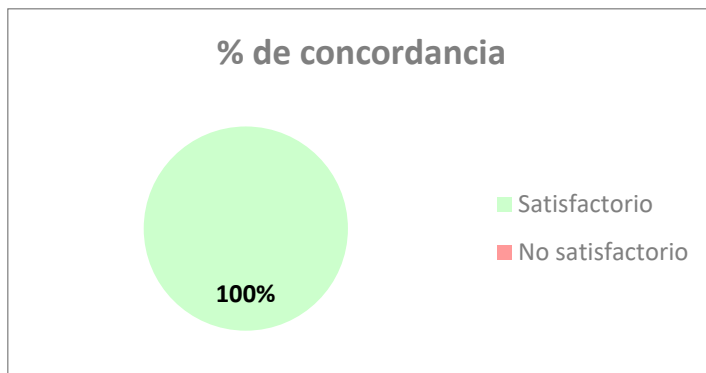


Satisfactorio	No satisfactorio
2	0

Analito: Urobilinógeno

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100242	Clínica Marly Calle 50	Tira Reactiva	Dirui Fus 1000	2 mg/dL	2 mg/dL	Satisfactorio
2	100243	Clínica Marly Chía	Tira Reactiva	Dirui H-500	1+	1+ hasta 4+	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

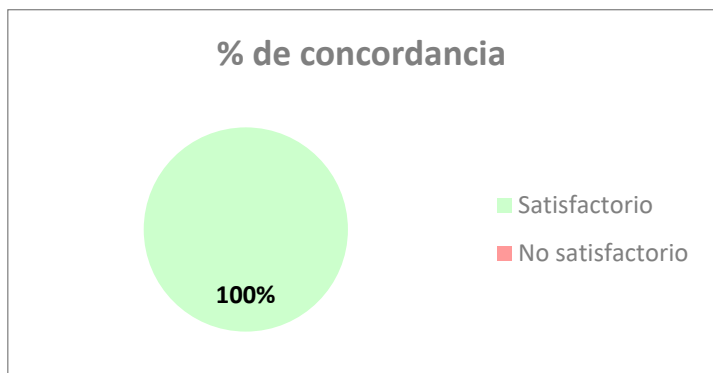

Satisfactorio	No satisfactorio
2	0


2. INFORME ANÁLISIS MICROSCÓPICO/SEDIMENTO URINARIO

Analito: Cristales

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100242	Clínica Marly Calle 50	Microscópico	Microscópico	Presentes	Presentes	Satisfactorio
2	100243	Clínica Marly Chía	Microscópico	Microscópico	Presentes	Presentes	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

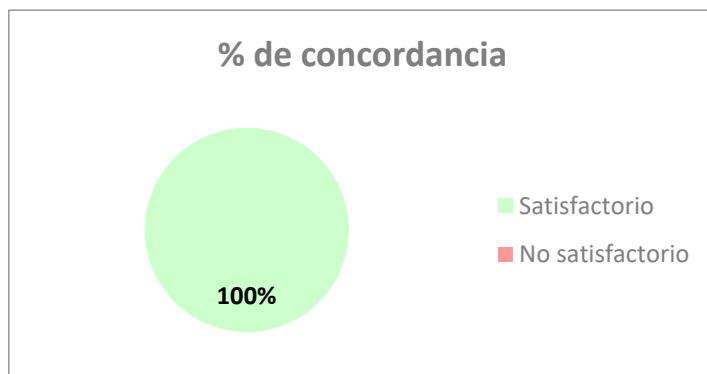


Satisfactorio	No satisfactorio
2	0

Analito: Recuento de Leucocitos

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100242	Clínica Marly Calle 50	Microscópico	Microscópico	31 o más	5 hasta 50	Satisfactorio
2	100243	Clínica Marly Chía	Microscópico	Microscópico	6 hasta 10	5 hasta 50	Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

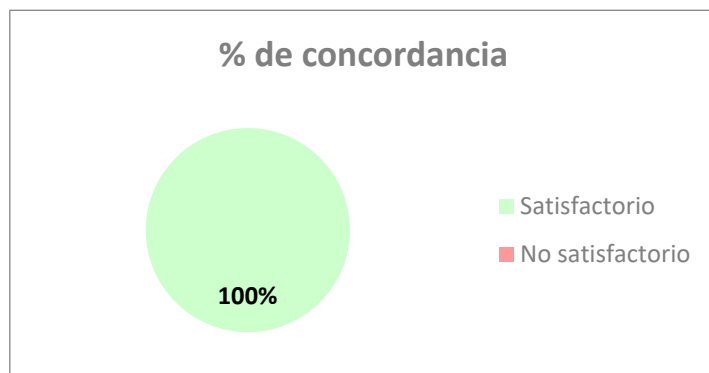


Satisfactorio	No satisfactorio
2	0

Analito: Recuento de Rojos

It	# Laboratorio	Sede	Método	Analizador	Resultado	Referencia	Desempeño
1	100242	Clínica Marly Calle 50	Microscópico	Microscópico	26 o más	25 mayor que 100	Satisfactorio
2	100243	Clínica Marly Chía	Microscópico	Microscópico	21 hasta 25	25 mayor que 100	No Satisfactorio

Satisfactorio: El resultado de su laboratorio es igual a la referencia

No satisfactorio: El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia

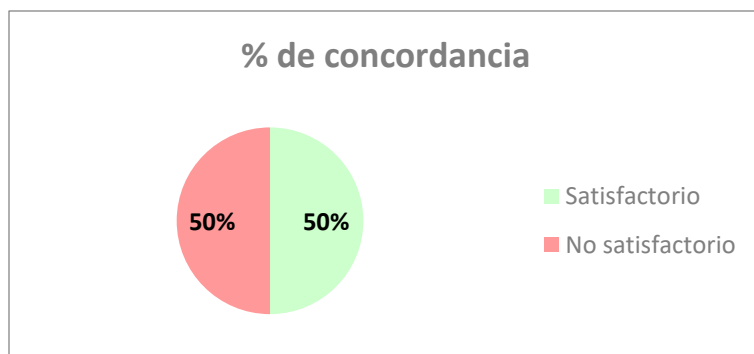

Satisfactorio	No satisfactorio
1	1