



Reporte Subgrupo  
Programa de aseguramiento de la calidad  
QAP-PP-Proteínas plasmáticas  
Código de muestra: RS5582  
Ronda: 31  
Muestra: 2  
Marzo 2025  
Ciudad : Bogotá Distrito Capital



100294 - Hospital de Engativá - Red Norte  
100296 - Hospital de Chapinero  
100293 - Hospital Simon Bolivar - Red Norte  
100295 - Hospital de Suba - Red Norte  
100302 - Hospital Simon Bolivar - ra


*Maria Paula Mora E.*

**Analito :** Complemento sérico C3

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100302	Hospital Simon Bolivar - ra	2025	MARZO	Ortho Vitros XT 7600	233	mg/dL	213.300	2,04

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 1 Z-score

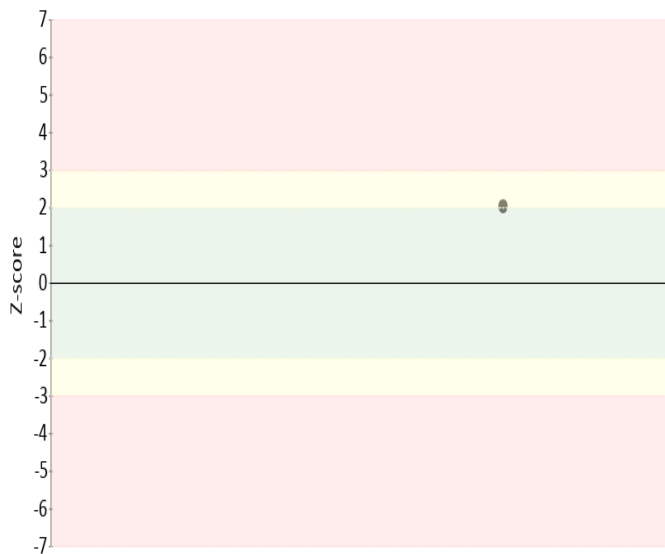

Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación



● Resultado    △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	1	0	1
Porcentaje	0%	100%	0%	100%

**Analito :** Complemento sérico C4


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100302	Hospital Simon Bolivar - ra	2025	MARZO	Ortho Vitros XT 7600	49.2	mg/dL	45.540	0,85

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 3 Z-score

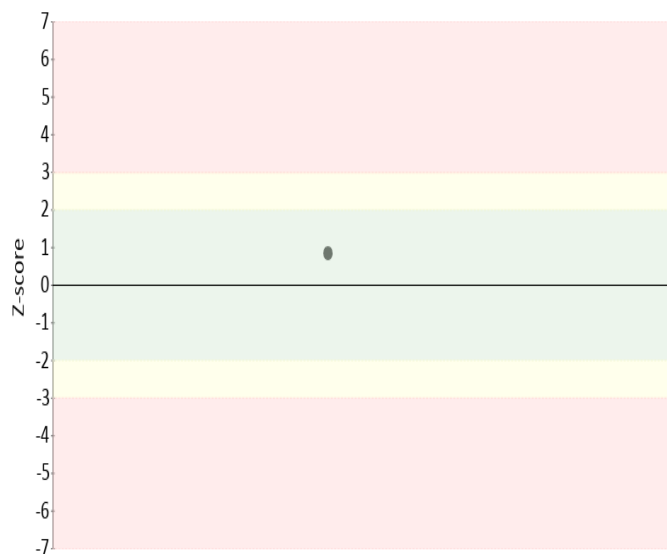

Gráfica 4 Resultado VS Media de comparación

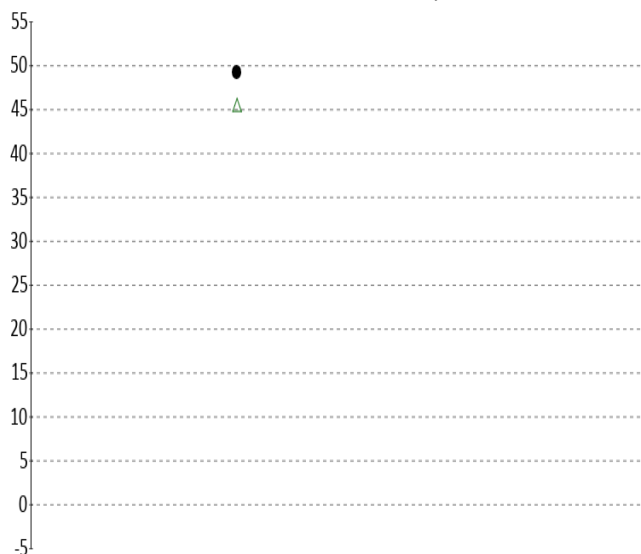

● Resultado    △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

**Analito :** Factor reumatoideo


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100293	Hospital Simon Bolivar - Red Norte	2025	MARZO	Ortho Vitros XT 7600	148.9	U/mL	135.600	1,17

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 5 Z-score

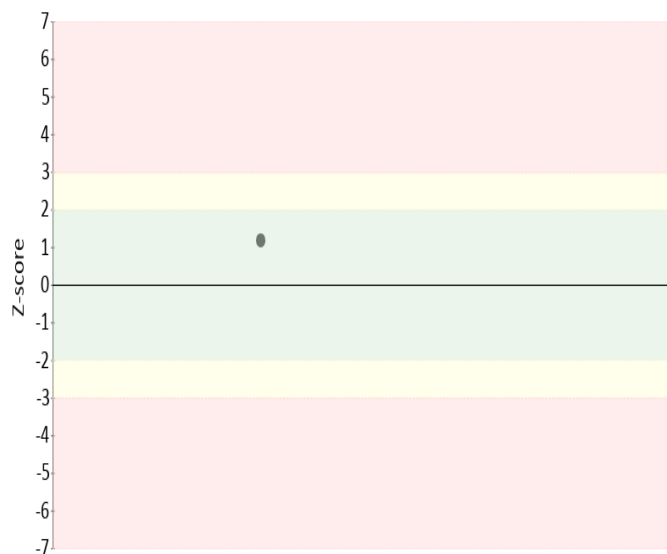

Gráfica 6 Resultado VS Media de comparación

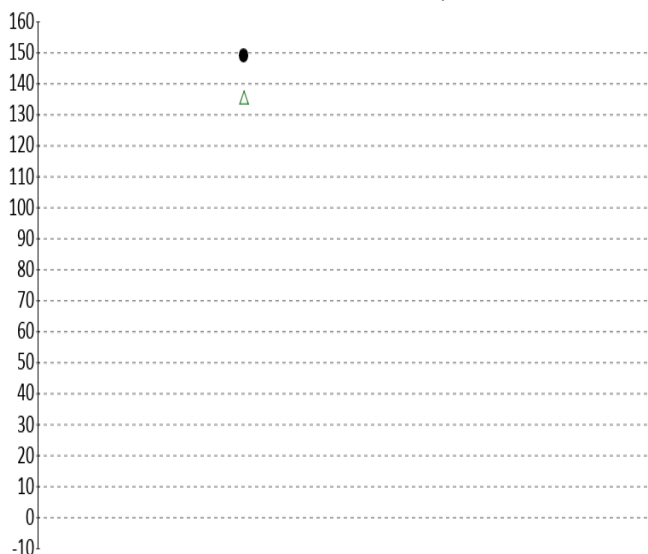

● Resultado    △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

**Analito :** PCR


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100293	Hospital Simon Bolivar - Red Norte	2025	MARZO	Ortho Vitros XT 7600	33.1	mg/L	34.360	-0,61
2	100294	Hospital de Engativá - Red Norte	2025	MARZO	Vitros XT 3400 (Microslide)	23.4	mg/L	34.360	-5,27
3	100295	Hospital de Suba - Red Norte	2025	MARZO	Vitros XT 3400 (Microslide)	27.5	mg/L	34.360	-3,3
4	100296	Hospital de Chapinero	2025	MARZO	Vitros XT 3400 (Microslide)	27.6	mg/L	34.360	-3,25
5	100302	Hospital Simon Bolivar - ra	2025	MARZO	Ortho Vitros XT 7600	30.4	mg/L	34.360	-1,9

Satisfactorio	Alarma	No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Gráfica 7 Z-score

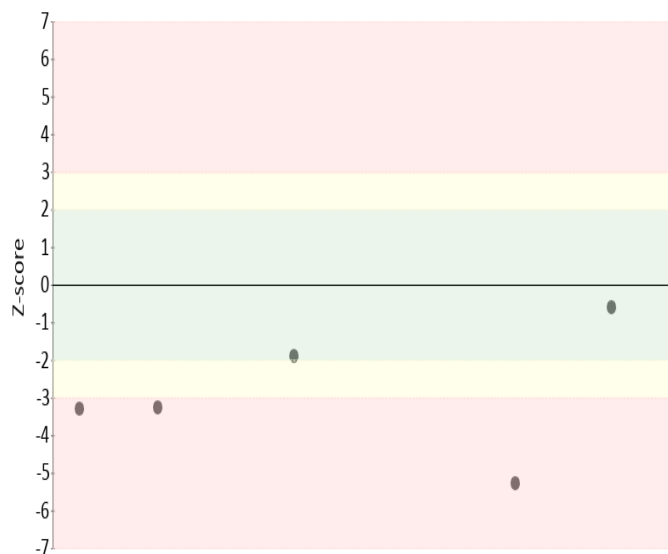

Gráfica 8 Resultado VS Media de comparación

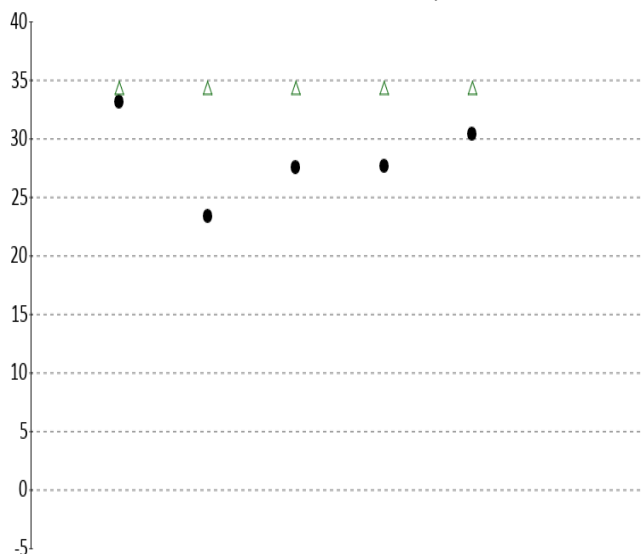

● Resultado    △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	3	5
Porcentaje	40%	0%	60%	100%

**Analito :** Prealbúmina


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100302	Hospital Simon Bolivar - ra	2025	MARZO	Ortho Vitros XT 7600	44.32	mg/dL	38.210	1,87

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 9 Z-score

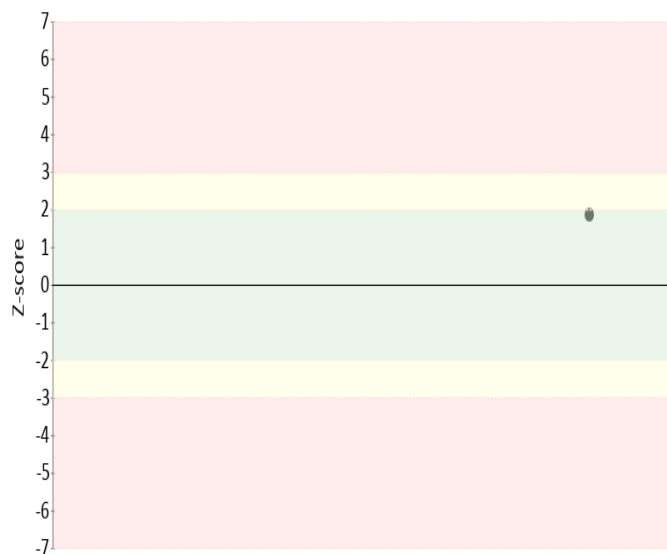

Gráfica 10 Resultado VS Media de comparación

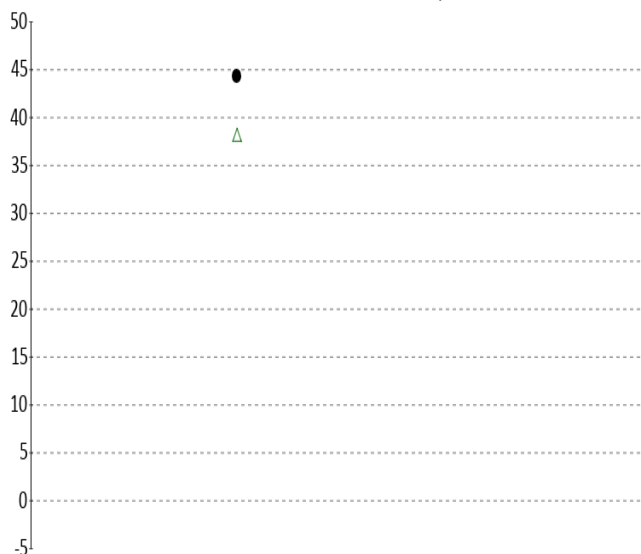

● Resultado    △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

**Analito :** Transferrina

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100293	Hospital Simon Bolivar - Red Norte	2025	MARZO	Ortho Vitros XT 7600	413.03	mg/dL	362.900	2.93

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
---	---	---

Gráfica 11 Z-score

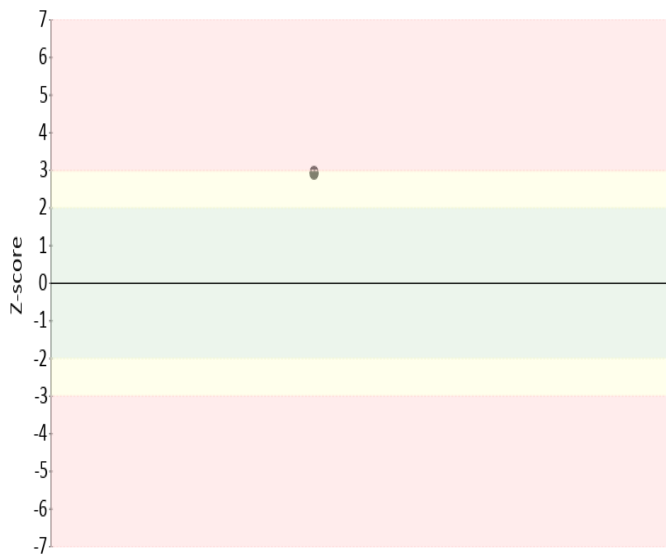

Gráfica 12 Resultado VS Media de comparación



● Resultado    △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	1	0	1
Porcentaje	0%	100%	0%	100%