



Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-DD-D-Dímero
Código de muestra: DE2506
Ronda: 1
Muestra: 6
Marzo 2025
Ciudad : Cali Valle del Cauca

100234 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones
100235 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real


Maria Paula Mora E.

Analito : Dímero


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100234	Christus Sinergia sede Lab Satellite Clinica Farallones	2025	MARZO	Roche Cobas 6000 (c501)	1.25	ug/mL	1.740	-2,46
2	100235	Christus Sinergia sede Lab Satellite Clinica Palma Real	2025	MARZO	Roche Cobas c311	1.50	ug/mL	1.740	-1,21

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 1 Z-score

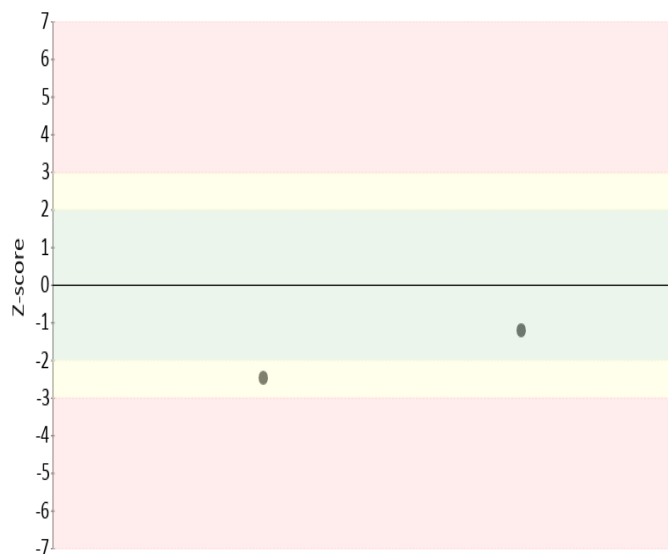

Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación

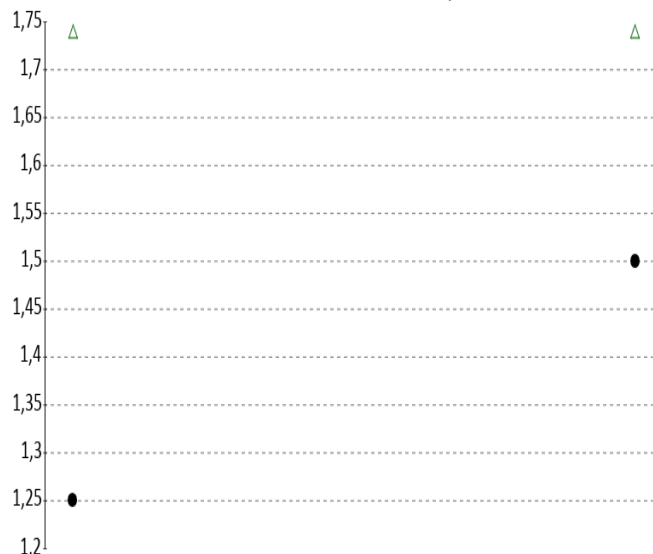

● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	1	0	2
Porcentaje	50%	50%	0%	100%