



Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-PP-Proteínas plasmáticas
Código de muestra: UF2106
Ronda: 29
Muestra: 6
Marzo 2025
Ciudad : Bogotá Distrito Capital, Medellín Antioquia, Cali Valle del Cauca

100232 - Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali
100233 - Christus Sinergia sede Gran vía Medellín
100234 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones
100235 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real
100237 - Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102
100238 - Christus Sinergia sede Manila


María Paula Morán

Analito : Antiestreptolisina O


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2025	MARZO	Roche Cobas 6000 (c501)	153	UI/mL	171.600	-2,64

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 1 Z-score

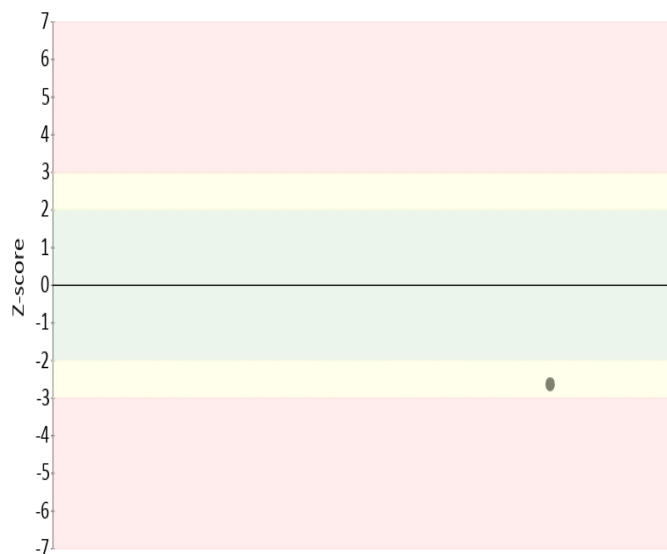

Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación

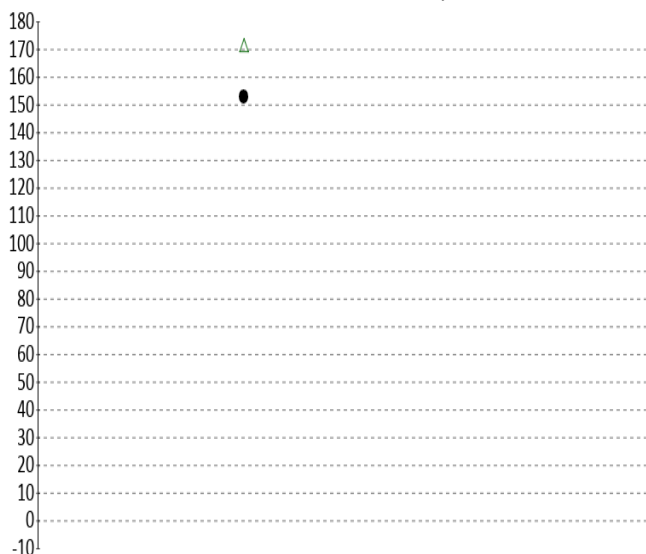

● Resultado Δ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	1	0	1
Porcentaje	0%	100%	0%	100%

Analito : Complemento sérico C3

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2025	MARZO	Roche Cobas 6000 (c501)	224.7	mg/dL	216.100	1,35

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 3 Z-score

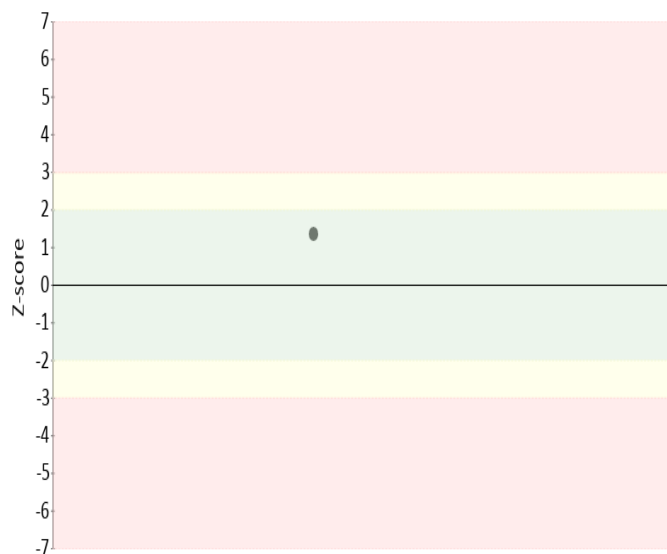

Gráfica 4 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Complemento sérico C4


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2025	MARZO	Roche Cobas 6000 (c501)	44.3	mg/dL	44.330	-0,01

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 5 Z-score

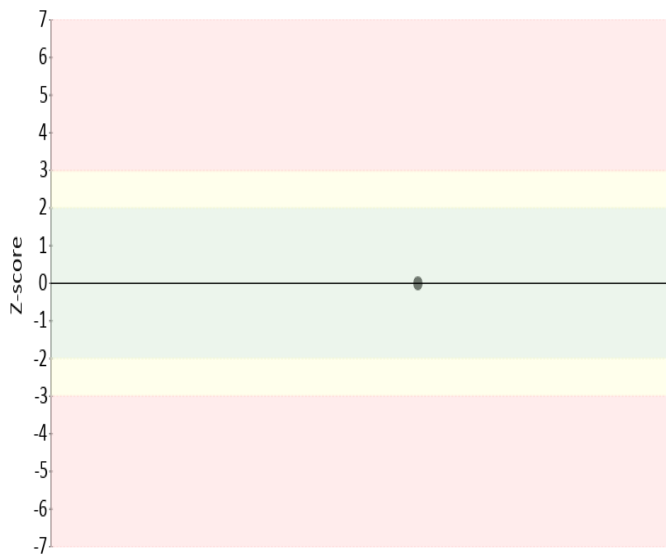

Gráfica 6 Resultado VS Media de comparación

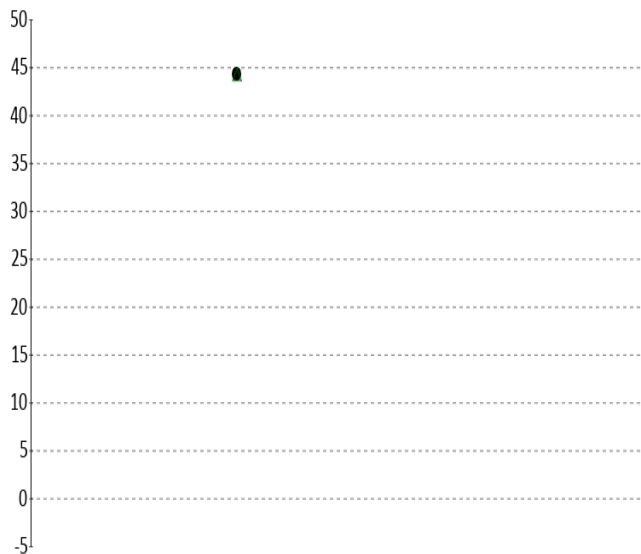

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : IgA


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2025	MARZO	Roche Cobas 6000 (c501)	254.12	mg/dL	258.000	-0,53

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 7 Z-score

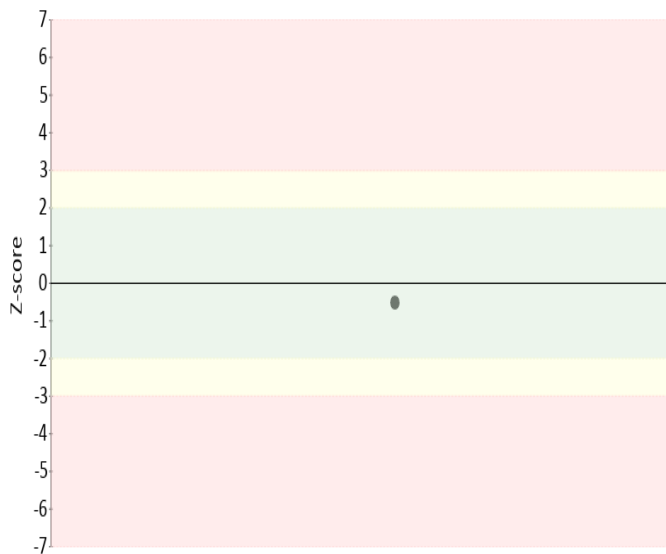

Gráfica 8 Resultado VS Media de comparación

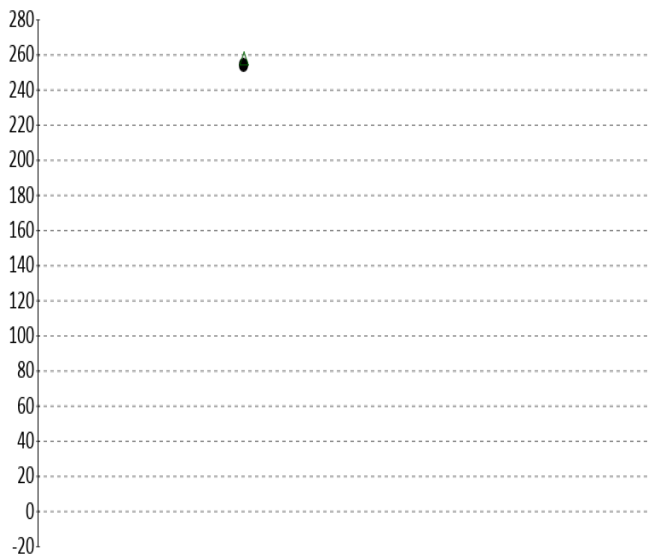

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : IgE

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2025	MARZO	Roche Cobas e 801	250	UI/mL	273.6	-1,39

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 9 Z-score

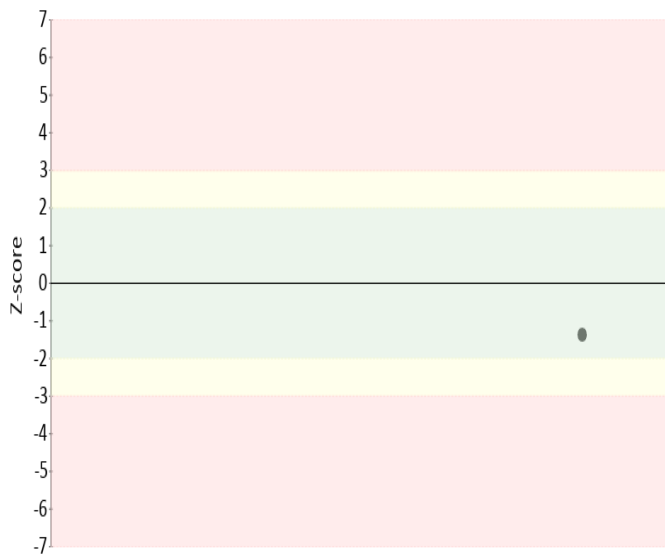

Gráfica 10 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : IgG

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2025	MARZO	Roche Cobas 6000 (c501)	1282	mg/dL	1317.000	-0,98

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 11 Z-score

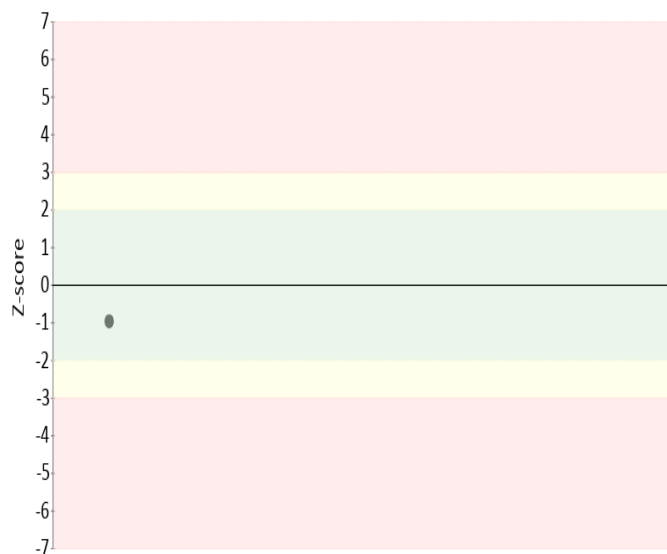

Gráfica 12 Resultado VS Media de comparación



● Resultado ▲ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : IgM

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2025	MARZO	Roche Cobas 6000 (c501)	219.14	mg/dL	224.100	-0,83

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 13 Z-score

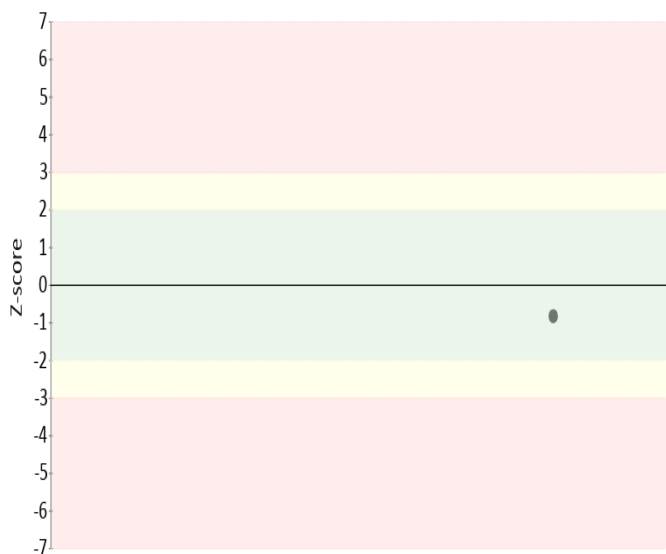

Gráfica 14 Resultado VS Media de comparación



● Resultado ▲ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : PCR


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2025	MARZO	Roche Cobas 6000 (c501)	2.98	mg/dL	3.060	-0,63
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	2025	MARZO	Roche Cobas 6000 (c501)	2.99	mg/dL	3.060	-0,55
3	100234	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones	2025	MARZO	Roche Cobas 6000 (c501)	2.96	mg/dL	3.060	-0,79
4	100235	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real	2025	MARZO	Roche Cobas c311	3.07	mg/dL	3.060	0,08
5	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	2025	MARZO	Roche Cobas 6000 (c501)	2.83	mg/dL	3.060	-1,81
6	100238	Christus Sinergia sede Manila	2025	MARZO	Roche Cobas 6000 (c501)	2.14	mg/dL	3.060	-7,24

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 15 Z-score

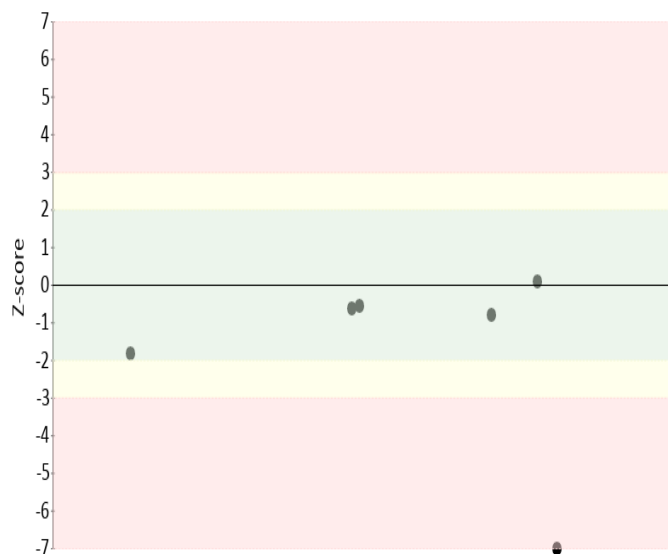

Gráfica 16 Resultado VS Media de comparación

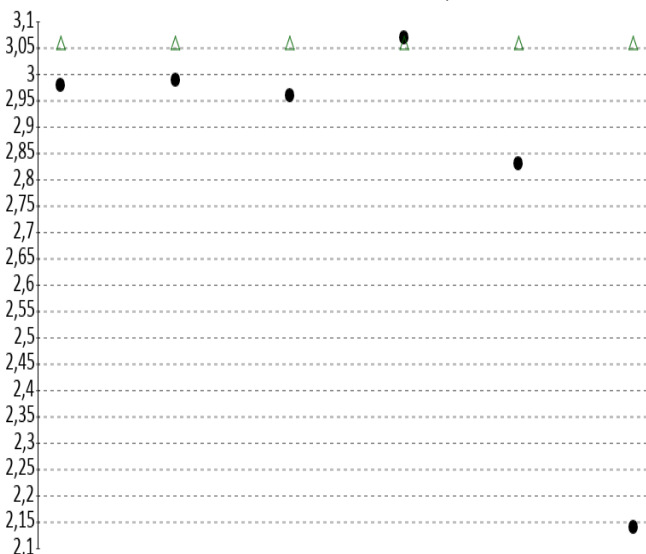

● Resultado ▲ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	5	0	1	6
Porcentaje	83,33%	0%	16,67%	100%