



Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-Hb-Hemoglobina
Código de muestra: DI3612
Ronda: 4
Muestra: 6
Marzo 2025
Ciudad : Bogotá Distrito Capital, Cali Valle del Cauca, Medellín Antioquia

100232 - Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali
100233 - Christus Sinergia sede Gran vía Medellín
100237 - Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102


Maria Paula Mora E.

Analito : Hemoglobina A1C


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2025	MARZO	Roche Cobas 6000 (c501)	9.8	%	9.920	-0,4
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	2025	MARZO	Roche Cobas 6000 (c501)	10.03	%	9.920	0,37
3	100237	Christus Sinergia sede Bogotá Torre 102	2025	MARZO	Roche Cobas c111	9.45	%	9.900	-1,51

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 1 Z-score

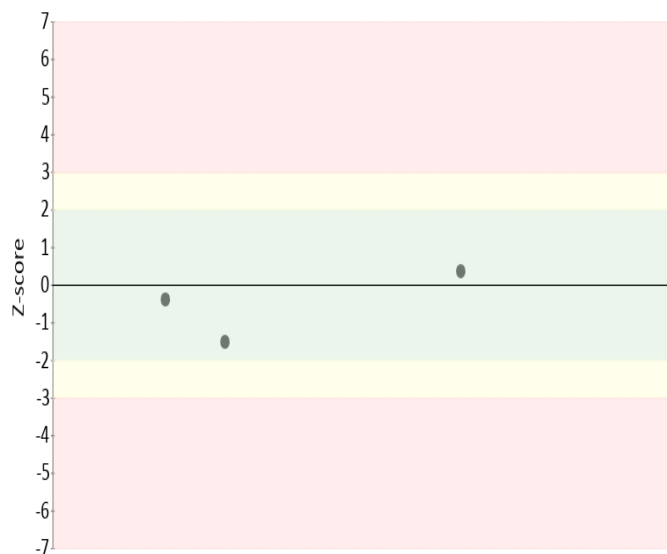

Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación

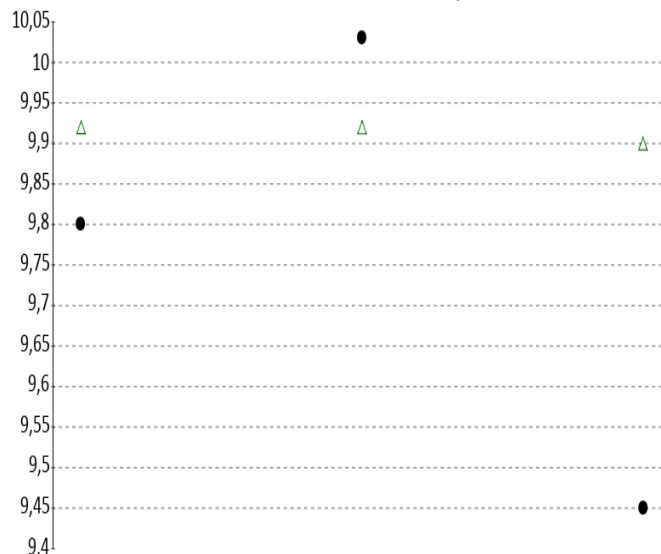

● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	3	0	0	3
Porcentaje	100%	0%	0%	100%