



Reporte Subgrupo  
Programa de aseguramiento de la calidad  
QAP-C-Coagulación  
Código de muestra: FJ0226  
Ronda: 48  
Muestra: 6  
Marzo 2025  
Ciudad : Cali Valle del Cauca, Medellín Antioquia

**100232 - Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali**  
**100233 - Christus Sinergia sede Gran vía Medellín**  
**100234 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones**  
**100235 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real**


*Maria Paula Mora E.*

**Analito :** Fibrinógeno


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100234	Christus Sinergia sede Lab Satellite Clinica Farallones	2025	MARZO	ACL ELITE PRO	90.6	mg/dL	105.000	-1,37

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 1 Z-score

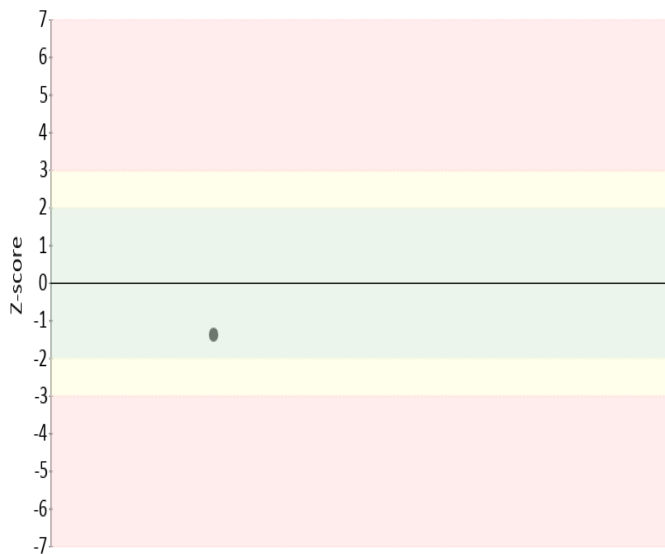

Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación

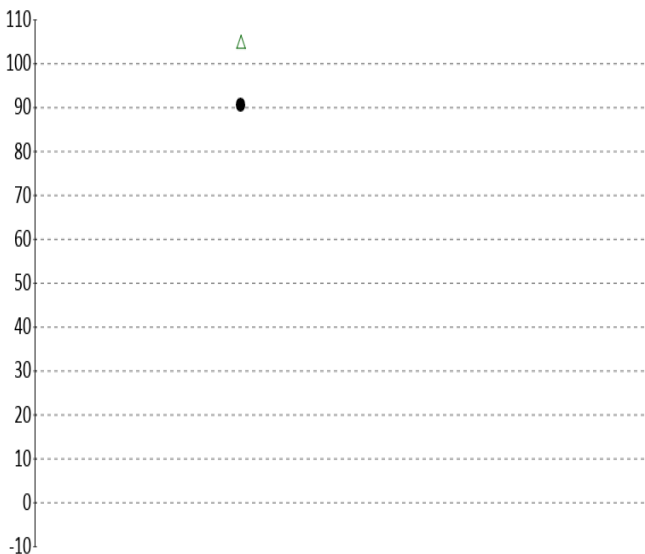

● Resultado    △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

**Analito :** Tiempo de protombina PT


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2025	MARZO	ACL TOP	46.8	Seconds	46.600	0,07
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	2025	MARZO	ACL ELITE PRO	44.9	Seconds	46.600	-0,62
3	100234	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones	2025	MARZO	ACL ELITE PRO	45.3	Seconds	46.600	-0,47
4	100235	Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real	2025	MARZO	ACL ELITE PRO	42.4	Seconds	46.600	-1,53

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 3 Z-score

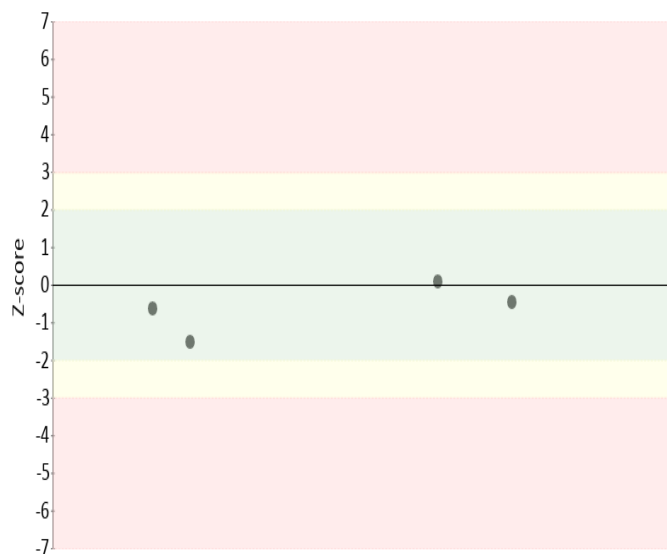

Gráfica 4 Resultado VS Media de comparación

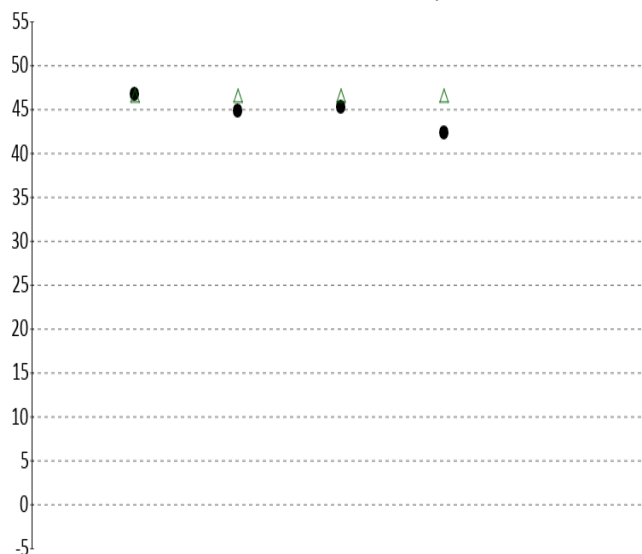

● Resultado    △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	4	0	0	4
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

**Analito :** Tiempo parcial de tromboplastina tisular PTT


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100232	Christus Sinergia sede Lab Central Procesamiento Cali	2025	MARZO	ACL TOP	98.1	Seconds	92.110	1,24
2	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	2025	MARZO	ACL ELITE PRO	31	Seconds	92.110	-12,68
3	100234	Christus Sinergia sede Lab Satellite Clinica Farallones	2025	MARZO	ACL ELITE PRO	82.3	Seconds	92.110	-2,04
4	100235	Christus Sinergia sede Lab Satellite Clinica Palma Real	2025	MARZO	ACL ELITE PRO	99.4	Seconds	92.110	1,51

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 5 Z-score

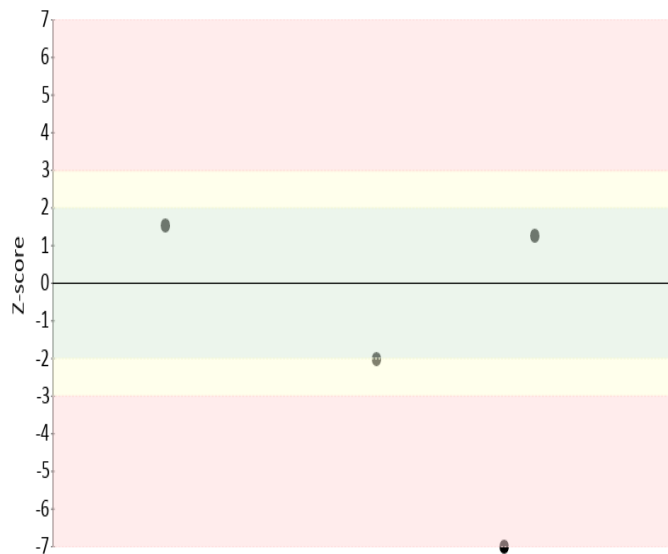

Gráfica 6 Resultado VS Media de comparación

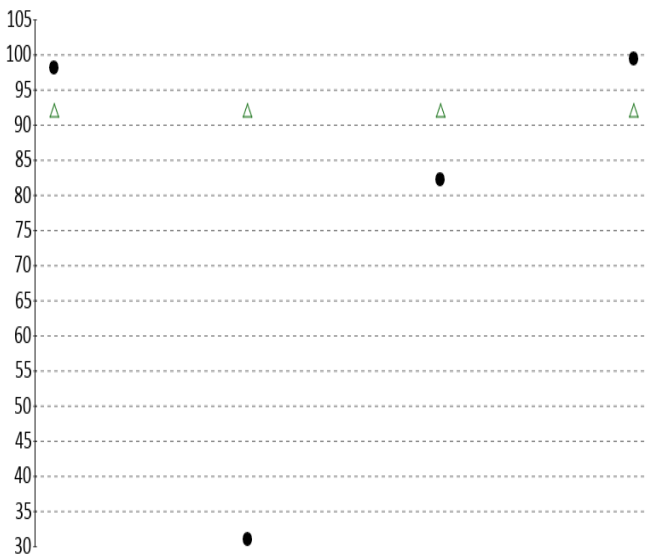

● Resultado    △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	1	1	4
Porcentaje	50%	25%	25%	100%