



"Quality Assurance Program"

Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica



www.quik.com.co

**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE  
CALIDAD**  
**QAP-Q - Química sanguínea**

**CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER- SEDE  
BARRANCABERMEJA**

Correo electrónico: [dayane.canedo@cruzrojasantander.org](mailto:dayane.canedo@cruzrojasantander.org)  
Dirección: Calle 48 No- 22-141 Barrio Colombia Edificio Cruz  
Roja  
Ciudad: Barrancabermeja Santander  
País: Colombia  
Contacto: Dayane Canedo de León  
Teléfono: 3114023707

**IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100132**

Código de reporte: QAP-Q-100132-39-4  
Ronda: 39  
Muestra: 4  
Código de la muestra: AB1245  
Tipo de muestra: Liofilizado -Suero humano  
Fecha generación: 26 / marzo / 2022

Identificación Laboratorio:	100132
Ronda:	39
Muestra:	4
Código Muestra:	AB1245
Fecha reporte:	2022-03-25
Estado:	Evaluación original

## 1. TÉRMINOS GENERALES

### Confidencialidad:

Quik SAS como organización certificada ISO 27001:2013 <sup>1</sup>, y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 <sup>2</sup>, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de la seguridad de la información y en cumplimiento con el numeral.
- (2) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

### Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos.

### Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. y para los programas de patología anatómica con la fundación Santa Fé de Bogotá

Identificación Laboratorio:	100132
Ronda:	39
Muestra:	4
Código Muestra:	AB1245
Fecha reporte:	2022-03-25
Estado:	Evaluación original

## 2. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IT	NOT	Mensurando	Analizador	Método	VRL	U-LAB	M-C	U-MC	DE-C	T-C	Zs	VAL	COMP
1		Acido Úrico	Mindray BS 120	Uricase, colorimetric	4.70	mg/dL	4,72	mg/dL	0,18	Acumulada	-0,11	Satisfactorio	Método
2		ALT (ALAT/GPT)	Mindray BS 120	UV without P5P	30.8	U/L	28,61	U/L	2,15	Acumulada	1,02	Satisfactorio	Método
3		AST (ASAT/GOT)	Mindray BS 120	UV without P5P	39.7	U/L	39,74	U/L	2,96	Acumulada	-0,01	Satisfactorio	Método
4		Colesterol HDL	Mindray BS 120	Direct Enzymatic Colorimetric	67.0	mg/dL	63,95	mg/dL	7,46	Mensual	0,41	Satisfactorio	Método
5		Colesterol Total	Mindray BS 120	Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase	242.0	mg/dL	247,3	mg/dL	9,77	Acumulada	-0,54	Satisfactorio	Método
6		Creatinina	Mindray BS 120	Alkaline picrate-kinetic	2.27	mg/dL	2,37	mg/dL	0,22	Inserto	-0,45	Satisfactorio	Método
7		Fosfatasa Alcalina	Mindray BS 120	PNPP, AMP Buffer	119	U/L	111	U/L	14	Inserto	0,57	Satisfactorio	Método
8		Glucosa	Mindray BS 120	Glucose oxidase, hydrogen peroxide (Trinder)	86.0	mg/dL	86,26	mg/dL	4,81	Acumulada	-0,05	Satisfactorio	Método
9		Nitrógeno Uréico	Mindray BS 120	Urease, UV	16.0	mg/dL	15,43	mg/dL	0,68	Acumulada	0,84	Satisfactorio	Método
10		Triglicéridos	Mindray BS 120	GPO-POD	182	mg/dL	179,5	mg/dL	7,76	Acumulada	0,32	Satisfactorio	Todos los laboratorios

<b>IT:</b> Item	<b>NOT:</b> Notificaciones	<b>VRL:</b> Valor reportado por el laboratorio	<b>U-LAB:</b> Unidades de laboratorio	<b>U-MC:</b> Unidades Originales de la media de comparación
<b>M-C:</b> Media del grupo de comparación	<b>DE-C:</b> Desviación estándar del grupo de comparación	<b>T-C:</b> Tipo de consenso	<b>Zs:</b> Z-score	<b>VAL:</b> Valoración
<b>COMP:</b> Comparador				

<b>Satisfactorio</b> si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	<b>Alarma</b> si su resultado está entre 2 y 3 Z-score.	<b>No satisfactorio</b> si su resultado es mayor a 3 Z-score.	<input type="radio"/> Tardío	<input checked="" type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Revalorado
---	--	--	---------------------------------	--	--

Identificación Laboratorio:	100132
Ronda:	39
Muestra:	4
Código Muestra:	AB1245
Fecha reporte:	2022-03-25
Estado:	Evaluación original

**3. EVALUACIÓN CON VALOR OBTENIDO CON EL MÉTODO TRAZABLE A MATERIAL Y/O MÉTODO AVALADO POR EL JCTLM**

1 Item	2 Mensurando	3 VRL	4 U-LAB	5 V.A.V.	6 U-V.A.V.	7 M-REF	8 D%	9 ETmp%	10 Límites aceptación Bajo Alto		11 Valoración
1	Colesterol HDL	67.0	mg/dL	75.600	mg/dL	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	-11,38	30	52,92	98,28	Satisfactorio
2	Colesterol Total	242.0	mg/dL	248.000	mg/dL	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	-2,42	10	223,2	272,8	Satisfactorio
3	Creatinina	2.27	mg/dL	1.720	mg/dL	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	31,98	10	1,55	1,89	No satisfactorio
4	Fosfatasa Alcalina	119	U/L	109.000	U/L	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	9,17	30	76,3	141,7	Satisfactorio
5	Glucosa	86.0	mg/dL	79.000	mg/dL	Ver sección 5: Informe de trazabilidad metrológica	8,86	8	72,68	85,32	No satisfactorio

<b>VRL:</b> Valor reportado por el laboratorio	<b>U-V.A.V.:</b> Unidades del valor aceptado como verdadero
<b>U-LAB:</b> Unidades de laboratorio	<b>M-REF:</b> Método de referencia
	<b>D%</b> Diferencia porcentual %

Satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio NO supera la diferencia porcentual del ETmp comparado con V.A.V	No satisfactorio: El resultado reportado por el laboratorio SI supera la diferencia porcentual del ETmp comparado con V.A.V	ETmp Error Total máximo permisible * Fuente CLIA	V.A.V. Valor aceptado como verdadero
--	---	--	---

Identificación Laboratorio:	100132
Ronda:	39
Muestra:	4
Código Muestra:	AB1245
Fecha reporte:	2022-03-25
Estado:	Evaluación original

**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**

**Ácido Úrico**

**4.70 mg/dL**


Uricase, colorimetric

10% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	4,72	0,18	171000	4,37 a 5,07	-0,42	-0,11	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	4,93	0,51	28	3,92 a 5,95	-4,71	-0,46	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	4,87	0,45	20	3,97 a 5,77	-3,52	-0,38	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)

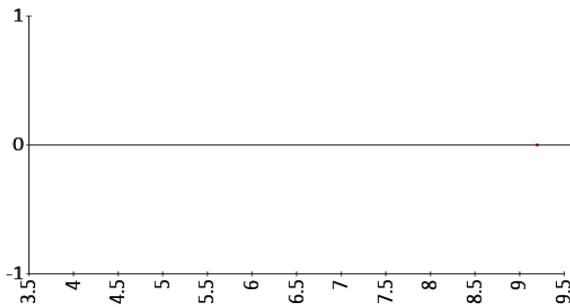

Gráfica Z-score vs concentración

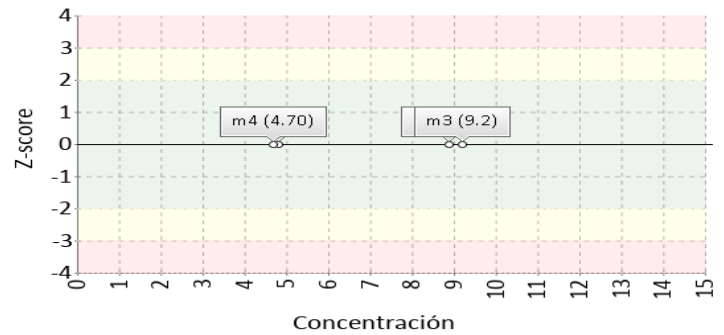

**ALT (ALAT/GPT)**

**30.8 U/L**


UV without P5P

20% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	28,61	2,15	141000	24,31 a 32,91	7,65	1,02	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	29	4,19	52	20,62 a 37,38	6,21	0,43	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	28,78	4	37	20,78 a 36,78	7,02	0,5	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)

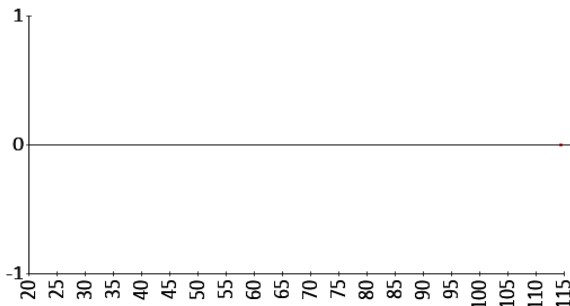

Gráfica Z-score vs concentración

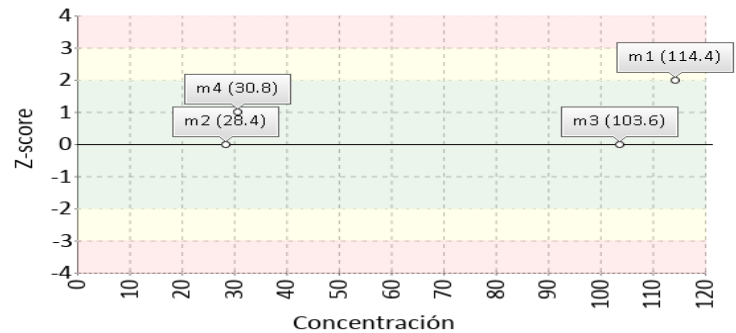

**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**

**AST (ASAT/GOT)**

**39.7 U/L**


UV without P5P

20% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	39,74	2,96	137000	33,82 a 45,66	-0,1	-0,01	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	40,96	3,76	51	33,44 a 48,47	-3,07	-0,33	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	40,59	3,79	37	33 a 48,18	-2,2	-0,24	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)

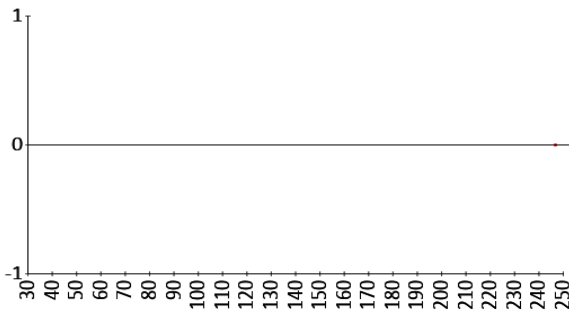

Gráfica Z-score vs concentración

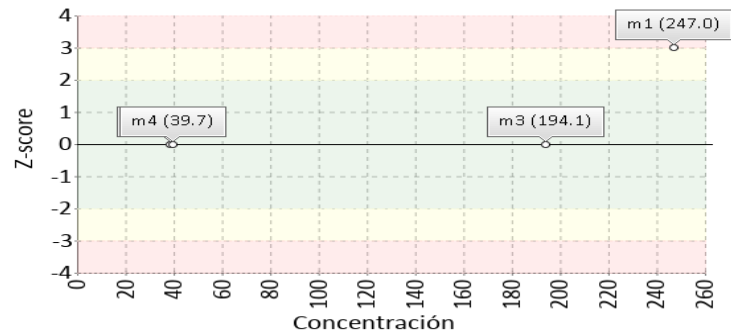

**Colesterol HDL**

**67.0 mg/dL**


Direct Enzymatic Colorimetric

30% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	75.600	N/A	N/A	N/A	-11,38	N/A	Satisfactorio
Media de comparación internacional	63,95	7,46	1985	49,03 a 78,87	4,77	0,41	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	61,84	7,1	61	47,64 a 76,04	8,34	0,73	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	60,35	6,09	43	48,17 a 72,53	11,03	1,09	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)

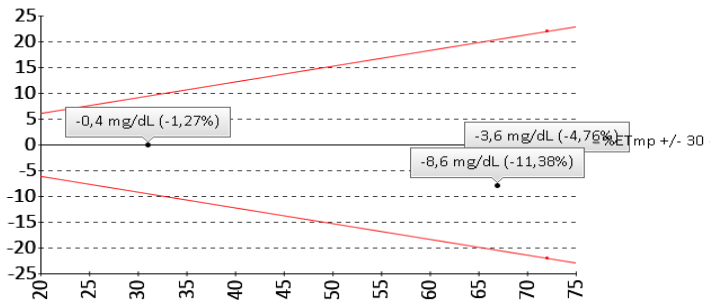

Gráfica Z-score vs concentración

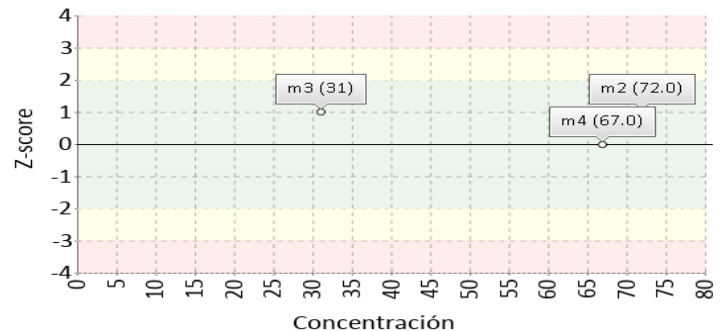

**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**

**Colesterol Total**



**242.0 mg/dL**

Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase

10% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	248.000	N/A	N/A	N/A	-2,42	N/A	Satisfactorio
Media de comparación internacional	247,3	9,77	204000	227,76 a 266,84	-2,14	-0,54	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	244,67	8,84	67	226,98 a 262,35	-1,09	-0,3	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	243,28	7,94	51	227,39 a 259,16	-0,52	-0,16	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

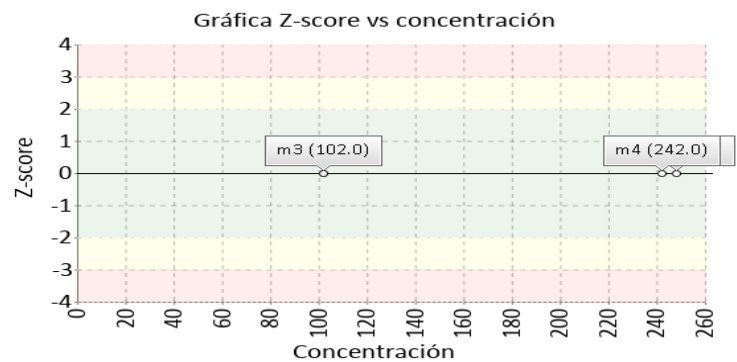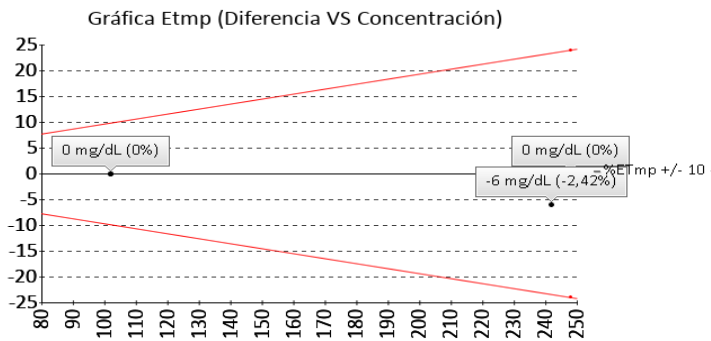

**Creatinina**



**2.27 mg/dL**

Alkaline picrate-kinetic

10% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	1.720	N/A	N/A	N/A	31,98	N/A	No satisfactorio
Media de inserto	2,37	0,22	N/A	1,93 a 2,81	-4,22	-0,45	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	1,94	0,29	66	1,36 a 2,52	16,94	1,13	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	2,09	0,32	12	1,45 a 2,73	8,7	0,57	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

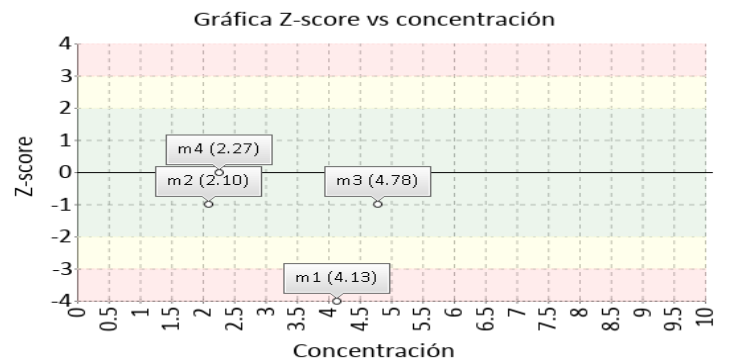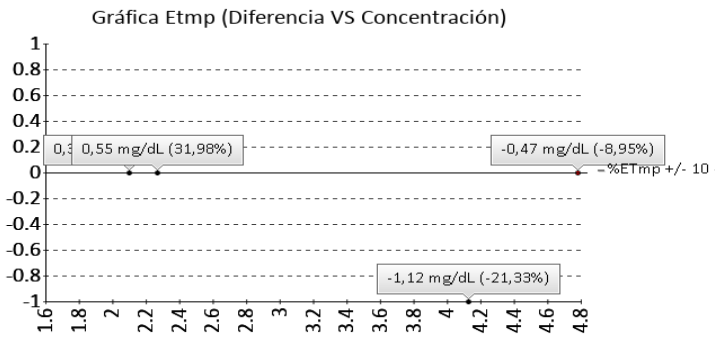

**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**

**Fosfatasa Alcalina**



**119 U/L**

PNPP, AMP Buffer

30% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	109,000	N/A	N/A	N/A	9,17	N/A	Satisfactorio
Media de inserto	111	14	N/A	83 a 139	7,21	0,57	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	110,33	27,37	27	55,58 a 165,07	7,86	0,32	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	108,12	22,93	18	62,25 a 153,98	10,07	0,47	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

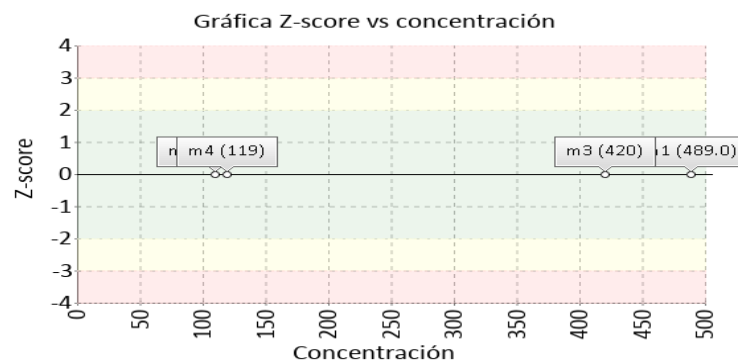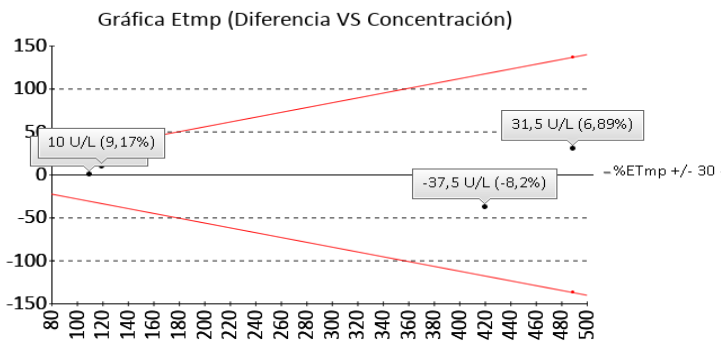

**Glucosa**



**86.0 mg/dL**

Glucose oxidase, hydrogen peroxide (Trinder)

8% ETmp

1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	79,000	N/A	N/A	N/A	8,86	N/A	No satisfactorio
Media de comparación internacional	86,26	4,81	38616	76,64 a 95,88	-0,3	-0,05	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	79,73	4,08	67	71,57 a 87,88	7,87	1,54	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	82,7	7,95	22	66,8 a 98,61	3,98	0,41	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

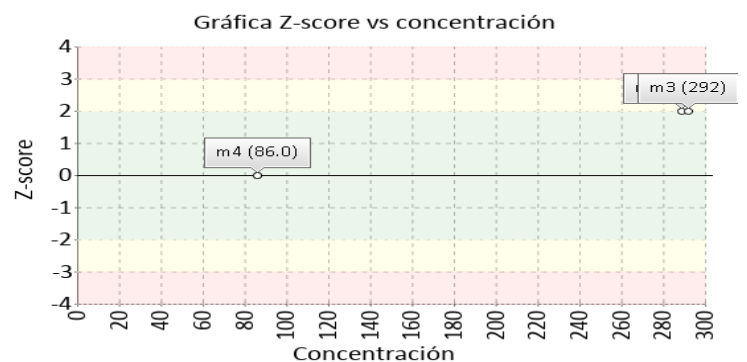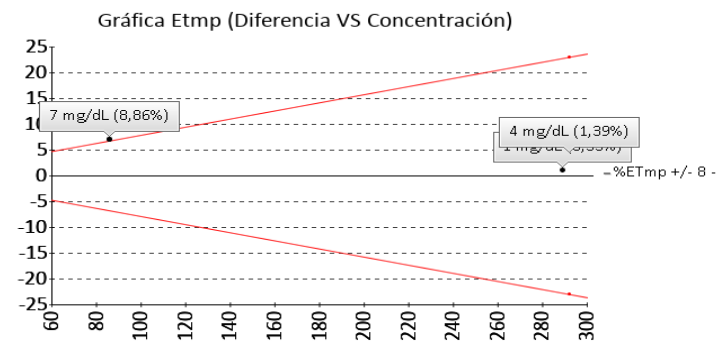



**4. EVALUACIÓN CON MEDIA DE COMPARACIÓN Y CON V.A.V (VALOR ACEPTADO COMO VERDADERO)**

**Nitrógeno Uréico**

**16.0 mg/dL**


Urease, UV

9% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	15,43	0,68	105000	14,07 a 16,79	3,69	0,84	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	14,92	1,68	30	11,57 a 18,27	7,24	0,64	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	15,24	1,06	22	13,13 a 17,35	4,97	0,72	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)

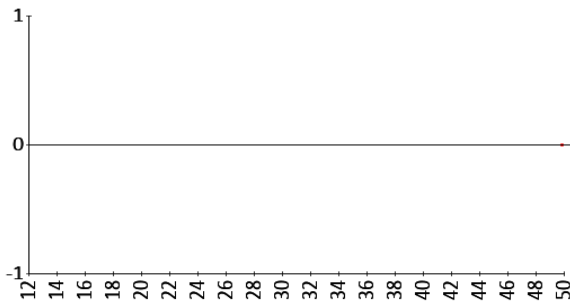

Gráfica Z-score vs concentración

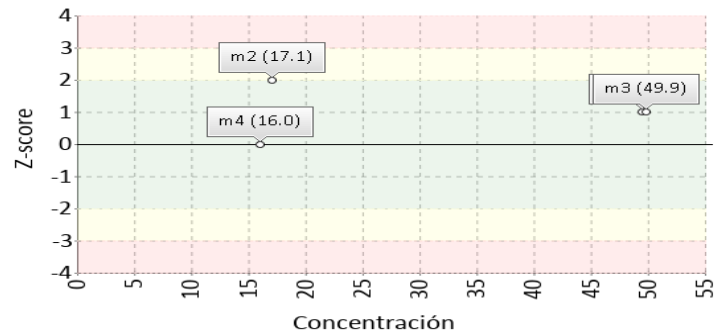

**Triglicéridos**

**182 mg/dL**


GPO-POD

15% ETmp


1 Fuente de comparación	2 V.A.V.	3 D.E.	4 n/N	5 Incertidumbre	6 Diferencia%	7 Z-score	8 Valoración
RL-MMT-JCTLM <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Media de comparación internacional	179,5	7,76	195000	163,98 a 195,02	1,39	0,32	Satisfactorio
Todos los participantes de QAP	178,52	8,37	68	161,78 a 195,26	1,95	0,42	Satisfactorio
Participantes QAP misma metodología	177,39	9,18	31	159,03 a 195,76	2,6	0,5	Satisfactorio

(1) RL-MMT-JCTLM: Resultado de laboratorio que trabaja con material y método trazable a los avalados por el JCTLM

Gráfica Etmp (Diferencia VS Concentración)

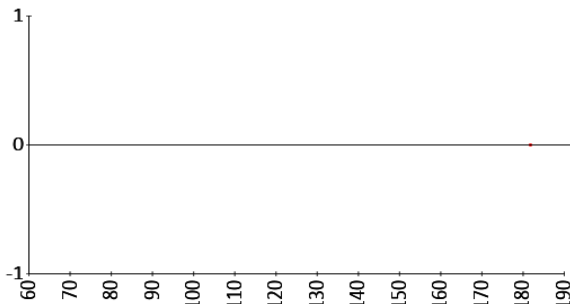

Gráfica Z-score vs concentración

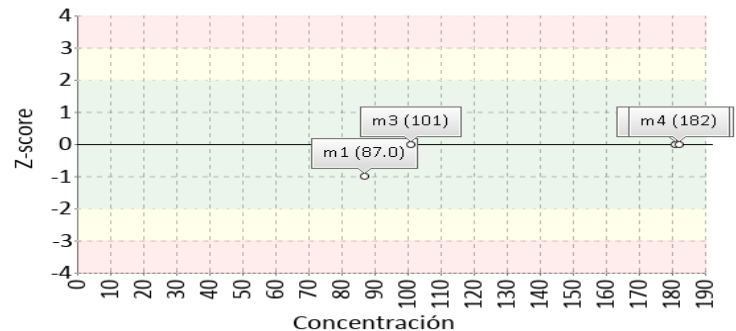

Identificación Laboratorio:	100132
Ronda:	39
Muestra:	4
Código Muestra:	AB1245
Fecha reporte:	2022-03-25
Estado:	Evaluación original

**5. INFORME DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA**

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	Mensurando	Analizador	Metodología declarada por el fabricante	Metodología de referencia avalada por el JCTLM	Material trazable declarado por el fabricante	Material de referencia avalado por el JCTLM	Estado de trazabilidad
1	Ácido Úrico	Mindray BS 120	Uricase, colorimetric	1 2	No declarado	115 116 112 117 113 114	No trazable
2	ALT (ALAT/GPT)	Mindray BS 120	UV without P5P	4	No declarado		No trazable
3	AST (ASAT/GOT)	Mindray BS 120	UV without P5P	40	No declarado	12	No trazable
4	Bilirrubina Directa	Mindray BS 120	Sulphanilic acid, DMSO		No declarado		No trazable
5	Bilirrubina Total	Mindray BS 120	Sulphanilic acid, DMSO	6 7	No declarado		No trazable
6	Colesterol HDL	Mindray BS 120	Direct Enzymatic Colorimetric	16	No declarado	66	No trazable
7	Colesterol Total	Mindray BS 120	Cholesterol oxidase, esterase, peroxidase	18 20 19 21 22	No declarado	25 100 30 101 31 29 28 27 26	No trazable
8	Creatinina	Mindray BS 120	Alkaline picrate-kinetic	26 24 25 27 28	No declarado	42 43 44 41 47 48 45 46 51 52 50 49 40	No trazable
9	Fosfatasa Alcalina	Mindray BS 120	PNPP, AMP Buffer	31	No declarado		No trazable
10	Glucosa	Mindray BS 120	Glucose oxidase, hydrogen peroxide (Trinder)	33 34 35 36	No declarado	60 62 61 63 64	No trazable
11	Nitrógeno Uréico	Mindray BS 120	Urease, UV		No declarado		No trazable
12	Triglicéridos	Mindray BS 120	GPO-POD	77 78	No declarado	106 104 105	No trazable

**Nomenclatura método**

**1:** ID/GC/MS **2:** ID/LC/MS, ID/LC/MS/MS **4:** Kinetic spectrophotometry **40:** Kinetic spectrophotometry **6:** Absorption spectrometry **7:** Spectrophotometry **16:** Ultracentrifugation removes VLDL, d 1.006, preventing interference (TG) with the heparin/Mn2+ precipitation step for removal of non-HDL. HDL cholesterol is spectrophotometric. **18:** HPLC **20:** ID-LC/MS/MS **19:** ID/GC/MS **21:** Isotope dilution LCMS **22:** Spectrophotometry **26:** ID-LC/MS **24:** ID/GC/MS **25:** ID/LC/MS, ID/LC/MS/MS **27:** Isotope dilution LCMS **28:** Isotope dilution surface enhanced Raman scattering (ID/SERS) **31:** kinetic spectrophotometry **33:** Enzymatic **34:** ID/GC/MS **35:** ID/LC/MS/MS **36:** Spectrophotometry **77:** ID/GC/MS **78:** Spectrophotometry

**Nomenclatura materiales**

**115:** GBW09202, uric acid **116:** HRM-3002A, Creatinine, Glucose, Total Cholesterol, Urea, and Uric Acid in Frozen Human Serum **112:** JCLLS021, Uric acid in human serum **117:** NMIJ CRM 6008-a, uric acid **113:** SRM 909b, human serum **114:** SRM 913a, uric acid **12:** ERM-AD457/IFCC, aspartate aminotransferase **66:** LNE CRM Bio 101a, Glucose, creatinine, total cholesterol, total glycerides, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol in frozen human serum **25:** GBW09203b, cholesterol **100:** HRM-3002A, Creatinine, Glucose, Total Cholesterol, Urea, and Uric Acid in Frozen Human Serum Name of the reference material **30:** JCCRM 211, cholesterol **101:** LNE CRM Bio 101a, Glucose, creatinine, total cholesterol, total glycerides, HDL cholesterol, LDL-cholesterol in frozen human serum **31:** NMIJ CRM 6001-a, Cholesterol **29:** SRM 1951b, lipids in frozen human serum **28:** SRM 1952a, cholesterol in human serum **27:** SRM 909b, human serum **26:** SRM 911c, Cholesterol **42:** BCR-573, creatinine in human serum **43:** BCR-574, creatinine in human serum **44:** BCR-575, creatinine in human serum **41:** DMR 263a, Frozen human serum **47:** ERM-DA250a **48:** ERM-DA251a **45:** ERM-DA252a **46:** ERM-DA253a **51:** HRM-3002A, Creatinine, Glucose, Total Cholesterol, Urea, and Uric Acid in Frozen Human Serum **52:** LNE CRM Bio 101a, Glucose, creatinine, total cholesterol, total glycerides, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol in frozen human serum **50:** NMIJ CRM 6005-a, Creatinine **49:** SRM 909b, human serum **40:** SRM 914a, creatinine **60:** DMR 263a, Frozen human serum **62:** HRM-3002A, Creatinine, Glucose, Total Cholesterol, Urea, and Uric Acid in Frozen Human Serum **61:** JCCRM521 **63:** LNE CRM Bio 101a, Glucose, creatinine, total cholesterol, total glycerides, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol in frozen human serum **64:** NIM CRM GBW 10062, Purity of Glucose **106:** JCCRM 223, lipids **104:** NMIJ CRM 6009-a, Triolein **105:** SRM 909b, human serum

Identificación Laboratorio:	100132
Ronda:	39
Muestra:	4
Código Muestra:	AB1245
Fecha reporte:	2022-03-25
Estado:	Evaluación original

**6. RESUMEN DE RONDA**


Ítem	Mensurando	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Muestra 4			Muestra 5			Muestra 6		
		Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP	Dif% con RL-MMT-JCTLM	Z-S WWR	Z Score particip antes QAP
1	Ácido Úrico	N/A	-0,5	-0,08	N/A	0,45	-0,26	N/A	0,25	0,22	N/A	-0,11	-0,46						
2	ALT (ALAT/GPT)	N/A	2,5	2,15	N/A	-0,1	-0,14	N/A	0,59	0,8	N/A	1,02	0,43						
3	AST (ASAT/GOT)	N/A	3,7	2,29	N/A	-0,45	-0,68	N/A	-0,6	-0,36	N/A	-0,01	-0,33						
4	Bilirrubina Directa	124,32	5	1,61	-19,57	0,14	-0,3	209,91	8,96	2,96	N/A	N/A	N/A						
5	Bilirrubina Total	1,15	-0,05	0,17	19,78	0,99	0,24	5,98	0,51	0,6	N/A	N/A	N/A						
6	Colesterol HDL	N/A	N/A	N/A	-4,76	1,08	1,43	-1,27	1,25	1,26	-11,38	0,41	0,73						
7	Colesterol Total	0	0,16	-0,04	0	0,07	0,38	0	0,16	-0,04	-2,42	-0,54	-0,3						
8	Creatinina	-21,33	-4,71	-4,34	22,09	-1,23	0,54	-8,95	-1,63	-1,98	31,98	-0,45	1,13						
9	Fosfatasa Alcalina	6,89	0,87	0,04	0,92	-0,07	-0,01	-8,2	-0,95	-0,54	9,17	0,57	0,32						
10	Glucosa	0,35	2,6	1,05	8,86	-0,05	1,54	1,39	2,95	1,23	8,86	-0,05	1,54						
11	Nitrógeno Uréico	N/A	1,61	0,82	N/A	2,46	1,3	N/A	1,86	0,87	N/A	0,84	0,64						
12	Triglicéridos	N/A	-1,99	-0,81	N/A	0,26	0,3	N/A	0,83	0,32	N/A	0,32	0,42						
<b>Notificaciones</b>		🚫 12 🗑️ 1 ✎️ 0			🚫 12 🗑️ 0 ✎️ 0			🚫 12 🗑️ 0 ✎️ 0			🚫 0 🗑️ 2 ✎️ 0			🚫 0 🗑️ 0 ✎️ 0			🚫 0 🗑️ 0 ✎️ 0		

V.A.V - La diferencia porcentual es inferior o igual al error total máximo permisible.	V.A.V - La diferencia porcentual es superior al error total máximo permisible.	<b>Satisfactorio</b> si su resultado está entre +/- 2 Z-score.	<b>Alarma</b> si su resultado está entre 2 y 3 Z-score.	<b>No satisfactorio</b> si su resultado es mayor a 3 Z-score.	N/A No aplica	🚫 Tardío	🗑️ Ausente	✎️ Revalorado
--	--	---	--	--	---------------	----------	------------	---------------

Identificación Laboratorio:	100132
Ronda:	39
Muestra:	4
Código Muestra:	AB1245
Fecha reporte:	2022-03-25
Estado:	Evaluación original

**7. INDICADORES DE COMPETENCIA TÉCNICA**

**7.1. DESEMPEÑO PARA LAS 4 MUESTRAS**

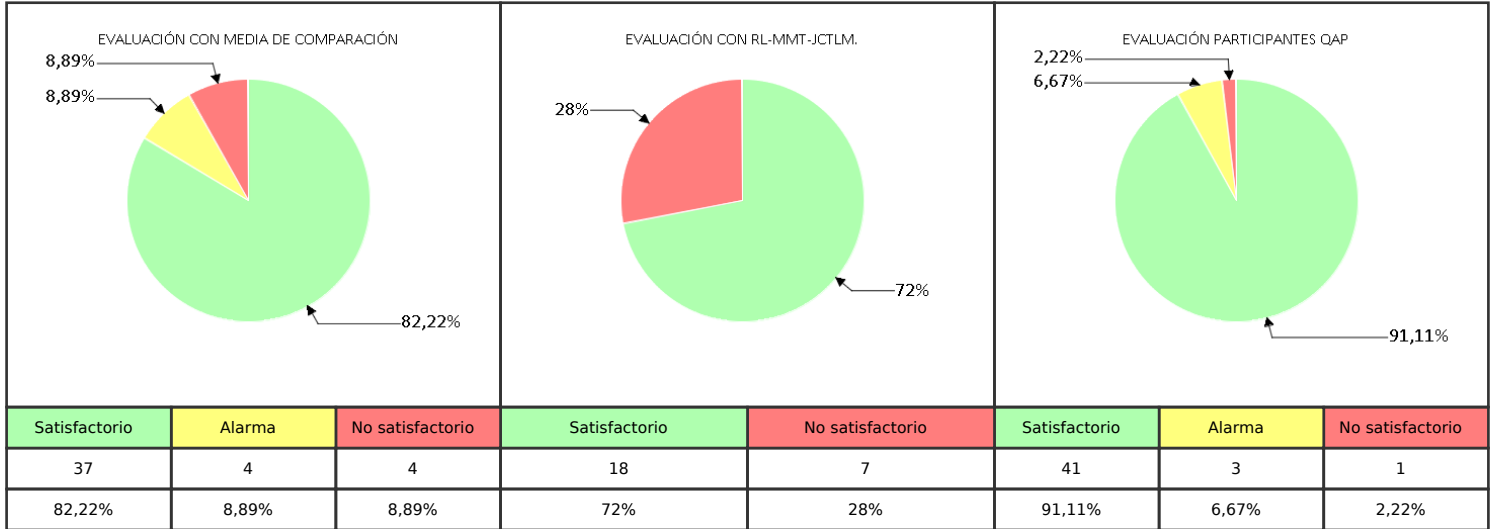

Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte --

**Aprobado por:  
Aída Porras. Magister en Biología. Doctor in management.  
Coordinadora programas QAP**