



Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica

Reporte Subgrupo  
Programa de aseguramiento de la calidad  
QAP-H-Hematología  
Código de muestra: PL2118  
Ronda: 41, 42  
Muestra: 2, 1  
Febrero, Enero 2024  
Ciudad : Bogotá Distrito Capital



100108 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.  
100170 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo  
100177 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín  
100178 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana  
100179 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede VIP  
100180 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes  
100181 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo  
100182 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza  
100183 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda  
100192 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82  
100193 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio

*Maria Paula Mora E.*

**Analito :** Ancho de distribución del eritrocito

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2024	ENERO	Sysmex XP-300	14.4	%	14.460	-0,04
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	14.6	%	14.460	0,09
3	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2024	ENERO	Sysmex XP-300	14.6	%	14.460	0,09
4	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2024	ENERO	Sysmex XP-300	14.4	%	14.460	-0,04
5	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2024	ENERO	Sysmex XP-300	14.5	%	14.460	0,03
6	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	14.4	%	14.460	-0,04
7	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2024	ENERO	Sysmex XP-300	14.5	%	14.460	0,03
8	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2024	ENERO	Sysmex XP-300	14.4	%	14.460	-0,04
9	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2024	ENERO	Mindray BC-20S	14.7	%	14.460	0,16
10	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio	2024	ENERO	Sysmex XP-300	14.3	%	14.460	-0,11

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

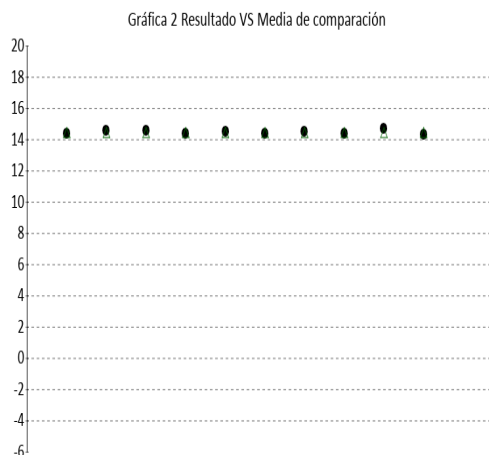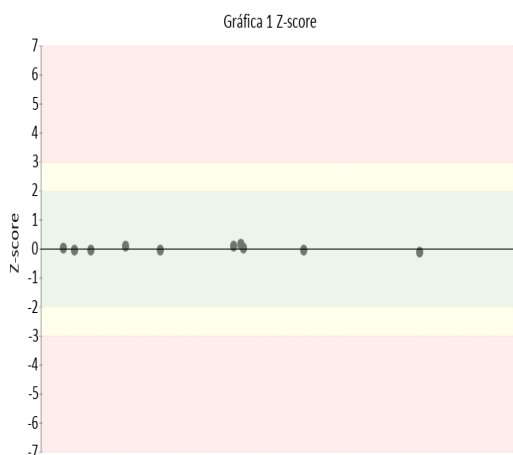



● Resultado    △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	10	0	0	10
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

**Analito :** Concentración de hemoglobina corpuscular media

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2024	ENERO	Sismex XP-300	31.9	g/dL	32.980	-0,59
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2024	ENERO	Sismex XP-300	29.8	g/dL	32.980	-1,73
3	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2024	ENERO	Sismex XP-300	32.2	g/dL	32.980	-0,42
4	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2024	ENERO	Sismex XP-300	31.7	g/dL	32.980	-0,7
5	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2024	ENERO	Sismex XP-300	29.9	g/dL	32.980	-1,67
6	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2024	ENERO	Sismex XP-300	31.0	g/dL	32.980	-1,08
7	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2024	ENERO	Sismex XP-300	32.8	g/dL	32.980	-0,1
8	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2024	ENERO	Sismex XP-300	30.8	g/dL	32.980	-1,18
9	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2024	ENERO	Mindray BC-20S	31.2	g/dL	32.980	-0,97
10	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Río	2024	ENERO	Sismex XP-300	32.5	g/dL	32.980	-0,26

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

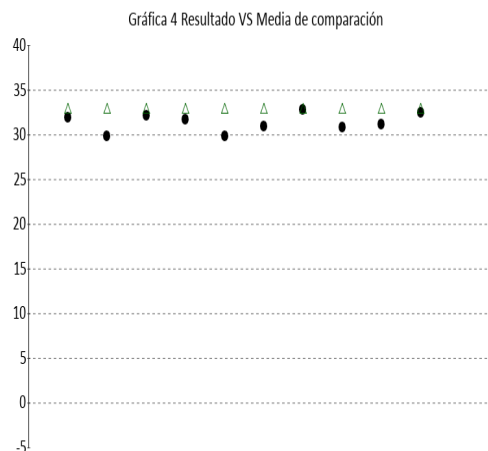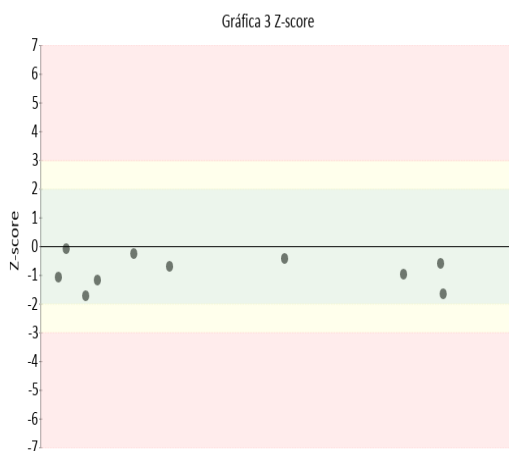



● Resultado    ▲ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	10	0	0	10
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

**Analito :** Hematocrito

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2024	ENERO	Sysmex XP-300	50.5	%	48.590	0,7
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	53.8	%	48.590	1,92
3	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2024	ENERO	Sysmex XP-300	50.1	%	48.590	0,56
4	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2024	ENERO	Sysmex XP-300	51.6	%	48.590	1,11
5	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2024	ENERO	Sysmex XP-300	53.6	%	48.590	1,85
6	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	51.5	%	48.590	1,07
7	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2024	ENERO	Sysmex XP-300	49.3	%	48.590	0,26
8	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2024	ENERO	Sysmex XP-300	53.7	%	48.590	1,89
9	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2024	ENERO	Mindray BC-20S	52.5	%	48.590	1,44
10	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio	2024	ENERO	Sysmex XP-300	49.8	%	48.590	0,45

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

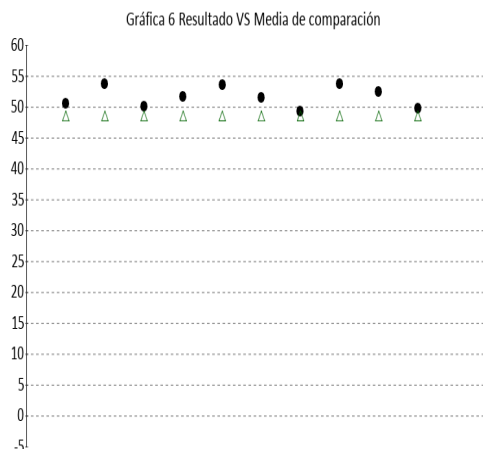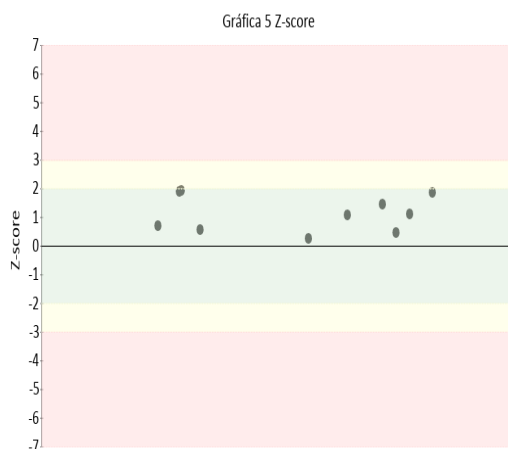



● Resultado    △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	10	0	0	10
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

**Analito :** Hemoglobina

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2024	ENERO	Sysmex XP-300	16.1	g/dL	15.800	1
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	16.0	g/dL	15.800	0,67
3	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2024	ENERO	Sysmex XP-300	16.4	g/dL	15.800	2
4	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2024	ENERO	Sysmex XP-300	16.4	g/dL	15.800	2
5	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2024	ENERO	Sysmex XP-300	16.0	g/dL	15.800	0,67
6	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	16.0	g/dL	15.800	0,67
7	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2024	ENERO	Sysmex XP-300	16.2	g/dL	15.800	1,33
8	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2024	ENERO	Sysmex XP-300	16.5	g/dL	15.800	2,33
9	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2024	ENERO	Mindray BC-20S	16.4	g/dL	16.03	0,97
10	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio	2024	ENERO	Sysmex XP-300	16.2	g/dL	15.800	1,33

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

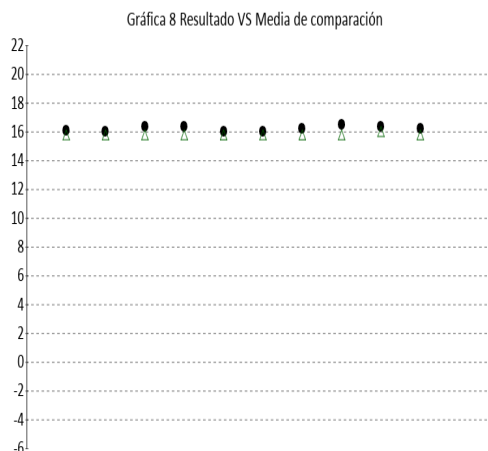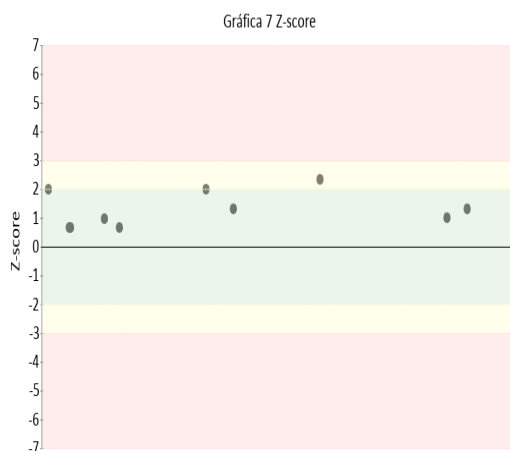



● Resultado    △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	7	3	0	10
Porcentaje	70%	30%	0%	100%

**Analito :** Hemoglobina corpuscular media

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2024	ENERO	Sysmex XP-300	30.8	pg/cell	31.280	-0,75
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	29.3	pg/cell	31.280	-3,09
3	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2024	ENERO	Sysmex XP-300	31.9	pg/cell	31.280	0,97
4	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2024	ENERO	Sysmex XP-300	31.3	pg/cell	31.280	0,03
5	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2024	ENERO	Sysmex XP-300	29.3	pg/cell	31.280	-3,09
6	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	29.8	pg/cell	31.280	-2,31
7	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2024	ENERO	Sysmex XP-300	32.2	pg/cell	31.280	1,44
8	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2024	ENERO	Sysmex XP-300	30.2	pg/cell	31.280	-1,69
9	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2024	ENERO	Mindray BC-20S	30.2	pg/cell	31.280	-1,69
10	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Río	2024	ENERO	Sysmex XP-300	31.8	pg/cell	31.280	0,81

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

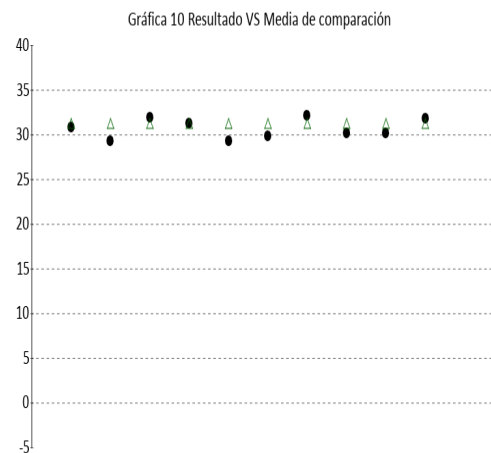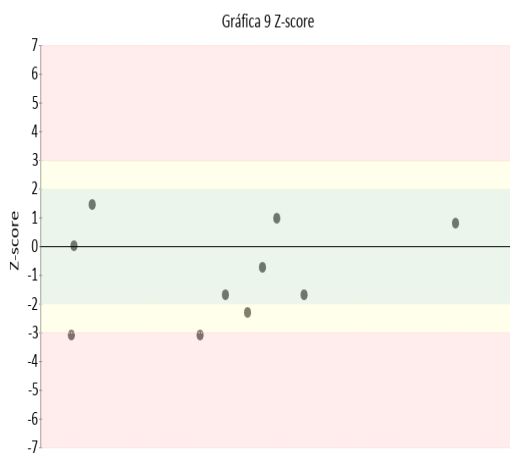



● Resultado    △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	7	1	2	10
Porcentaje	70%	10%	20%	100%

**Analito :** Recuento de glóbulos blancos

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2024	ENERO	Sysmex XP-300	21.7	K/uL	21.220	0,23
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	21.8	K/uL	21.220	0,27
3	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2024	ENERO	Sysmex XP-300	23.7	K/uL	21.220	1,18
4	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2024	ENERO	Sysmex XP-300	21.2	K/uL	21.220	-0,01
5	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2024	ENERO	Sysmex XP-300	20.5	K/uL	21.220	-0,34
6	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	21.9	K/uL	21.220	0,32
7	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2024	ENERO	Sysmex XP-300	22.9	K/uL	21.220	0,8
8	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2024	ENERO	Sysmex XP-300	21.4	K/uL	21.220	0,09
9	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2024	ENERO	Mindray BC-20S	21.8	K/uL	21.220	0,27
10	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio	2024	ENERO	Sysmex XP-300	23.3	K/uL	21.220	0,99

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

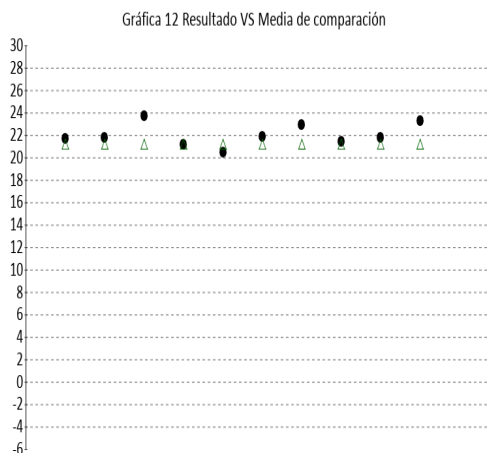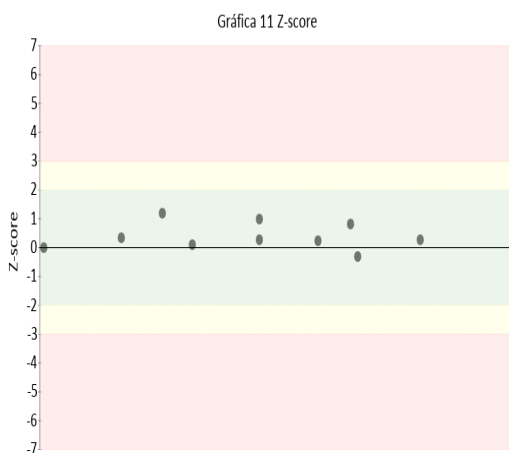



● Resultado    △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	10	0	0	10
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

**Analito :** Recuento de glóbulos rojos

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2024	ENERO	Sysmex XP-300	5.22	M/uL	5.150	0,55
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	5.47	M/uL	5.150	2,5
3	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2024	ENERO	Sysmex XP-300	5.10	M/uL	5.150	-0,39
4	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2024	ENERO	Sysmex XP-300	5.23	M/uL	5.150	0,63
5	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2024	ENERO	Sysmex XP-300	5.47	M/uL	5.150	2,5
6	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	5.35	M/uL	5.150	1,56
7	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2024	ENERO	Sysmex XP-300	5.02	M/uL	5.150	-1,02
8	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2024	ENERO	Sysmex XP-300	5.47	M/uL	5.150	2,5
9	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2024	ENERO	Mindray BC-20S	5.42	M/uL	5.150	2,11
10	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio	2024	ENERO	Sysmex XP-300	5.08	M/uL	5.150	-0,55

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

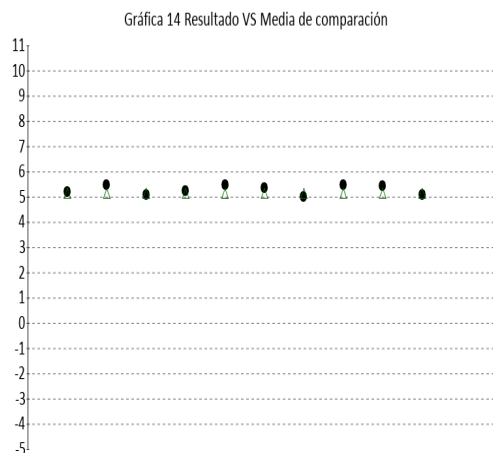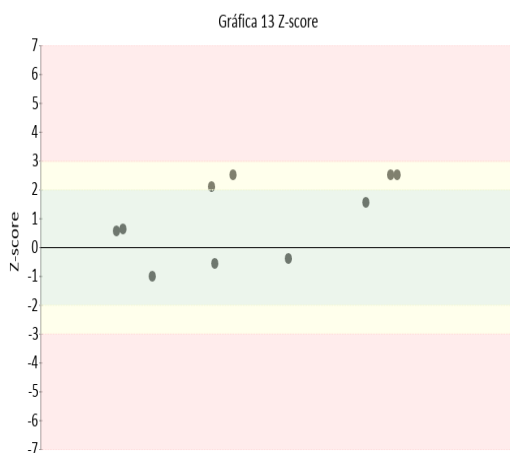

● Resultado    △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	6	4	0	10
Porcentaje	60%	40%	0%	100%



**Analito :** Recuento de plaquetas

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2024	ENERO	Sysmex XP-300	520	K/uL	502.600	0,48
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	600	K/uL	502.600	2,7
3	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2024	ENERO	Sysmex XP-300	518	K/uL	502.600	0,43
4	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2024	ENERO	Sysmex XP-300	544	K/uL	502.600	1,15
5	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2024	ENERO	Sysmex XP-300	609	K/uL	502.600	2,95
6	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	531	K/uL	502.600	0,79
7	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2024	ENERO	Sysmex XP-300	530	K/uL	502.600	0,76
8	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2024	ENERO	Sysmex XP-300	508	K/uL	502.600	0,15
9	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2024	ENERO	Mindray BC-20S	534	K/uL	502.600	0,87
10	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Río	2024	ENERO	Sysmex XP-300	513	K/uL	502.600	0,29

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---


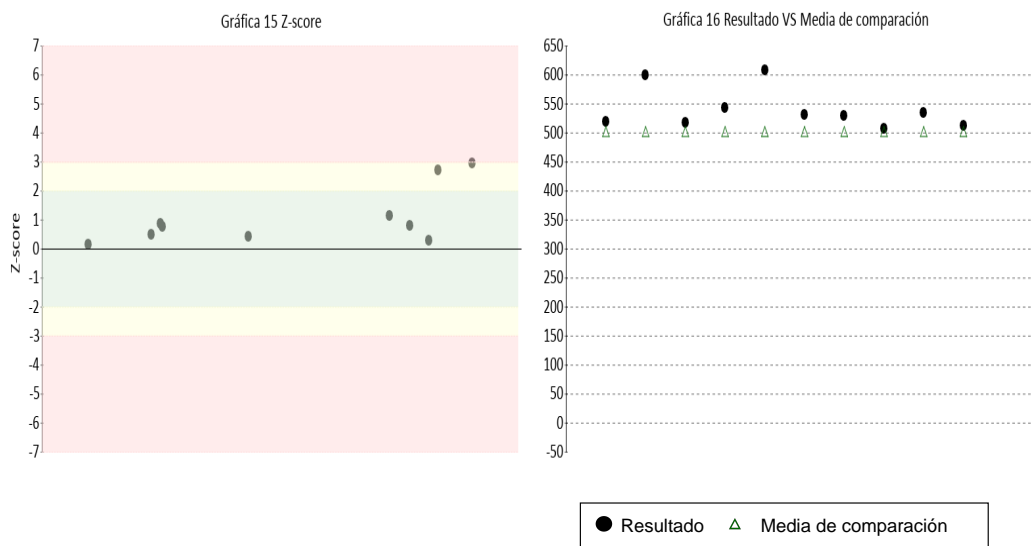


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	8	2	0	10
Porcentaje	80%	20%	0%	100%

**Analito :** Volumen corpuscular medio

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2024	ENERO	Sysmex XP-300	96.8	fL	94.410	0,6
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	98.3	fL	94.410	0,97
3	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2024	ENERO	Sysmex XP-300	98.0	fL	94.410	0,9
4	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2024	ENERO	Sysmex XP-300	98.7	fL	94.410	1,07
5	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2024	ENERO	Sysmex XP-300	97.9	fL	94.410	0,87
6	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	96.3	fL	94.410	0,47
7	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2024	ENERO	Sysmex XP-300	98.3	fL	94.410	0,97
8	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2024	ENERO	Sysmex XP-300	98.2	fL	94.410	0,95
9	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2024	ENERO	Mindray BC-20S	96.9	fL	94.410	0,62
10	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio	2024	ENERO	Sysmex XP-300	98.3	fL	94.410	0,97

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

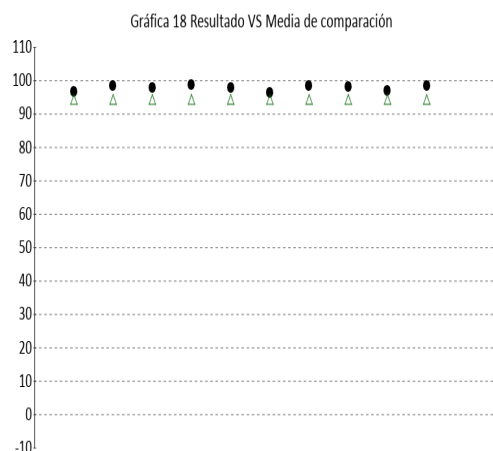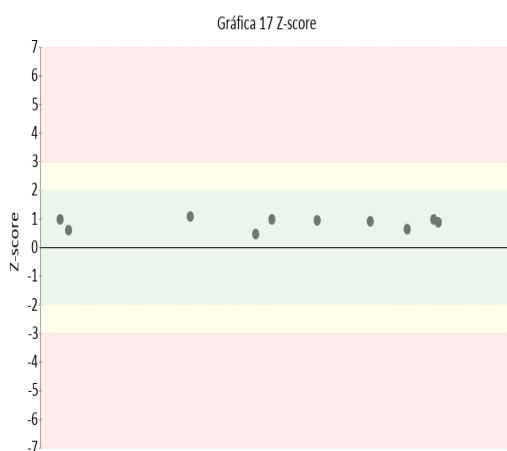



● Resultado    △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	10	0	0	10
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

**Analito :** Volumen plaquetario medio

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100108	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Lago.	2024	ENERO	Sysmex XP-300	11.5	fL	10.370	2,03
2	100170	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Montevideo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	11.4	fL	10.370	1,85
3	100177	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Toberín	2024	ENERO	Sysmex XP-300	11.4	fL	10.370	1,85
4	100178	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Castellana	2024	ENERO	Sysmex XP-300	11.6	fL	10.370	2,2
5	100180	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Héroes	2024	ENERO	Sysmex XP-300	11.6	fL	10.370	2,2
6	100181	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Teusaquillo	2024	ENERO	Sysmex XP-300	11.5	fL	10.370	2,03
7	100182	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Funza	2024	ENERO	Sysmex XP-300	11.4	fL	10.370	1,85
8	100183	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Puente Aranda	2024	ENERO	Sysmex XP-300	11.6	fL	10.370	2,2
9	100192	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Calle 82	2024	ENERO	Mindray BC-20S	11.4	fL	10.370	1,85
10	100193	Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá Sede Paseo del Rio	2024	ENERO	Sysmex XP-300	11.6	fL	10.370	2,2

<b>Satisfactorio</b> Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	<b>Alarma</b> Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	<b>No satisfactorio</b> Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

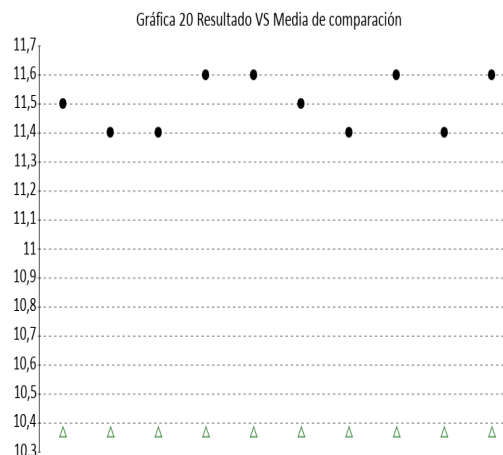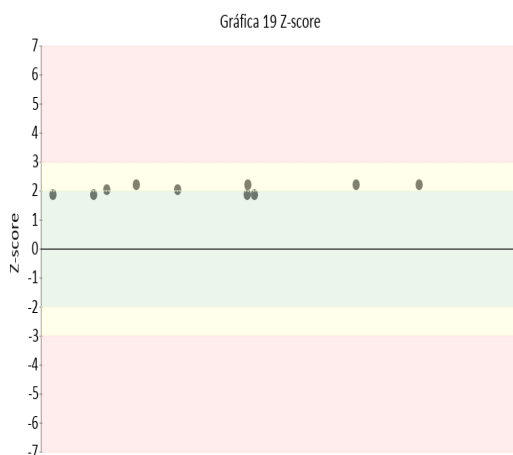

● Resultado    △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	4	6	0	10
Porcentaje	40%	60%	0%	100%