



## QAP-Infeciosas

### PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QAP-INF - Infecciosas

#### **CHRISTUS SINERGIA SEDE LAB SATELITE CLINICA FARALLONES**

Correo electrónico: [angelica.pardo@christus.co](mailto:angelica.pardo@christus.co)  
Dirección: Calle 9c #50-25 Laboratorio clínico Piso 2  
Ciudad: Cali Valle del Cauca  
País: Colombia  
Contacto: Angelica Paola Pardo  
Teléfono: 3105241863

#### **IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 100234**

Código de reporte: QAP-INF-100234-1-4  
Ronda: 1  
Muestra: 4  
Código de la muestra: IP4504  
Tipo de muestra: Líquido - Plasma humano  
Fecha generación: 27 / diciembre / 2024



**Quality Assurance Program**  
**PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO**  
**QAP-INF - Infecciosas**

Identificación Laboratorio:	100234
Ronda:	1
Muestra:	4
Código Muestra:	IP4504
Fecha reporte:	2024-12-10
Estado:	Evaluación original

### 1. TÉRMINOS GENERALES

#### Confidencialidad:

Quik SAS es una organización certificada bajo los estándares internacionales de la ISO 9001:2015 <sup>1</sup>, ISO 14001:2015 <sup>2</sup>, ISO 45001:2018 <sup>3</sup> y en cumplimiento al numeral 4.10 de ISO 17043:2010 <sup>4</sup>, garantiza la confidencialidad del presente reporte. La divulgación del presente informe se realizará únicamente al contacto autorizado por cada laboratorio. En caso de que la autoridad competente requiera información contenida en los reportes, será comunicado al participante involucrado con autorización expresa del mismo.

- (1) Sistema de gestión de calidad (SGC)
- (2) Sistema de gestión ambiental (SGA)
- (3) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- (4) Requisitos generales para los ensayos de aptitud

#### Homogeneidad y estabilidad:

Quik SAS certifica la homogeneidad y estabilidad suficiente de los ítems incluidos en los ensayos a través de una rigurosa selección de los materiales de cada programa, garantizando las condiciones adecuadas en la cadena de transporte y a través de verificaciones con métodos estadísticos. Los detalles de preparación y manejo del control se encuentran en el inserto de cada programa.

#### Subcontrataciones:

La planificación, el diseño estadístico, la operación y la generación de los informes son realizados por Quik SAS. Los materiales utilizados para los programas de laboratorio clínico son contratados con Bio-Rad Laboratories Inc. Los valores asignados de la sección 3 se obtienen de laboratorios clínicos con metodologías o materiales de referencia trazables al "Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine" (JCTLM).

#### Diseño de los programas QAP:

Los programas QAP LC están compuestos por rondas de acuerdo con la frecuencia establecida para cada programa. Las matrices utilizadas con conmutables con las muestras de las pacientes procesadas en la cotidianidad del laboratorio. El valor asignado se obtiene a partir de una comparación interlaboratorios a nivel internacional, el consenso QAP y/o un laboratorio con material o metodología de referencia trazable al JCTLM.

#### Para el análisis estadístico de los datos se realizan los siguientes cálculos:

##### Formula Desviación Estandar:

$$\text{Desviación estándar} = \frac{\sum(X_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

##### Formula Media:

$$\text{Media} = \frac{\sum \text{todos los datos}}{\text{Número de datos}}$$

##### Formula Zscore:

$$Z - \text{score} = \frac{\text{Resultado reportado por el laboratorio} - \bar{x} \text{ de consenso}}{D.E. \text{ del grupo consenso}}$$

##### Formula Incertidumbre:

$$U = \bar{x} \pm D.E * k$$



Quality Assurance Program  
 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO  
 QAP- INF Infecciosas

Identificación Laboratorio: 100234  
 Ronda: 1  
 Muestra: MX 4 IP4504  
 Fecha reporte: 06-12-2024  
 Estado: Evaluación original

## 2. Evaluación con media de comparación

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Not	Mensurando	Analizador	Método	Su resultado	X <sub>PT</sub>	Tipo de comparación	Desempeño	Evaluación
1		HIV	Roche Cobas 6000 (e601)	Electroquimioluminiscencia (ECL)	0.421 COI No Reactivo	No Reactivo	Inserto	Concordante	

Ítem	Mensurando	Cut off	Interpretación*
1	HIV	<1,0	No Reactivo

Puntaje	1 / 1
% Concordancia	100%

<p><b>Concordante:</b> El resultado de su laboratorio es igual a la referencia.</p>	<p><b>No concordante:</b> El resultado de su laboratorio es diferente a la referencia.</p>	 Resultado tardío	 Resultado ausente	 Resultado revalorado
---	--	----------------------	-----------------------	--------------------------



Quality Assurance Program  
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO  
QAP- INF Infecciosas

Identificación Laboratorio: 100234  
Ronda: 1  
Muestra: MX 4 IP4504  
Fecha reporte: 06-12-2024  
Evaluación original  
Estado:

### 3. Comparación Inter laboratorios; Consenso QAP y V.A.V

Mensurando: HIV

Resultado Laboratorio: 0.421 COI

Analizador: Roche Cobas 6000 E411

Posibles resultados	Consenso QAP	VAV	Resultado del laboratorio	Valoración
No reactivo	X	X	0.421 COI	Concordante
Reactivo				
Laboratorios	2	N. A	N. A	

### 4. Resumen de ronda

Ronda 1 – Muestra 4

Posibles Resultados	Analitos
	HIV
No reactivo	X
Reactivo	

**Convenciones:**



Consenso QAP



Valor Asignado como Verdadero




Valor Reportado por el Laboratorio



Quality Assurance Program  
 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO EXTERNO  
 QAP- INF Infecciosas

Identificación Laboratorio: 100234  
 Ronda: 1  
 Muestra: MX 4 IP4504  
 Fecha reporte: 06-12-2024  
 Estado: Evaluación original

**5. Indicadores de competencia técnica**

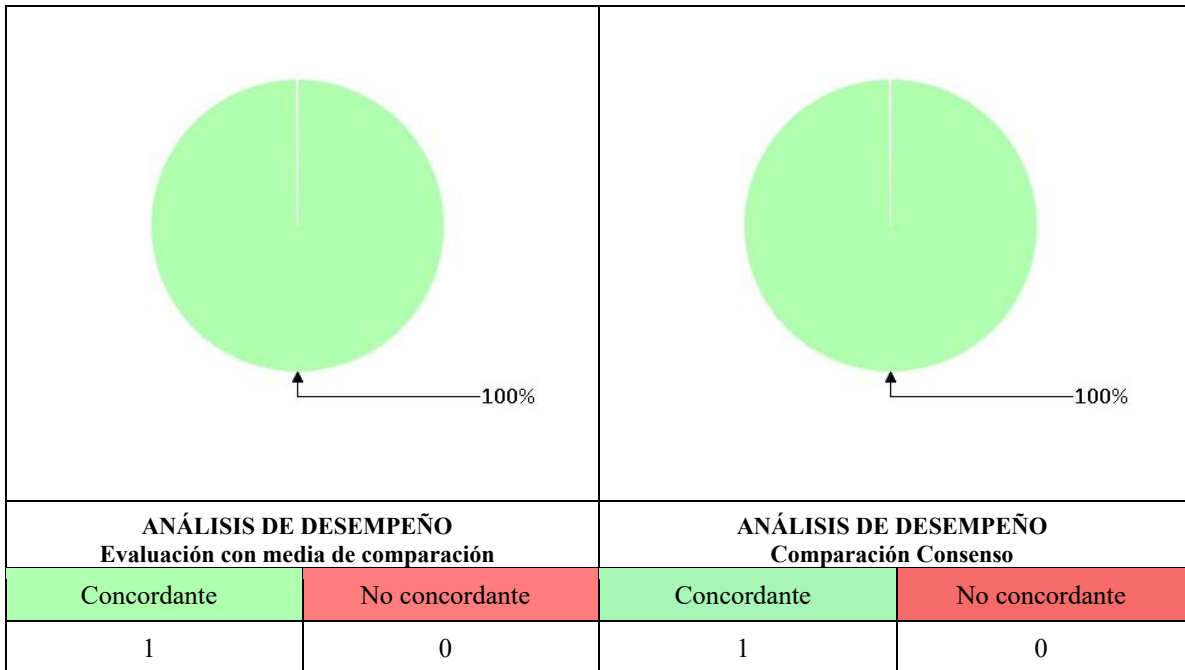

Observaciones:	Revisado por:
	Fecha:

-- Final de reporte

-Aprobado por  
 Coordinador programas QAP

**Coordinador QAP:**  
 Maria Paula Mora Gamboa  
 Contacto: 3174399931  
 Correo: maria.mora@quik.com.co