



Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-H-Hematología
Código de muestra: DS1224
Ronda: 43
Muestra: 4
Febrero 2025
Ciudad : Bogotá Distrito Capital

100206 - SIES Salud
100221 - SIES Salud RA


Maria Paula Mora E.

Analito : Ancho de distribución del eritrocito


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	15.8	%	18.230	-1,91
2	100221	SIES Salud RA	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	15.8	%	18.230	-1,91

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 1 Z-score

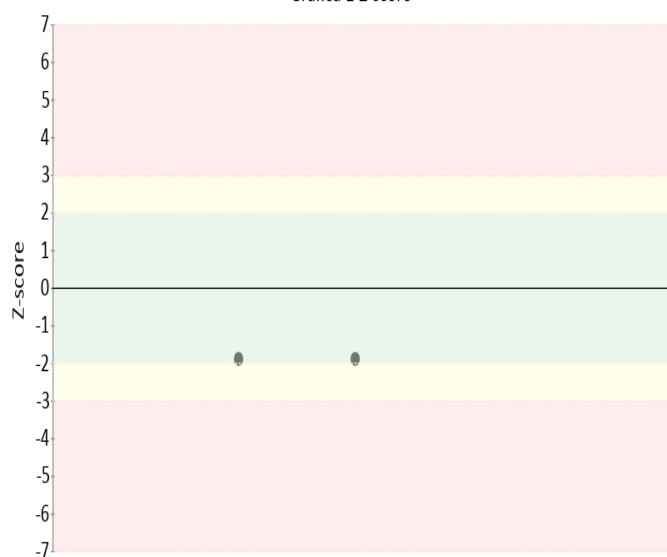

Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación

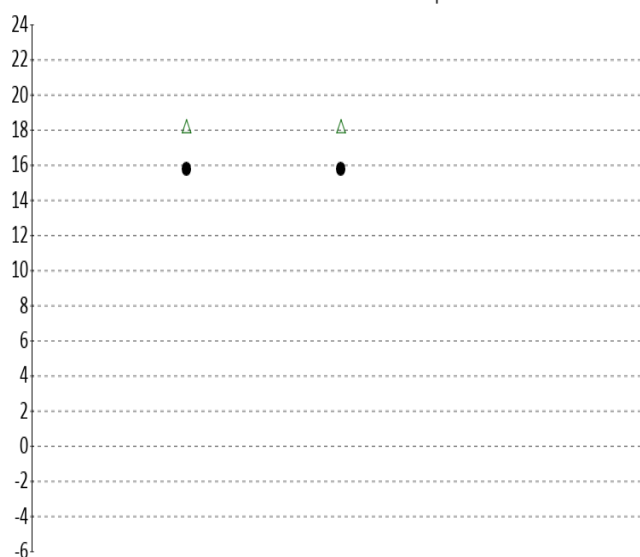

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Concentración de hemoglobina corpuscular media


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	45.5	g/dL	32.940	5,09
2	100221	SIES Salud RA	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	46.0	g/dL	32.940	5,29

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 3 Z-score

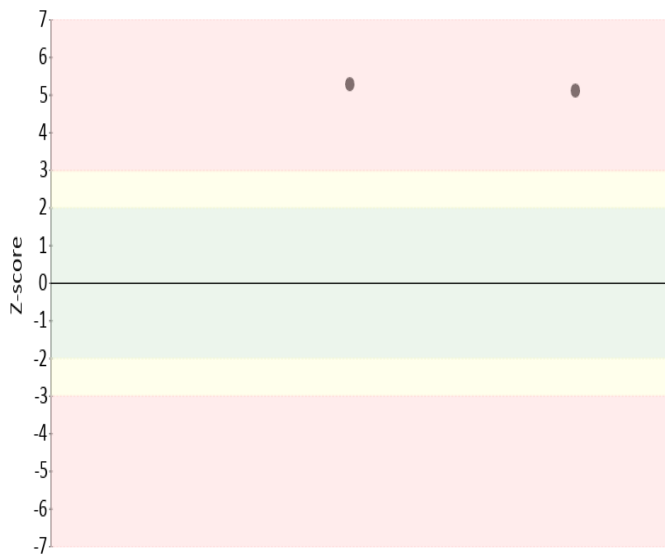

Gráfica 4 Resultado VS Media de comparación

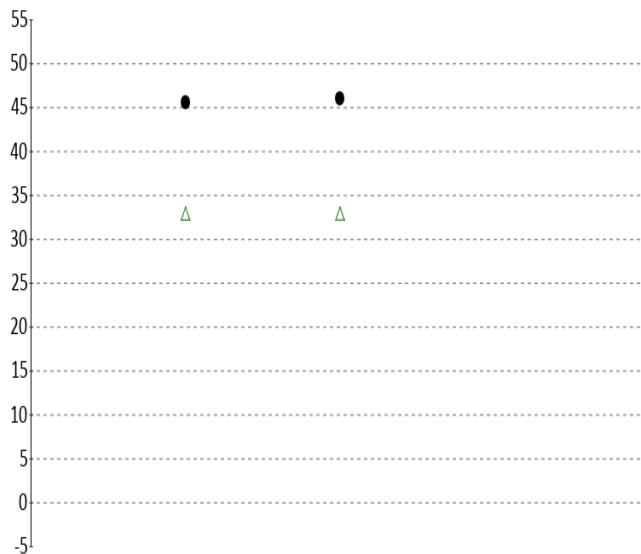

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	0	2	2
Porcentaje	0%	0%	100%	100%

Analito : Hematocrito


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	13.5	%	17.750	-5,04
2	100221	SIES Salud RA	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	13.4	%	17.750	-5,16

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 5 Z-score

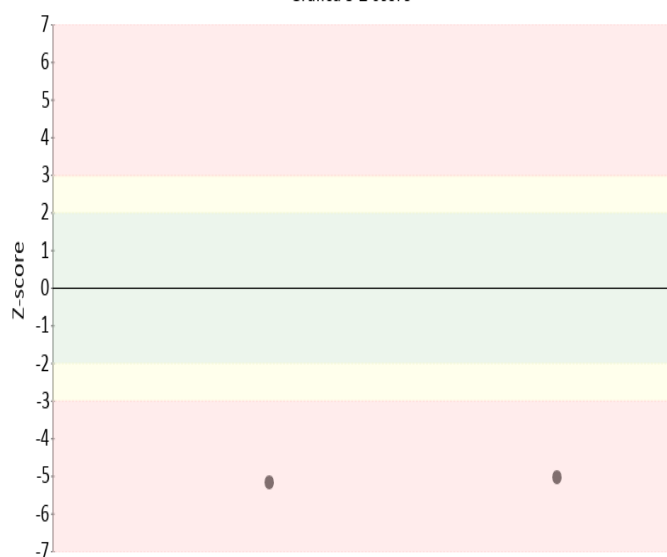

Gráfica 6 Resultado VS Media de comparación

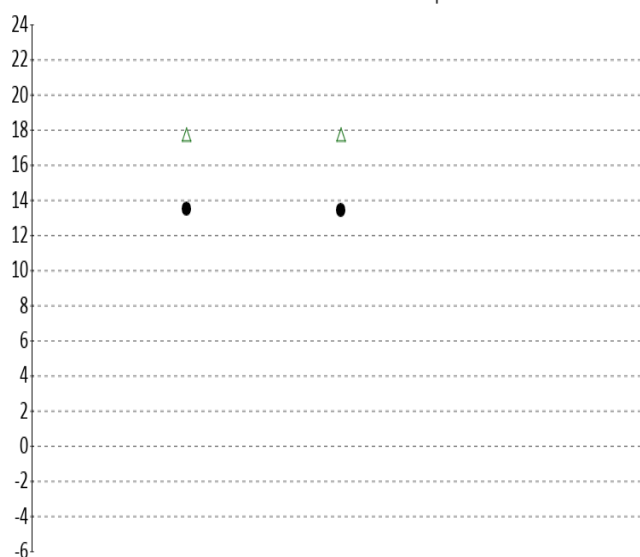

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	0	2	2
Porcentaje	0%	0%	100%	100%

Analito : Hemoglobina


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	6.15	g/dL	5.93	1,29
2	100221	SIES Salud RA	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	6.17	g/dL	5.93	1,41

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 7 Z-score

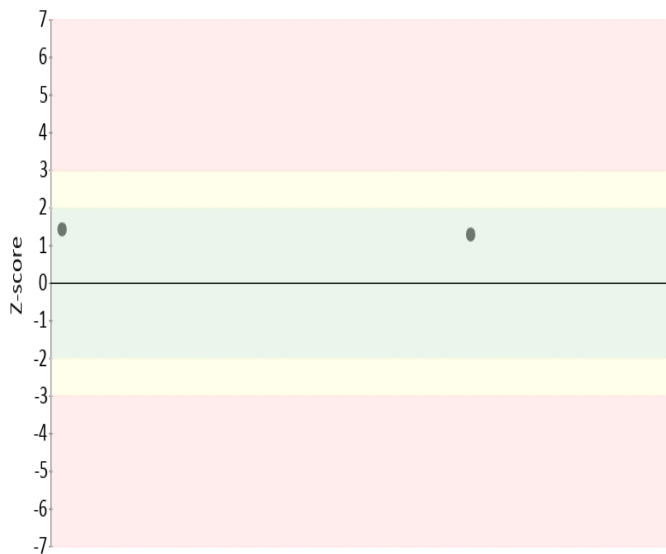

Gráfica 8 Resultado VS Media de comparación

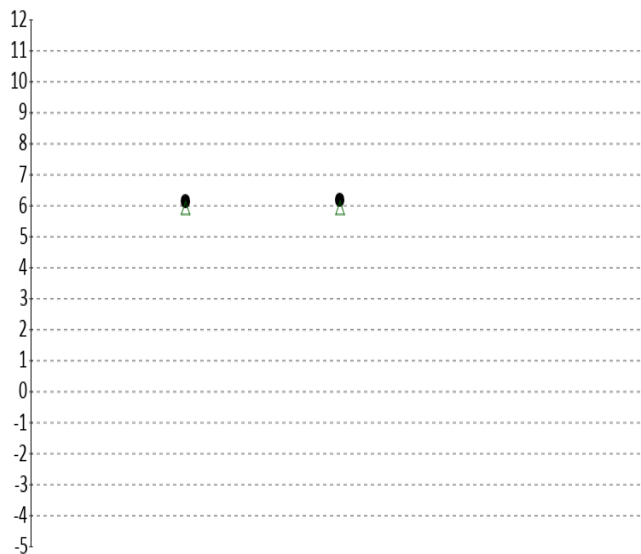

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Hemoglobina corpuscular media


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	28.5	pg/cell	25.890	3,01
2	100221	SIES Salud RA	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	28.8	pg/cell	25.890	3,36

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 9 Z-score

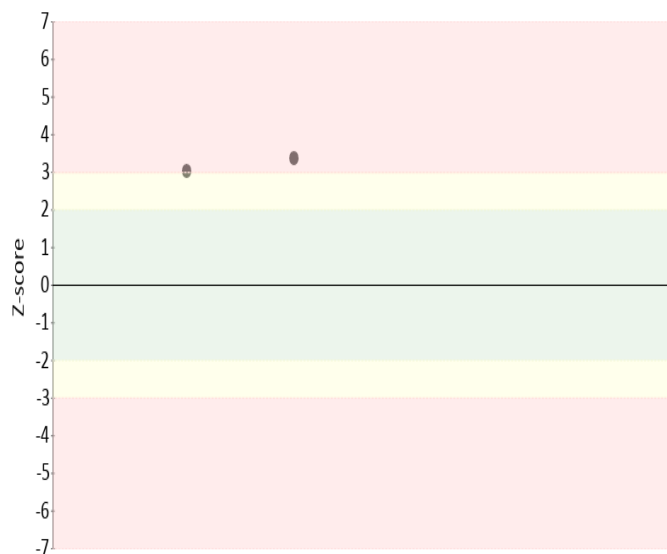

Gráfica 10 Resultado VS Media de comparación

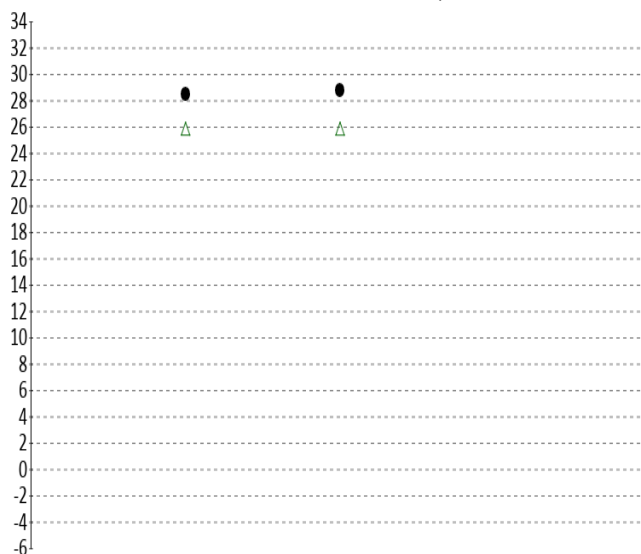

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	0	2	2
Porcentaje	0%	0%	100%	100%

Analito : Recuento de glóbulos blancos


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	0.086	K/uL	3.07	-12,97
2	100221	SIES Salud RA	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	0.074	K/uL	3.07	-13,03

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 11 Z-score

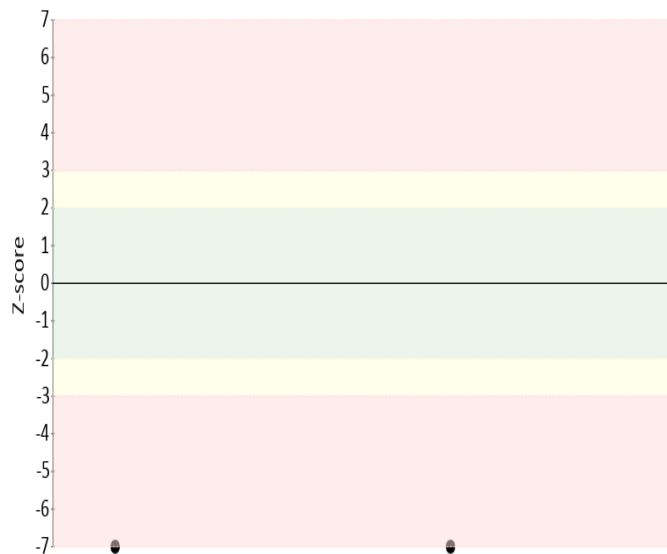

Gráfica 12 Resultado VS Media de comparación

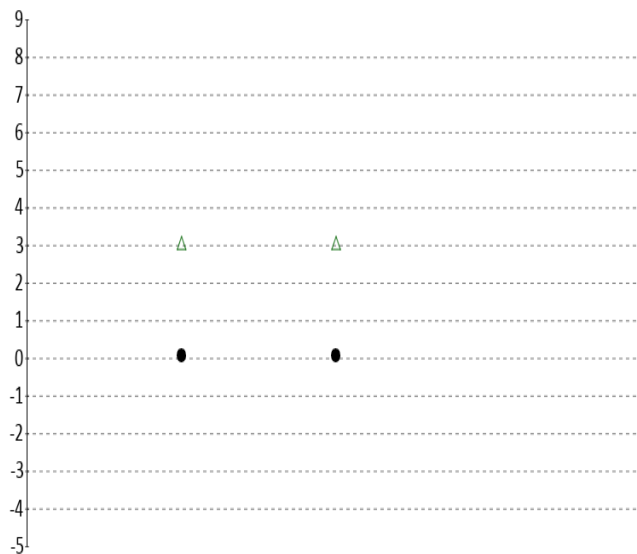

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	0	2	2
Porcentaje	0%	0%	100%	100%

Analito : Recuento de glóbulos rojos

IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	2.16	M/uL	2.31	-1,67
2	100221	SIES Salud RA	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	2.14	M/uL	2.31	-1,89

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 13 Z-score

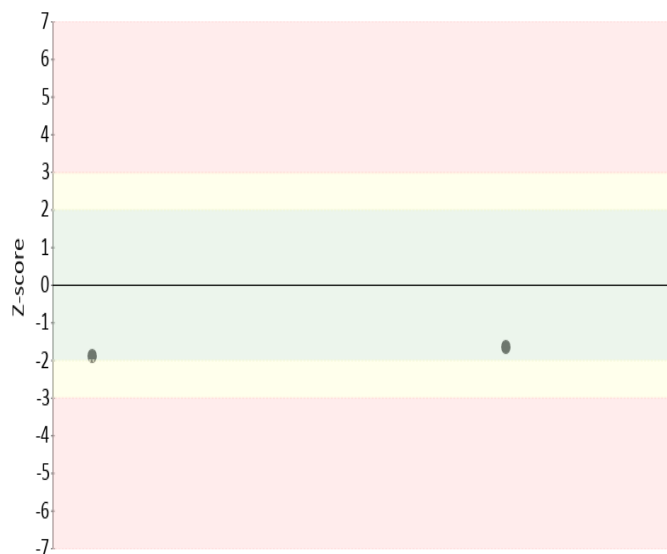

Gráfica 14 Resultado VS Media de comparación



● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Recuento de plaquetas


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	39.0	K/uL	41.44	-0,72
2	100221	SIES Salud RA	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	37.9	K/uL	41.44	-1,04

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 15 Z-score

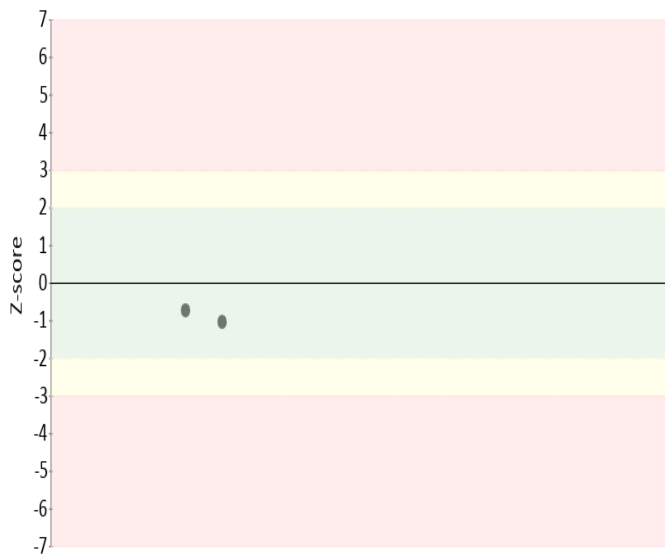

Gráfica 16 Resultado VS Media de comparación

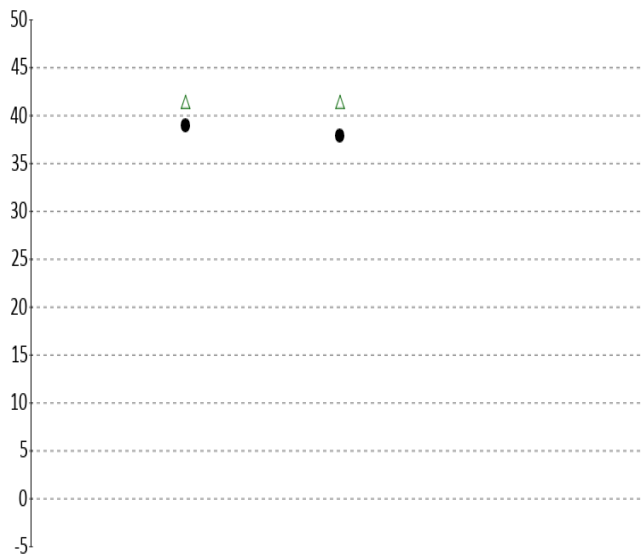

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	2	0	0	2
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Volumen corpuscular medio


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	62.6	fL	79	-6,31
2	100221	SIES Salud RA	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	62.6	fL	79	-6,31

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 17 Z-score

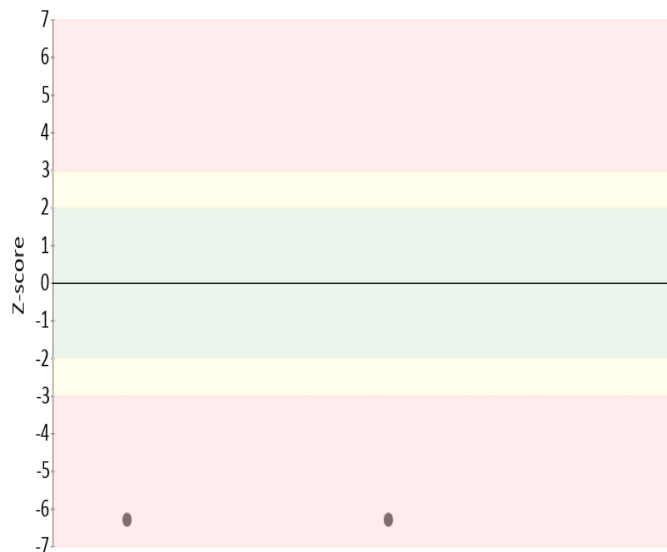

Gráfica 18 Resultado VS Media de comparación

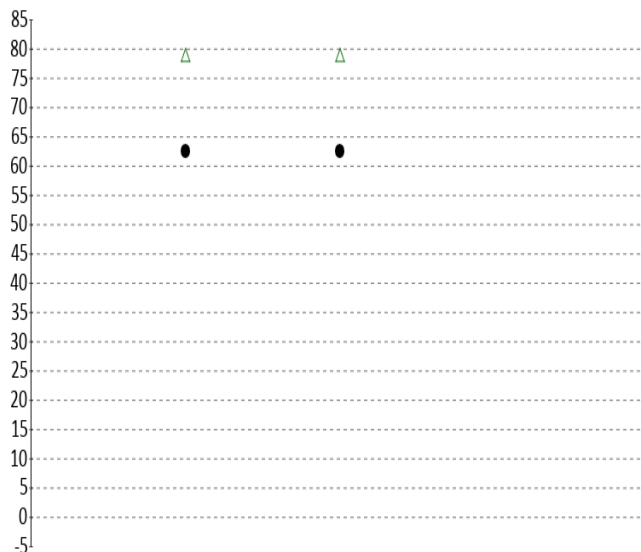

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	0	2	2
Porcentaje	0%	0%	100%	100%

Analito : Volumen plaquetario medio


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100206	SIES Salud	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	7.24	fL	11.17	-11,23
2	100221	SIES Salud RA	2025	FEBRERO	Abbott Alinity H	7.25	fL	11.17	-11,2

Satisfactorio Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
---	---	---

Gráfica 19 Z-score

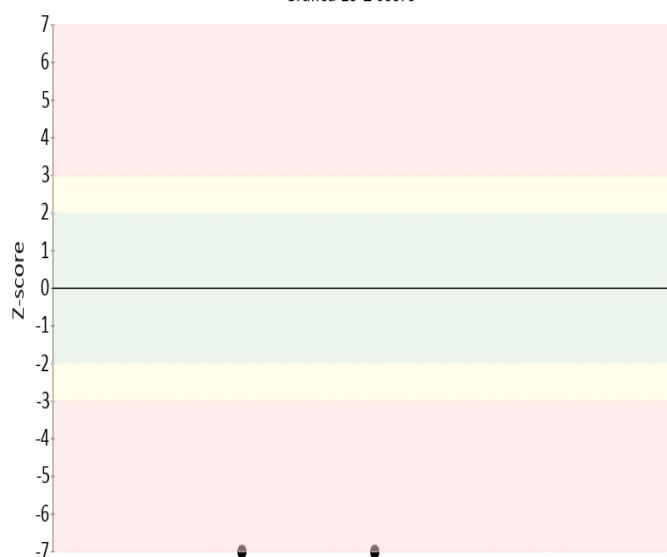

Gráfica 20 Resultado VS Media de comparación

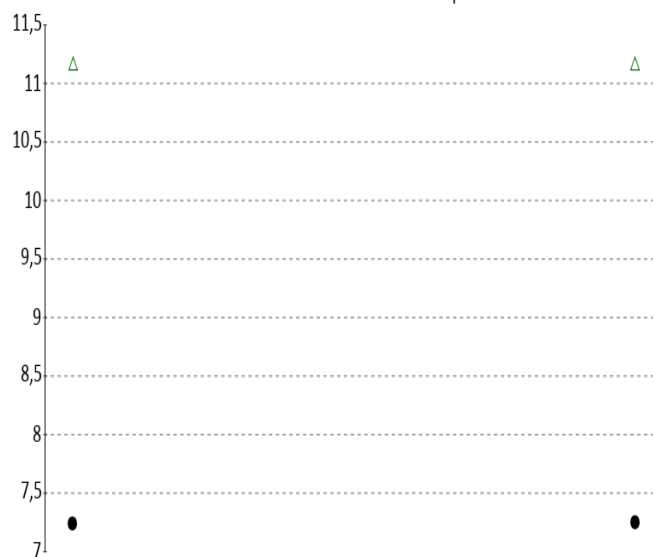

● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	0	0	2	2
Porcentaje	0%	0%	100%	100%