



Reporte Subgrupo
Programa de aseguramiento de la calidad
QAP-C-Coagulación
Código de muestra: FJ0225
Ronda: 48
Muestra: 5
Enero 2025
Ciudad : Cali Valle del Cauca, Medellín Antioquia


100233 - Christus Sinergia sede Gran vía Medellín
100234 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Farallones
100235 - Christus Sinergia sede Lab Satelite Clinica Palma Real

Analito : Fibrinógeno


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100234	Christus Sinergia sede Lab Satellite Clinica Farallones	2025	ENERO	ACL ELITE PRO	153	mg/dL	151.100	0,16

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 1 Z-score

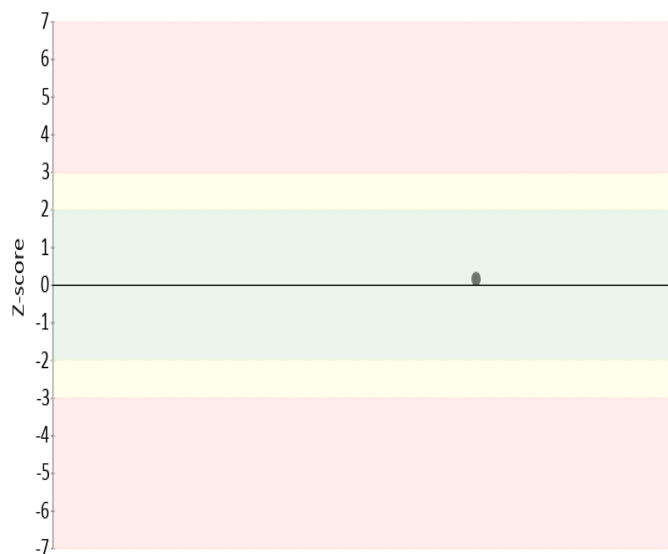

Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación

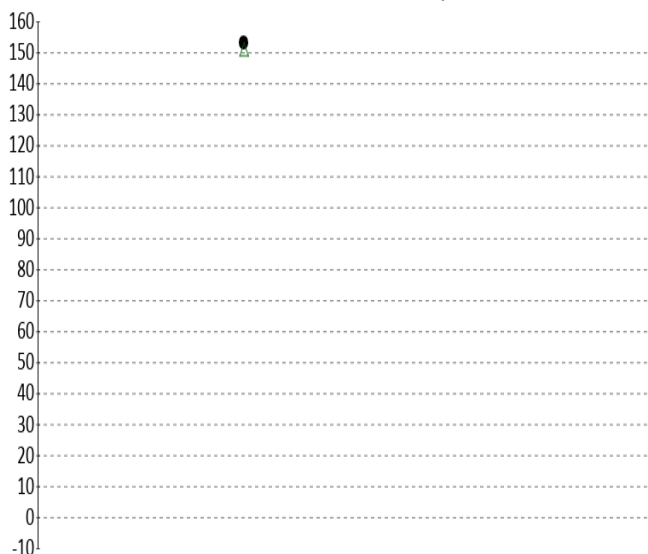

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	1	0	0	1
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Tiempo de protombina PT


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	2025	ENERO	ACL ELITE PRO	28.9	Seconds	30.250	-0,92
2	100234	Christus Sinergia sede Lab Satellite Clinica Farallones	2025	ENERO	ACL ELITE PRO	29.1	Seconds	30.250	-0,78
3	100235	Christus Sinergia sede Lab Satellite Clinica Palma Real	2025	ENERO	ACL ELITE PRO	29.4	Seconds	30.250	-0,58

Satisfactorio Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
--	---	---

Gráfica 3 Z-score

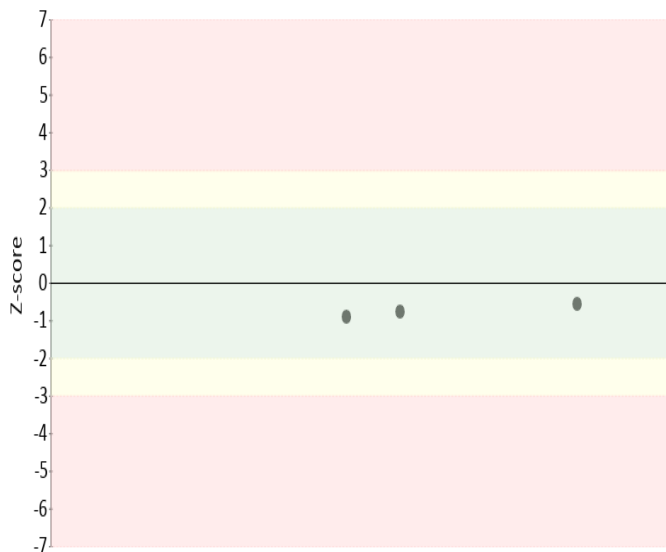

Gráfica 4 Resultado VS Media de comparación

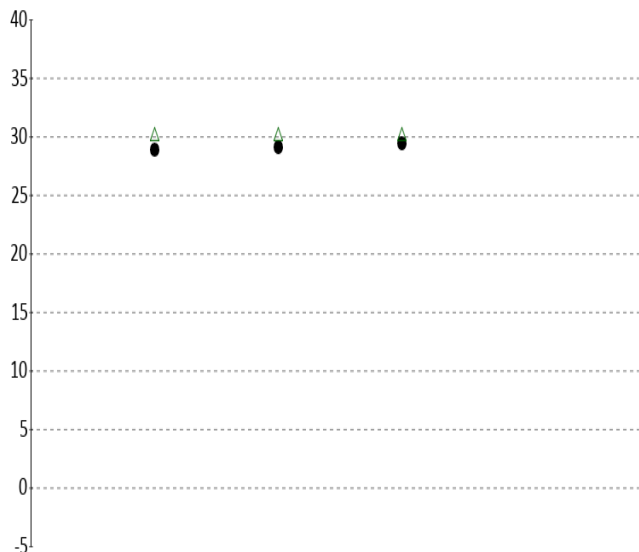

● Resultado △ Media de comparación


valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	3	0	0	3
Porcentaje	100%	0%	0%	100%

Analito : Tiempo parcial de tromboplastina tisular PTT


IT	# laboratorio	Sede	año	mes	instrumento	resultado	unidad	Media de comparación	Zscore
1	100233	Christus Sinergia sede Gran vía Medellín	2025	ENERO	ACL ELITE PRO	62.0	Seconds	65.450	-1,11
2	100234	Christus Sinergia sede Lab Satellite Clinica Farallones	2025	ENERO	ACL ELITE PRO	60.6	Seconds	65.450	-1,56
3	100235	Christus Sinergia sede Lab Satellite Clinica Palma Real	2025	ENERO	ACL ELITE PRO	61.2	Seconds	65.450	-1,37

Satisfactorio Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score	Alarma Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score	No satisfactorio Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score
---	---	---

Gráfica 5 Z-score

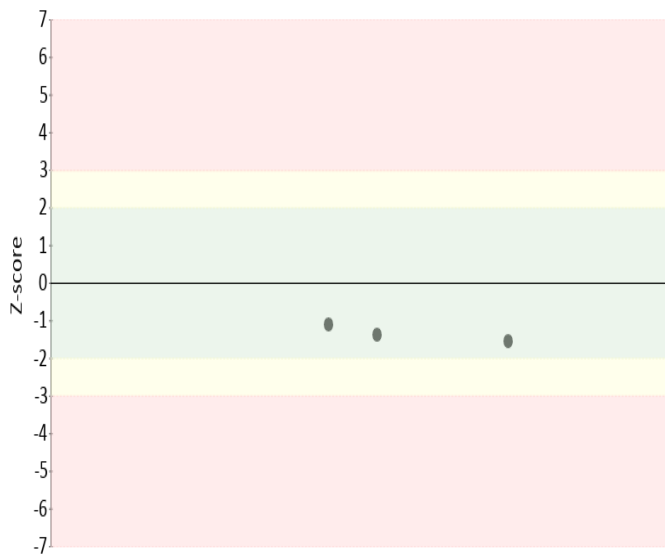

Gráfica 6 Resultado VS Media de comparación

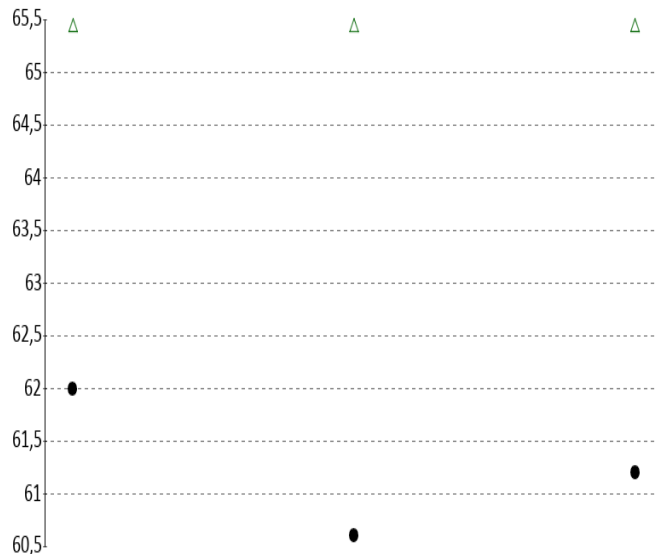

● Resultado △ Media de comparación

valor	entre +/- 2	entre +/- 2 y +/- 3	mayor +/- 3	Total
Valoración Z-score por sede	3	0	0	3
Porcentaje	100%	0%	0%	100%