



Programa de Aseguramiento de la Calidad Analítica

Reporte Subgrupo  
Programa de aseguramiento de la calidad  
QAP-H-Hematología  
Código de muestra: DS1224  
Ronda: 45  
Muestra: 2  
Febrero 2025  
Ciudad : Medellín Antioquia

**100107 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín**  
**100172 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace**  
**100173 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin**  
**100174 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito**  
**100175 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itagüí**  
**100199 - Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Mayorca**


*Mario Taura Mora E.*

**Analito :** Ancho de distribución del eritrocito


| IT | # laboratorio | Sede  | año  | mes     | instrumento    | resultado | unidad | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|---|------|---------|----------------|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1  | 100107        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín             | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 17.2      | %      | 18.230               | -0,81  |
| 2  | 100172        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 17.5      | %      | 18.230               | -0,57  |
| 3  | 100173        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 17.7      | %      | 18.230               | -0,42  |
| 4  | 100174        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 17.9      | %      | 18.230               | -0,26  |
| 5  | 100175        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itagüí       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 17.2      | %      | 18.230               | -0,81  |
| 6  | 100199        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Mayorca     | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 17.8      | %      | 18.230               | -0,34  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Satisfactorio</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score | <b>Alarma</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | <b>No satisfactorio</b><br>Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|--|---|---|

Gráfica 1 Z-score

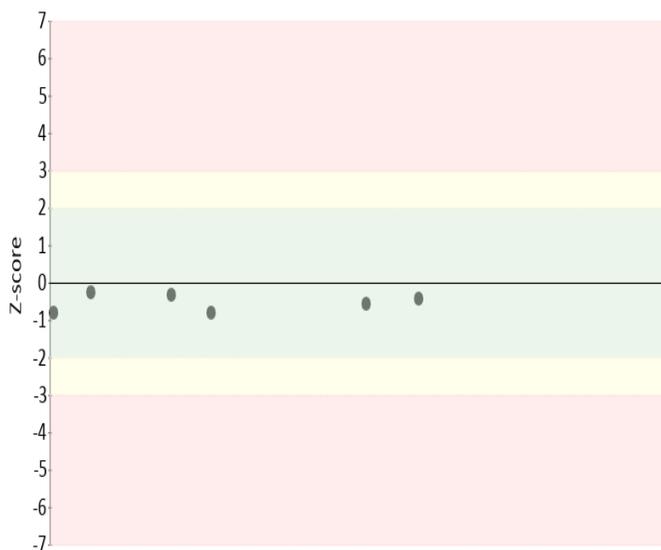

Gráfica 2 Resultado VS Media de comparación

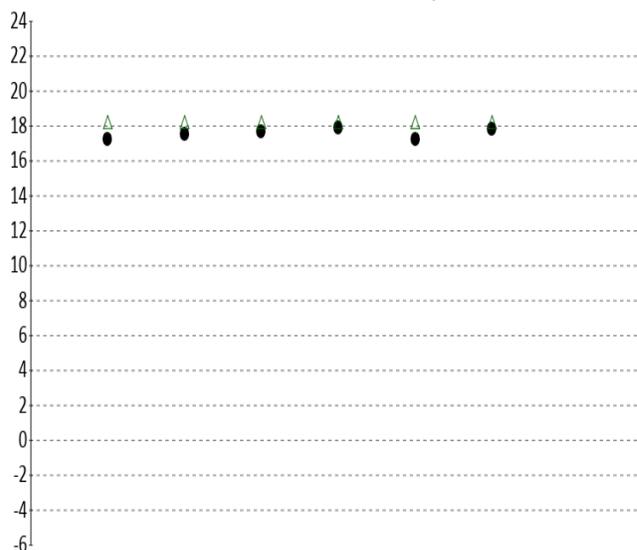

● Resultado    △ Media de comparación


| valor                       | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 6           | 0                   | 0           | 6     |
| Porcentaje                  | 100%        | 0%                  | 0%          | 100%  |

**Analito :** Concentración de hemoglobina corpuscular media


| IT | # laboratorio | Sede  | año  | mes     | instrumento    | resultado | unidad | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|---|------|---------|----------------|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1  | 100107        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín             | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 31.4      | g/dL   | 32.940               | -0,62  |
| 2  | 100172        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 32.2      | g/dL   | 32.940               | -0,3   |
| 3  | 100173        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 30.7      | g/dL   | 32.940               | -0,91  |
| 4  | 100174        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 31.5      | g/dL   | 32.940               | -0,58  |
| 5  | 100175        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itagüí       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 32.3      | g/dL   | 32.940               | -0,26  |
| 6  | 100199        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Mayorca     | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 30.4      | g/dL   | 32.940               | -1,03  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Satisfactorio</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score | <b>Alarma</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | <b>No satisfactorio</b><br>Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|--|---|---|

Gráfica 3 Z-score

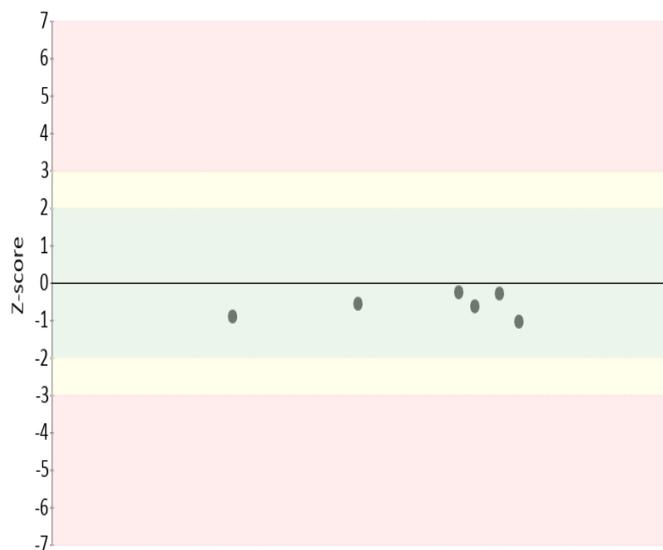

Gráfica 4 Resultado VS Media de comparación

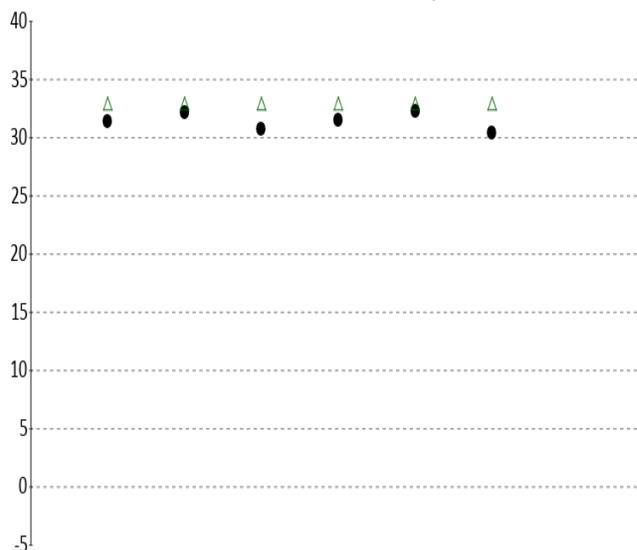

● Resultado    △ Media de comparación


| valor                       | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 6           | 0                   | 0           | 6     |
| Porcentaje                  | 100%        | 0%                  | 0%          | 100%  |

**Analito :** Hematocrito


| IT | # laboratorio | Sede  | año  | mes     | instrumento    | resultado | unidad | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|---|------|---------|----------------|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1  | 100107        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín             | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 18.8      | %      | 17.750               | 1,25   |
| 2  | 100172        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 18.6      | %      | 17.750               | 1,01   |
| 3  | 100173        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 19.1      | %      | 17.750               | 1,6    |
| 4  | 100174        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 18.5      | %      | 17.750               | 0,89   |
| 5  | 100175        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itaguí       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 17.9      | %      | 17.750               | 0,18   |
| 6  | 100199        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Mayorca     | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 19.3      | %      | 17.750               | 1,84   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Satisfactorio</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score | <b>Alarma</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | <b>No satisfactorio</b><br>Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|--|---|---|

Gráfica 5 Z-score

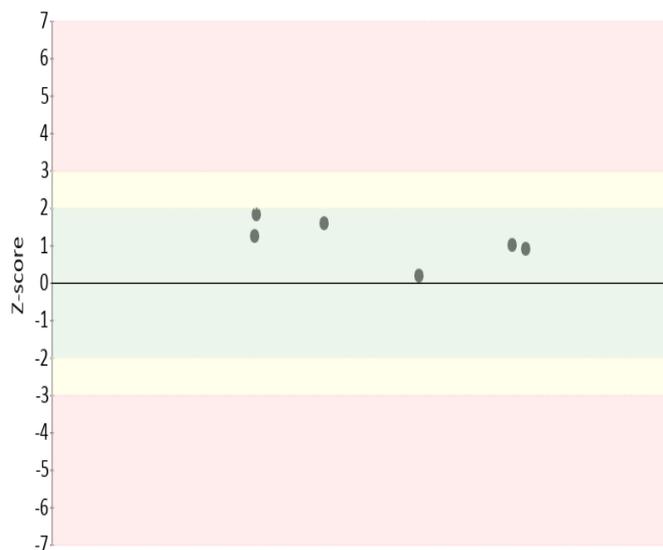

Gráfica 6 Resultado VS Media de comparación

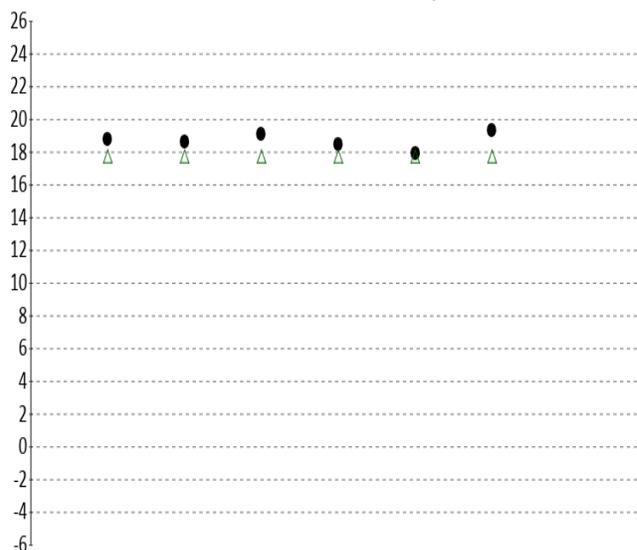

● Resultado    △ Media de comparación


| valor                       | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 6           | 0                   | 0           | 6     |
| Porcentaje                  | 100%        | 0%                  | 0%          | 100%  |

**Analito :** Hemoglobina


| IT | # laboratorio | Sede  | año  | mes     | instrumento    | resultado | unidad | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|---|------|---------|----------------|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1  | 100107        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín             | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 5.9       | g/dL   | 5.93                 | -0,18  |
| 2  | 100172        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 6.0       | g/dL   | 5.93                 | 0,41   |
| 3  | 100173        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 5.8       | g/dL   | 5.93                 | -0,76  |
| 4  | 100174        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 5.8       | g/dL   | 5.93                 | -0,76  |
| 5  | 100175        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itagüí       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 5.8       | g/dL   | 5.93                 | -0,76  |
| 6  | 100199        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Mayorca     | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 5.9       | g/dL   | 5.93                 | -0,18  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Satisfactorio</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score | <b>Alarma</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | <b>No satisfactorio</b><br>Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|--|---|---|

Gráfica 7 Z-score

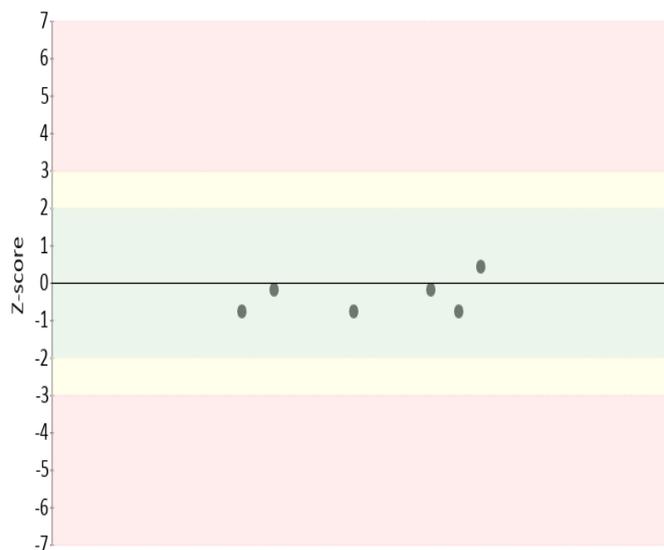

Gráfica 8 Resultado VS Media de comparación

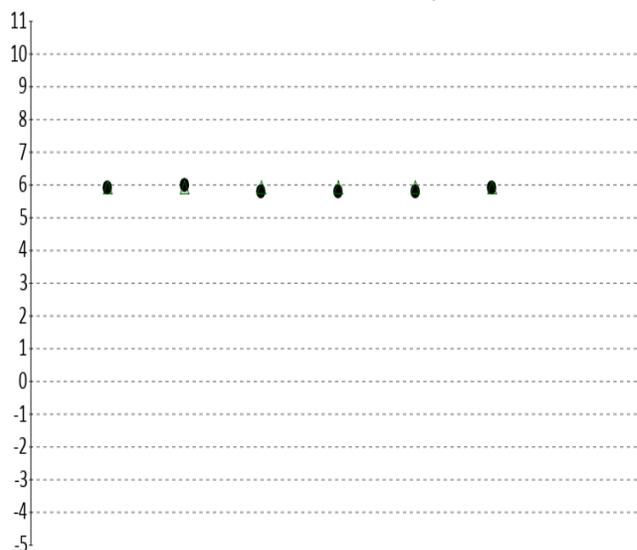

● Resultado    △ Media de comparación


| valor                       | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 6           | 0                   | 0           | 6     |
| Porcentaje                  | 100%        | 0%                  | 0%          | 100%  |

**Analito :** Hemoglobina corpuscular media


| IT | # laboratorio | Sede  | año  | mes     | instrumento    | resultado | unidad  | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|---|------|---------|----------------|-----------|---------|----------------------|--------|
| 1  | 100107        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín             | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 25.1      | pg/cell | 25.890               | -0,91  |
| 2  | 100172        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 25.8      | pg/cell | 25.890               | -0,1   |
| 3  | 100173        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 24.4      | pg/cell | 25.890               | -1,72  |
| 4  | 100174        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 25.2      | pg/cell | 25.890               | -0,8   |
| 5  | 100175        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itagüí       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 25.4      | pg/cell | 25.890               | -0,57  |
| 6  | 100199        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Mayorca     | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 24.2      | pg/cell | 25.890               | -1,95  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Satisfactorio</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score | <b>Alarma</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | <b>No satisfactorio</b><br>Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|--|---|---|

Gráfica 9 Z-score

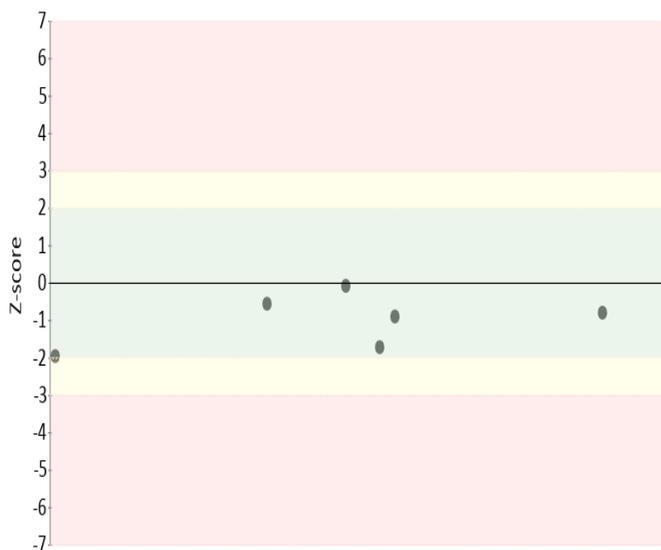

Gráfica 10 Resultado VS Media de comparación

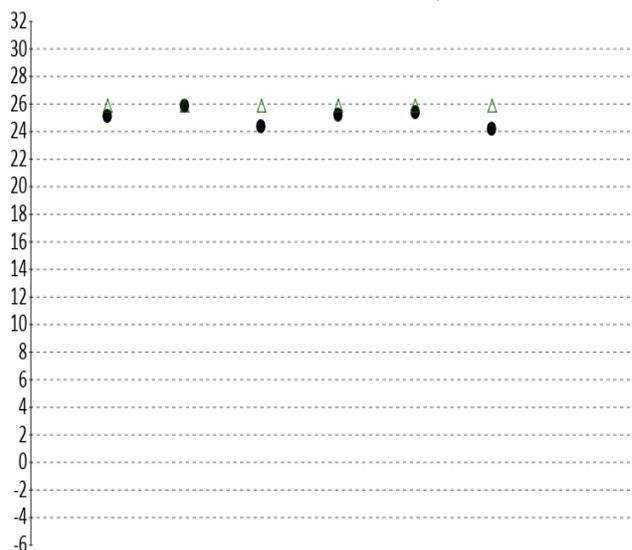

● Resultado    △ Media de comparación


| valor                       | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 6           | 0                   | 0           | 6     |
| Porcentaje                  | 100%        | 0%                  | 0%          | 100%  |

**Analito :** PDW (Ancho de distribución de plaquetas)


| IT | # laboratorio | Sede   | año  | mes     | instrumento    | resultado | unidad | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|--|------|---------|----------------|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1  | 100174        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín<br>sede Patio Bonito | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 14.9      | %      | 15.23                | -0,22  |
| 2  | 100175        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín<br>sede Itaguí       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 14.2      | %      | 15.23                | -0,7   |
| 3  | 100199        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín<br>sede Mayorca     | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 14.4      | %      | 15.23                | -0,56  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Satisfactorio</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score | <b>Alarma</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | <b>No satisfactorio</b><br>Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|--|---|---|

Gráfica 11 Z-score

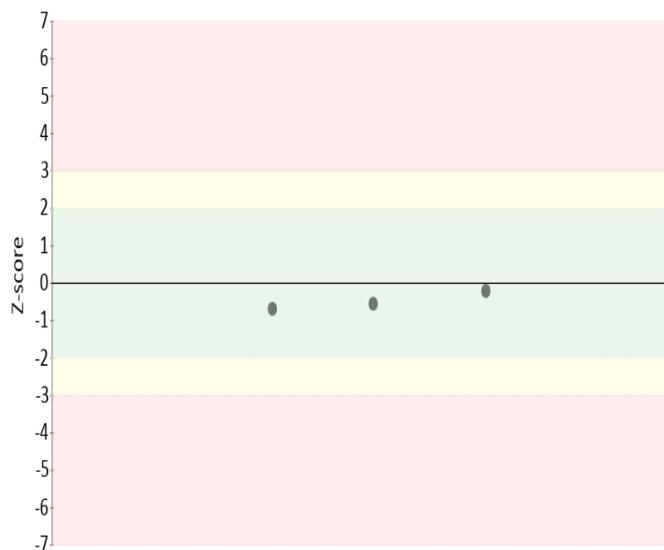

Gráfica 12 Resultado VS Media de comparación

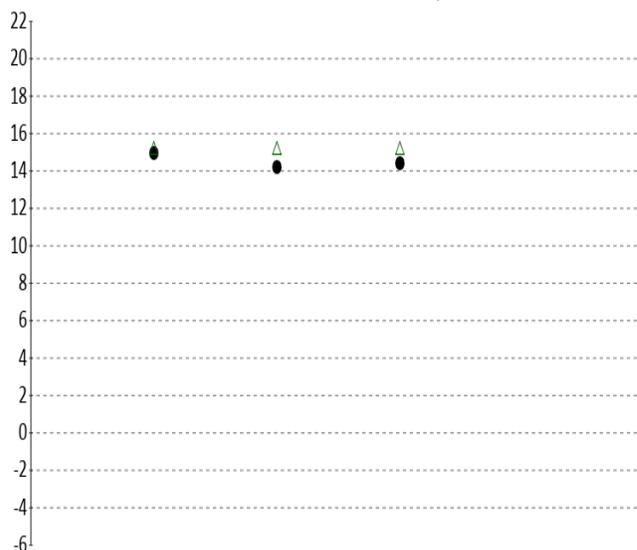

● Resultado    △ Media de comparación


| valor                       | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 3           | 0                   | 0           | 3     |
| Porcentaje                  | 100%        | 0%                  | 0%          | 100%  |

**Analito :** Recuento de glóbulos blancos


| IT | # laboratorio | Sede  | año  | mes     | instrumento    | resultado | unidad | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|---|------|---------|----------------|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1  | 100107        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín             | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 3.0       | K/uL   | 3.040                | -0.2   |
| 2  | 100172        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 3.1       | K/uL   | 3.040                | 0.3    |
| 3  | 100173        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 3.0       | K/uL   | 3.040                | -0.2   |
| 4  | 100174        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 3.0       | K/uL   | 3.040                | -0.2   |
| 5  | 100175        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itagüí       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 2.9       | K/uL   | 3.040                | -0.69  |
| 6  | 100199        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Mayorca     | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 3.0       | K/uL   | 3.040                | -0.2   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Satisfactorio</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score | <b>Alarma</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | <b>No satisfactorio</b><br>Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|--|---|---|

Gráfica 13 Z-score

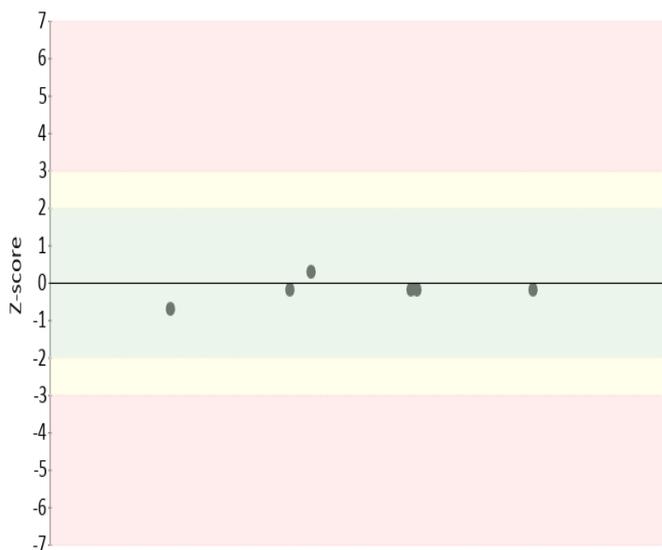

Gráfica 14 Resultado VS Media de comparación

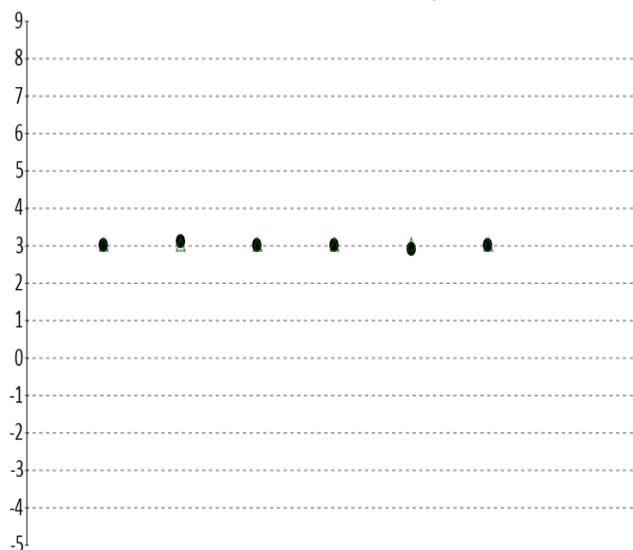

● Resultado    △ Media de comparación


| valor                       | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 6           | 0                   | 0           | 6     |
| Porcentaje                  | 100%        | 0%                  | 0%          | 100%  |

**Analito :** Recuento de glóbulos rojos


| IT | # laboratorio | Sede  | año  | mes     | instrumento    | resultado | unidad | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|---|------|---------|----------------|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1  | 100107        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín             | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 2.35      | M/uL   | 2.300                | 0,57   |
| 2  | 100172        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 2.32      | M/uL   | 2.300                | 0,23   |
| 3  | 100173        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 2.40      | M/uL   | 2.300                | 1,14   |
| 4  | 100174        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 2.31      | M/uL   | 2.300                | 0,11   |
| 5  | 100175        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itagüí       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 2.27      | M/uL   | 2.300                | -0,34  |
| 6  | 100199        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Mayorca     | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 2.42      | M/uL   | 2.300                | 1,36   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Satisfactorio</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score | <b>Alarma</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | <b>No satisfactorio</b><br>Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|--|---|---|

Gráfica 15 Z-score

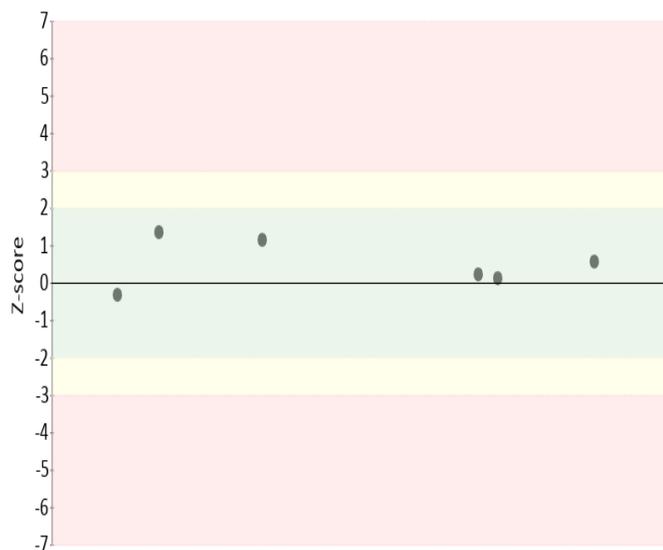

Gráfica 16 Resultado VS Media de comparación

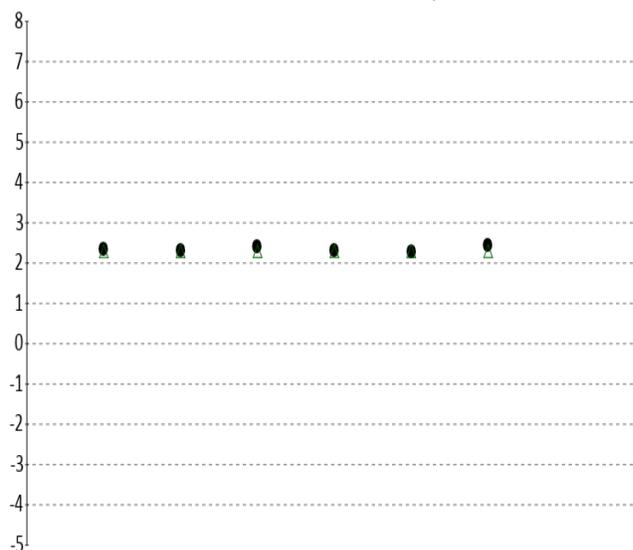

● Resultado    △ Media de comparación


| valor                       | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 6           | 0                   | 0           | 6     |
| Porcentaje                  | 100%        | 0%                  | 0%          | 100%  |

**Analito :** Recuento de plaquetas


| IT | # laboratorio | Sede  | año  | mes     | instrumento    | resultado | unidad | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|---|------|---------|----------------|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1  | 100107        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín             | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 42        | K/uL   | 41.44                | 0,16   |
| 2  | 100172        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 41        | K/uL   | 41.44                | -0,13  |
| 3  | 100173        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 39        | K/uL   | 41.44                | -0,72  |
| 4  | 100174        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 37        | K/uL   | 41.44                | -1,3   |
| 5  | 100175        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itagüí       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 37        | K/uL   | 41.44                | -1,3   |
| 6  | 100199        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Mayorca     | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 42        | K/uL   | 41.44                | 0,16   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Satisfactorio</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score | <b>Alarma</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | <b>No satisfactorio</b><br>Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|--|---|---|

Gráfica 17 Z-score

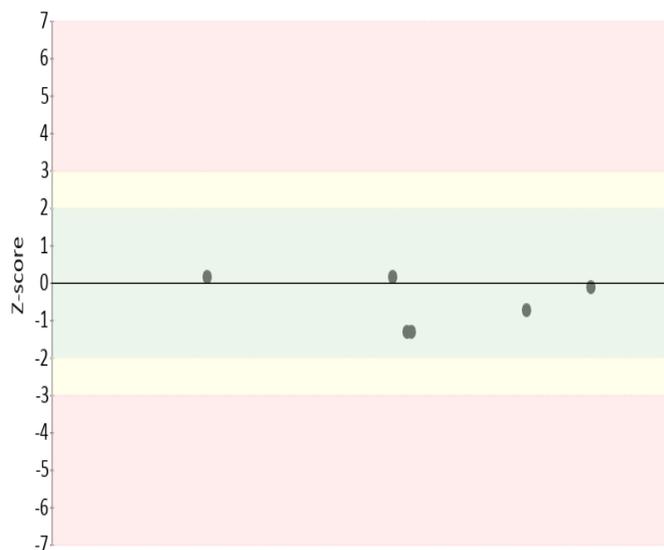

Gráfica 18 Resultado VS Media de comparación

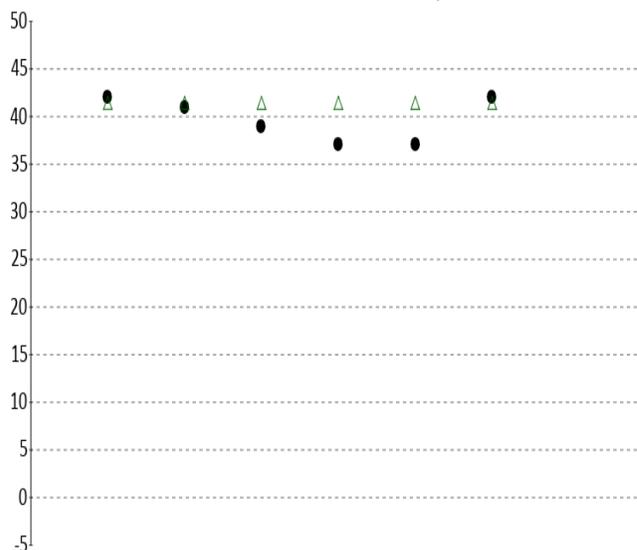

● Resultado    △ Media de comparación


| valor                       | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 6           | 0                   | 0           | 6     |
| Porcentaje                  | 100%        | 0%                  | 0%          | 100%  |

**Analito :** Volumen corpuscular medio


| IT | # laboratorio | Sede  | año  | mes     | instrumento    | resultado | unidad | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|---|------|---------|----------------|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1  | 100107        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín             | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 80.1      | fL     | 79                   | 0,42   |
| 2  | 100172        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 80.0      | fL     | 79                   | 0,38   |
| 3  | 100173        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 79.4      | fL     | 79                   | 0,15   |
| 4  | 100174        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 80.1      | fL     | 79                   | 0,42   |
| 5  | 100175        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itaguí       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 79.9      | fL     | 79                   | 0,35   |
| 6  | 100199        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Mayorca     | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 79.8      | fL     | 79                   | 0,31   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Satisfactorio</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score | <b>Alarma</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | <b>No satisfactorio</b><br>Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|--|---|---|

Gráfica 19 Z-score

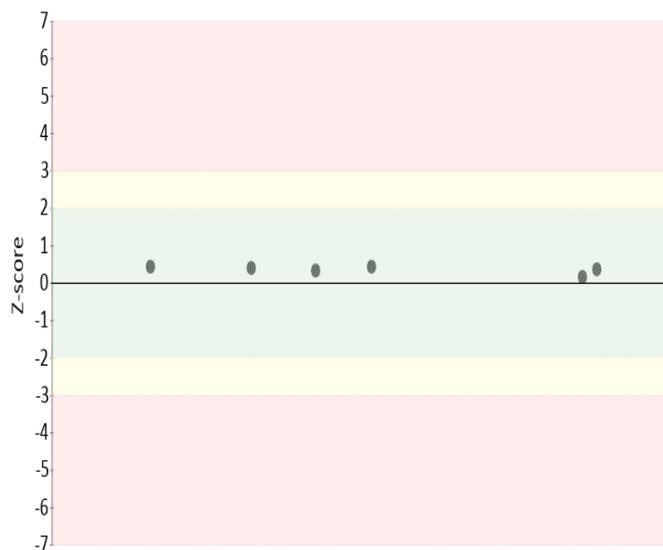

Gráfica 20 Resultado VS Media de comparación

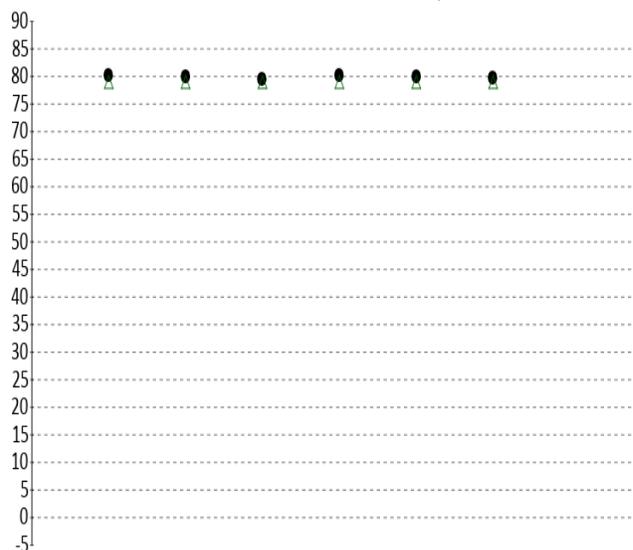

● Resultado    △ Media de comparación


| valor                       | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 6           | 0                   | 0           | 6     |
| Porcentaje                  | 100%        | 0%                  | 0%          | 100%  |

**Analito :** Volumen plaquetario medio


| IT | # laboratorio | Sede  | año  | mes     | instrumento    | resultado | unidad | Media de comparación | Zscore |
|----|---------------|---|------|---------|----------------|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1  | 100107        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Sede Medellín             | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 10.7      | fL     | 11.17                | -1,34  |
| 2  | 100172        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Palace       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 11.1      | fL     | 11.17                | -0,2   |
| 3  | 100173        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Junin       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 11.2      | fL     | 11.17                | 0,09   |
| 4  | 100174        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Patio Bonito | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 10.8      | fL     | 11.17                | -1,06  |
| 5  | 100175        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS Medellín sede Itagüí       | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 10.8      | fL     | 11.17                | -1,06  |
| 6  | 100199        | Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Medellín sede Mayorca     | 2025 | FEBRERO | Mindray BC-20S | 10.6      | fL     | 11.17                | -1,63  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Satisfactorio</b><br>Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score | <b>Alarma</b><br>Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score | <b>No satisfactorio</b><br>Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score |
|---|---|---|

Gráfica 21 Z-score

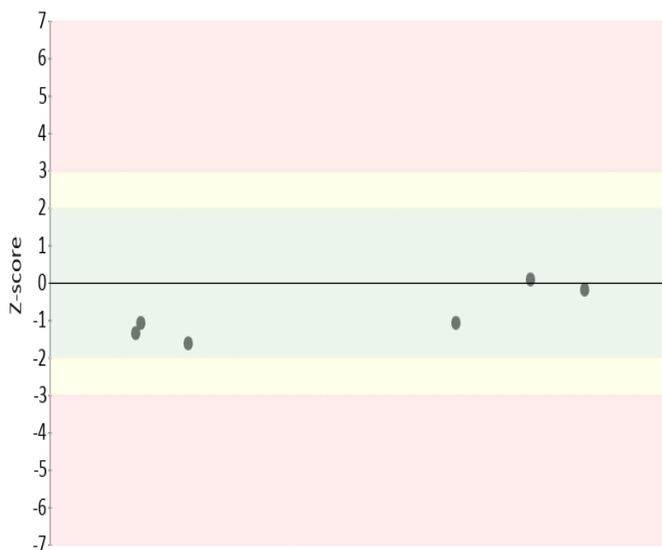

Gráfica 22 Resultado VS Media de comparación

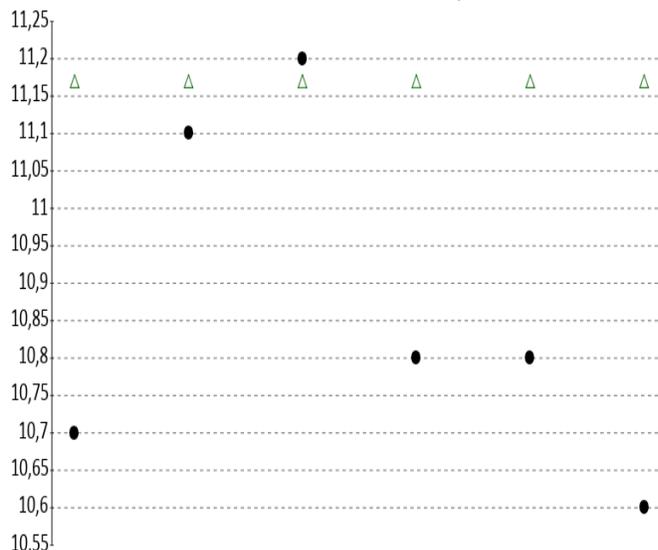

● Resultado    △ Media de comparación

| valor                       | entre +/- 2 | entre +/- 2 y +/- 3 | mayor +/- 3 | Total |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------|
| Valoración Z-score por sede | 6           | 0                   | 0           | 6     |
| Porcentaje                  | 100%        | 0%                  | 0%          | 100%  |